



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PIŁE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
PN-N-18001:2004
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (67) 210 62 00
Sekretariat (67) 210 66 66
Fax (67) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 23.11.2018 roku

NO-ZP.VII-240/37/18/ZO

wszyscy uczestnicy postępowania

dot. zapytania ofertowego pod hasłem „PAPIERY REJESTRACYJNE DO APARATÓW MEDYCZNYCH”


Do toczącego się postępowania wpłynęły następujące pytania:

Pytanie Nr 1

Dotyczy: Pakiet 1 poz.7

Zwracamy się z prośbą o ponowne sprecyzowanie wymaganego papieru.

Papier do Edan Cadence F2/F3/F6/F9 ma rozmiar 151 (152) x 90 x 150 , w związku z powyższym prosimy o dopuszczenie papieru o takim rozmiarze. Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu papieru oryginalnego tzn. producenta Edan, w zamian za papier kompatybilny z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach (zdjęcie papieru poniżej).

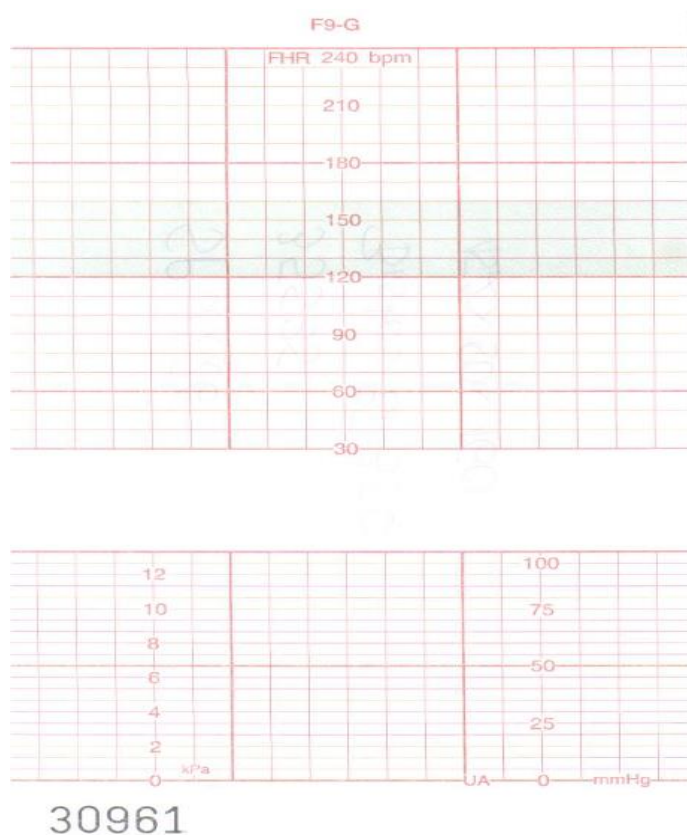


Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie Nr 2

Dotyczy: Pakiet 1 poz.7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru o wymaganych wymiarach tzn. 151x100x150 do aparatów: Hewlett Packard M1911A-M1351A oraz Edan F6-F9.

Jednocześnie prosimy o dopuszczenie papieru kompatybilnego z powodzeniem stosowanego w wielu szpitalach (zdjęcie papieru poniżej).

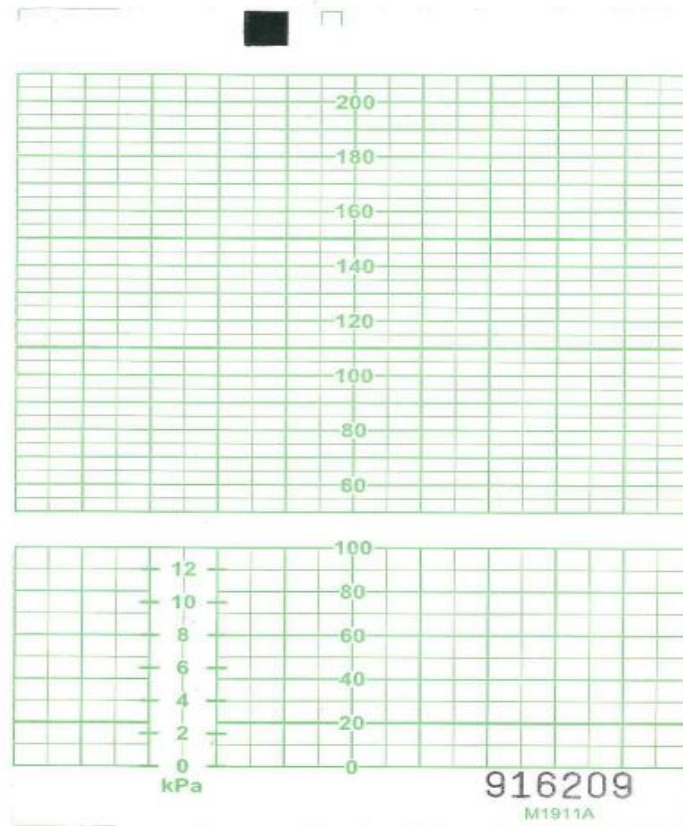

Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie Nr 3

Dotyczy: Pakiet 1 poz.7

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie zapisu odnośnie oryginalności papieru.

Czy wymagany papier ma być produkowany przez producenta aparatu tzn producent Edan ?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie Nr 4

Dotyczy: Pakiet 1 poz.13

Zwracamy się z prośbą o podanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez?

Odpowiedź: Bez nadruku.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią treści zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.