



Nr sprawy: **63/PNE/SW/2023**

Sosnowiec, dnia 05.01.2024r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Pn.: „Dostawa: jednorazowych sterylnych serwet, zestawów na bloki operacyjne, materiałów i narzędzi okulistycznych, sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Neurochirurgii”

W związku z udzielonymi odpowiedziami, prosimy o uwzględnienie w Załączniku nr 3 – Formularzu asortymentowo – cenowym, wszelkich dopuszczeń Zamawiającego w danych częściach oraz pozycjach, poprzez wpisanie którego zestawu i pytania dopuszczenie dotyczy.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

ZESTAW NR 1

Pytanie nr 1:

Część 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koszule z okrągłym, estetycznie obszytym dekoltem, dostępne w rozmiarach M/L (110 x 140 cm) oraz XL/XXL (125 x 160 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie nr 2:

Część 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze uniwersalnym, wymiary 75 x 125 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

ZESTAW NR 2

Pytanie nr 1:

Dotyczy Pakiet 6 poz.1.

Czy Zamawiający wymaga aby podkład był wyposażony w superabsorbent który zatrzymuje wilgoć wewnątrz podkładu przez co pacjent nie ma kontaktu z płynami? Rozwiązanie takie minimalizuje powstawanie odleżyn oraz przyspiesza leczenie.





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga aby podkład był wyposażony w superabsorbent

ZESTAW NR 3

Pytanie nr 1:

Część 3 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 z 60 cm z otworem o średnicy 6 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie nr 2:

Część 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75 z 90 cm z możliwością regulacji otworu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie nr 3:

Część nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z otworem o średnicy 6 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie nr 4:

Część 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 38 x 45 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie nr 5:

Część 4 poz. 3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w ww. pozycji oczekuje serwety przylepnej czy nieprzylepnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oczekuje serwety nieprzylepnej

Pytanie nr 6:

Część 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75 x 45 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie nr 7:

Część 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 50 cm?





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 8:

Część 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 180 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie nr 9:

Część 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 120 x 150 cm z otworem o średnicy 7 x 10 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie nr 10:

Część 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia stolika Mayo składanego w sposób zapewniający aseptyczną aplikację (zamiast teleskopowo)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 11:

Część 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na ramię C, 3- częściowej: 2 x osłona przetwornika obrazu o wymiarach 65 x 75 cm oraz 1 x osłona na ramię "C" o wymiarach 30 x 195 cm? Zestaw wykonany z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości 0,05 mm, ściągnięty elastyczną gumką.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

ZESTAW NR 4

Pytanie 1 - dotyczy pakietu nr 26 pozycji 1:

Czy zamawiający dopuści również dekalinę o ciężarze właściwym 1,91 w temperaturze 25°C, współczynnika załamania światła 1,31 w temperaturze 25°C, lepkości 2,66 cSt i pojemności 5 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 2 - dotyczy pakietu nr 26 pozycji 2:

Czy zamawiający dopuści również olej o lepkości 950 do 1050 mPas pakowany w strzykawkę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe



Pytanie 3 - dotyczy pakietu nr 26 pozycji 3:

Czy zamawiający dopuści również olej o poniższych parametrach:

Lepkość: 4500 do 5500mPas

Indeks refrakcji: 1,40

Gęstość względna: 0,972g/cm w 25°C

Pakowanie: 10ml, strzykawka

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 4 - dotyczy pakietu nr 27:

Czy zamawiający dopuści również błękit pakowany po 10 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 5 - dotyczy pakietu nr 28:

Czy zamawiający dopuści również barwnik o poniższych parametrach:

Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15% oraz brillant blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikol o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampulko-strzykawki o pojemności 0,5ml, pH 6.5-8.0, osmolarność 270-400 mOsm/kg, sterylny. Opakowanie 1 sztuka.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 6 - dotyczy pakietu nr 35 pozycji 4:

Czy zamawiający dopuści również nóż o grubości 0.12-0.22 mm, ostrzony od góry o długości całkowitej 134 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

ZESTAW NR 5

Pytanie nr 1:

Czy w Części nr 33 Zamawiający dopuści kaniulę do zabiegów okulistycznych 27G (0,4) x 7/8" 22mm, zagiętą pod kątem 45° w odległości 6mm, opakowanie handlowe a'10szt., z przeliczeniem i zachowaniem całkowitej wymaganej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 2:

Czy w Części nr 35 poz. 2 Zamawiający dopuści nóż o dł. całkowitej (ostrze + trzonek) = 125mm?





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Części nr 35 pozycję nr 3 do odrębnego Zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie nr 4:

Czy w Części nr 35 poz. 4 Zamawiający dopuści nóż o dł. całkowitej (ostrze + trzonek) =140mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

ZESTAW NR 6

Pytanie nr 1:

Dot. Część 32

Czy Zamawiający ma na uwadze dostawę tzw. „strzałek” ?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 2:

Dot. Część 32

Czy Zamawiający akceptuje dostawę opakowań zawierających 10 blistrów po 5 szt. „strzałek”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 3:

Dot. Część 33





Czy Zamawiający akceptuje do dostawy kaniule :

- typu M2273A
lub - typu
2279 lub
- typu 3926A
lub
- typu 3927









jak na rys. poniżej:





M2273	30 G		30 G x 3/8" 0.3 x 22mm	Anterior chamber cannula. Angled. (Rycroft)	Angled 35°, 5.5mm from tip		10	10
M2273A	27 G		27 G x 3/8" 0.4 x 22mm	Anterior chamber cannula. Angled. (Rycroft)	Angled 35°, 4.5mm from tip		10	10
M2279	27 G		27 G x 3/8" 0.4 x 22mm	Anterior chamber cannula. Angled. (Rycroft)	Angled 45°, 11mm from tip		10	10
M2275	25 G		25 G x 3/8" 0.5 x 22mm	Anterior chamber cannula. Angled. (Rycroft)	Angled 35°, 5mm from tip		10	10
M2273G	23 G		23 G x 3/8" 0.64 x 22mm	Anterior chamber cannula. Angled. (Rycroft)	Angled 35°, 5.5mm from tip		10	10



Viscoelastic Cannulas								
For maintaining and forming the anterior or posterior chamber by infusing or aspirating viscoelastic.								
M3926A	27 G		27 G x 3/8" 0.4 x 22mm	Viscoelastic cannula. Angled	Angled 35°, 9mm from tip		10	10
M3927	27 G		27 G x 3/8" 0.4 x 22mm	Viscoelastic cannula. Angled	Angled 25°, 8mm from tip		10	10
M2272	26 G		26 G x 3/8" 0.45 x 22mm	Viscoelastic cannula. Angled	Angled 35°, 9mm from tip		10	10
M2639A	25 G		25 G x 3/8" 0.5 x 22mm	Viscoelastic cannula. Angled	Angled 35°, 9mm from tip		10	10

Czy Zamawiający akceptuje dostawę opakowań zawierających 10 szt. kaniul

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 4:

Dot. Część 35

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy noże :

Poz.1

Nóż prosty jednorazowy , zaprojektowany do wykonywania portów bocznych oraz tunelu twardówkowego , ostrza ścięte pod kątem 15 ° obustronnie ostrzone , szerokość części roboczej 1,5 mm , Długość części roboczej ostrza wraz z trzonkiem 144 mm, grubość ostrza 0,14 mm

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie nr 5:

Dot. Część 35

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy noże :

Poz.2

Nóż jednorazowy 2,0 mm . Nóż zaprojektowany do wykonywania tunelu twardówkowego ,ostrze precyzyjnie ostrzone od góry jego strony. Kąt rozwarcia krawędzi ostrzy 40°. Kąt skosu ostrzy 25,22°. Kąt zagięcia płaskiej części ostrza w stosunku do osi wyznaczonej przez trzonek 45°. Długość części roboczej ostrza z trzonkiem 150 mm , grubość ostrza 0,15 mm . Rozmiar ostrza 2,00 mm

Nóż jednorazowy 2,4 mm – rozmiar ostrza 2,4 mm Pozostałe wymiary j.w.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie nr 6:

Dot. Część 35

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy noże :


Poz.3

Nóż 2,0mm, jednorazowego użytku używany do zabiegów zaćmy, zagięty pod kątem 45 ° , obustronnie ostrzony ze znacznikiem głębokości. Kąt rozwarcia krawędzi ostrzy 40°, kąt pomiędzy płaszczyznami ostrzy 50,44 ° .





Nóż jednorazowy 2,2 mm – rozmiar ostrza 2,2 mm Pozostałe wymiary jw. Przekrój poprzeczny części tnącej x-x jak na rys.

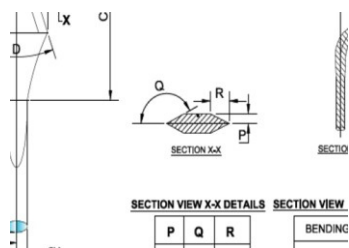

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie nr 7:

Dot. Część 35

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy noże :

Poz.4

Nóż jednorazowy typu Slit 2,2 mm o grubości 0,15 mm, zagięta płaszczyzna tnąca do osi wyznaczonej przez trzonek pod kątem 45°, z antyodblaskową powłoką. Ostrze obustronnie ostrzone. Kąt rozwarcia krawędzi ostrzy 40°, kąt pomiędzy płaszczyznami ostrzy 50,44°. Długości część roboczej wraz z trzonkiem 150 mm

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie nr 8:

Dot. Część 38

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy zestaw :



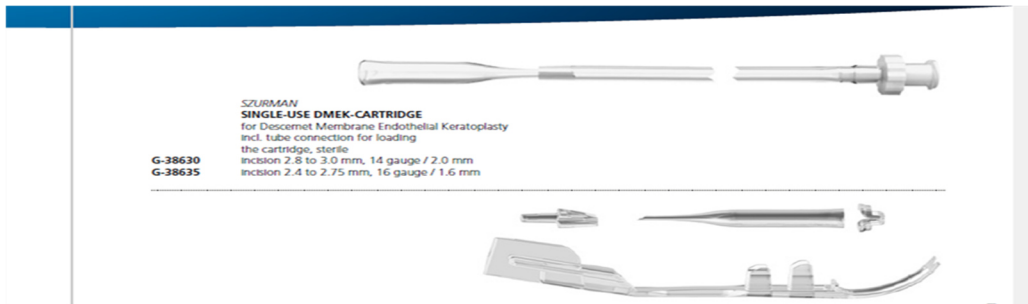

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

ZESTAW NR 7

Pytanie nr 1:

(część 26, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści lepkość 5 mPas?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie nr 2:

(część 26, poz. 3) Czy Zamawiający dopuści olej silikonowy posiadający masę cząsteczkową 27-28 Da?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie nr 3:

(część 32) Czy Zamawiający dopuści mikrostrzałki pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie nr 4:

(część 33) Czy Zamawiający dopuści kaniulę 27G 0,4x22 mm (27G x 7/8in) ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie nr 5:

(część 33) Czy Zamawiający dopuści kaniule w opakowaniu 10 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe



ZESTAW NR 8

Pytanie nr 1:

Część 14, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści osłonę na uchwyty do lamp operacyjnych, uniwersalną, jałową, jednorazową, do uchwytów lamp o śr. 20-40mm, średnica dysku zewnętrznego 11,8cm, otwór o średnicy 15 mm zapobiegający spadaniu poprzez 16 koncentrycznie ustawionych ząbków, wymiary woreczka 9,5 x 15cm, woreczek z polietylenu, wolna od lateksu, biokompatybilna, pakowana pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100szt., zgodny z Rozporządzeniem UE 2017/745., termin ważności 3 lata?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

ZESTAW NR 9

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 3 Pozycja 1** serwety w rozmiarze 75x100cm zamiast 75x90cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 3 Pozycja 3** serwety w rozmiarze 75x100cm zamiast 75x75cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 4 Pozycja 1** serwety w rozmiarze 50x70cm z otworem 6x8cm zamiast 50x60cm z otworem 8cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 4 Pozycja 3** serwety w rozmiarze 50x70cm 50x60cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 11 Pozycja 1** serwety z włókniny czterowarstwowej typu SMMS zamiast trzywarstwowej SMS. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 17 Pozycja 1** fartuchów typu spunlace o gramaturze min. 70g/m² wzmocnionych laminatem o gramaturze min. 28g/m². Łączna gramatura w miejscu krytycznym 98g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 134cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min.



211kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro – 65 N. Opakowanie typu papier-foolia, bez dodatkowej serwety/papieru krepowego. Rozmiar L, XL, XXL. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 17 Pozycja 2** kompletów odzieży operacyjnej z jedną kieszenią zamiast trzech. Kompletu dostępne w rozmiarach od M-XXL. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 8

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 23** zestawu do laparoskopii o składzie podanym przez Zamawiającego gdzie wszystkie podane parametry serwet oraz osłon (gramatury) są wyrażone jako wartości minimalne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 9

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 23** fartuchów typu spunlace wzmocnionych na przedramieniu oraz w okolicy brzucha i klatki piersiowej o łącznej gramaturze min. 98g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 134cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 211kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro – 65 N. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 10

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 25** zestawu wykonanego z czterowarstwowej włókniny typu SMMS o gramaturze min. 45g/m². Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

ZESTAW NR 10

Pytanie 1

Część 1, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze „L” (długość 120 cm, szerokość 70 cm), gdyż z doświadczenia wiemy, że jest to rozmiar najczęściej używany?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 2

Część 1, poz. 1 i 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 3

Część 1, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS 33g/m² w kolorze niebieskim, umożliwiającą zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu), związaną, z białym



trokiem w pasie o długości całkowitej 178cm oraz 2 na szyi o długości 48cm, z krótkim rękawem o obwodzie 43cm, o długości koszuli 110cm oraz szerokości 140 cm? Zdjęcie poglądowe obok.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 4

Część 1, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem bez obszycia, wiązaną na troki przy szyi oraz w pasie, bez rozcięcia na plechach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 5

Część 2, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 160x210cm wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 6

Część 2, poz. 1 i 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 7

Część 2, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści poszewkę w rozmiarze 60x80cm wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 8

Część 3, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem owalnym przylepnym o wymiarach 6 x 8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 9

Część 3, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem okrągłym przylepnym o średnicy 7 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 10

Część 3, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 75 x 90 cm z otworem przylepnym o średnicy 7 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 11

Część 3, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 50 x 75 cm z otworem przylepnym o średnicy 7 cm?



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 12

Część 4, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem owalnym przylepnym o wymiarach 6 x 8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 13

Część 5, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 120 x 150 cm z otworem przylepnym o średnicy 7 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 14

Część 5, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 120 x 150 cm z otworem przylepnym o średnicy 10 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 15

Część 6, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g, o chłonności 1177 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 16

Część 6, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 17

Część 6, poz. 3 – Czy Zamawiający podkład papierowo-foliowy w rolce o szerokości 50 cm, i długości 50 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 18

Część 6, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z 2 warstw celulozy i 1 warstwy folii?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 19

Część 7, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze uniwersalnym o długości 116 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 20

Część 7, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze uniwersalnym o długości 180 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe



Pytanie 21

Część 7, poz. 1-3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 22

Część 11, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę niesterylną wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 23

Część 11, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę niesterylną wykonaną z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 24

Część 13, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trzyczęściowego zestawu na ramię C zawierającego:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm
- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm
- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm. Osłony wykonane z folii PE o grubości 0,065mm, zakończone elastyczną gumką do stabilizacji?


Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 25

Część 14, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poniższej jednorazowej, sterylnej osłonki na uchwyty lamp chirurgicznych z kołnierzem ochronnym zapobiegającym przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy, przy kołnierzu znajdują się specjalne wypustki, które zapobiegają zsuwaniu się osłonki z uchwytu, nie wymagają zastosowania adaptera.

Średnica kołnierza 12,7 cm, uchwyt 3,1 cm, wysokość produktu 10,2 cm?

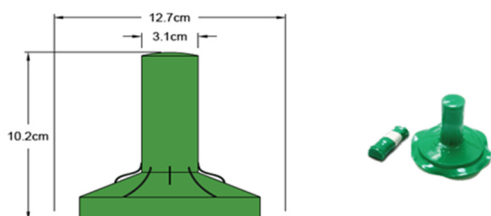

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 26

Część 15, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ

Pytanie 27

Część 16, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 75cm x 90cm 2-warstwowa, do znieczuleń przewodowych, z otw. przylep.10cm x 15cm, 4 przylepne rogi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe





Pytanie 28

Część 17, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręcznika z włókniny spunlace?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 29

Część 18, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami wykonanymi z laminatu dwuwarstwowego PP + PE o gramaturze 60g/m², dodatkowo wzmocnienie w strefie krytycznej, łączna gramatura 140g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 30

Część 18, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną samoprzylepną 230 x 260 cm z wycięciem U 20 x 100 cm ze wzmocnieniem 75 x 140 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 31

Część 18, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z miskami o pojemności 800 ml (zamiast 0,7 L)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 32

Część 18, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłonami na uchwyt do lampy chirurgicznej z kołnierzem HDPE 114mm, a także folii PE o szer. 120mm dł. 210mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 33

Część 18, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z drenem łączącym do ssaka o długości 300cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 34

Część 18, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłonami na uchwyt do lampy chirurgicznej z kołnierzem HDPE 114mm, a także folii PE o szer. 120mm dł. 210mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 35

Część 19, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami wykonanymi z laminatu dwuwarstwowego PP + PE o gramaturze 60g/m², dodatkowo wzmocnienie w strefie krytycznej, łączna gramatura 140g/m². Chłonność laminatu 680%, chłonność w części wzmocnionej ponad 900%?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 36

Część 19, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną samoprzylepną 230 x 260 cm z wycięciem U 20 x 100 cm ze wzmocnieniem 75 x 140 cm, bez zintegrowanej stokinety?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe





Pytanie 37

Część 19, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłonami na uchwyt do lampy chirurgicznej z kołnierzem HDPE 114mm, a także folii PE o szer. 120mm dł. 210mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 38

Część 19, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z drenem łączącym do ssaka o długości 300cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 39

Część 20, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej zestawy o parametrach i składzie: Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów: 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75 x 100 cm

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

1 x serweta samoprzylepna wzmocniona o wymiarach 170cm x 180cm


1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm (laminat dwuwarstwowy 56 g/m²)

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

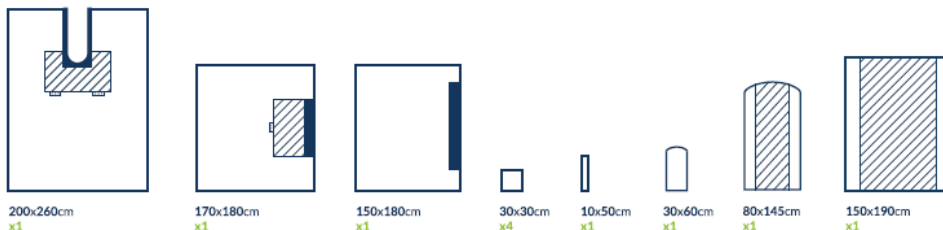

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 40

Część 20, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami wykonanymi z laminatu dwuwarstwowego PP + PE o gramaturze 60g/m², dodatkowo wzmocnienie w strefie krytycznej, łączna gramatura 140g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 41

Część 20, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną 230 x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 7 cm ze wzmocnieniem 50 x 100 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 42

Część 20, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłonami na uchwyt do lampy chirurgicznej z kołnierzem HDPE 114mm, a także folii PE o szer. 120mm dł. 210mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe





Pytanie 43

Część 21, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu z serwetą główną wykonaną w jednej części z włókniny SMS o gramaturze 50g/m² oraz w drugiej części z folii PE?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 44

Część 21, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu z serwetą główną z otworem brzuszny i kroczywym o średnicy 6 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 45

Część 21, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu z osłoną na kamerę w rozmiarze 14cm x 250cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 46

Część 21, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu z serwetą główną dwuwarstwową w rozmiarze 180/280 x 220 cm z otworem przyklepnym 30 x 20 x 20 cm oraz z otworem kroczywym zabezpieczonym kłapką, bez wzmocnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 47

Część 21, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłonami na uchwyt do lampy chirurgicznej z kołnierzem HDPE 114mm, a także folii PE o szer. 120mm dł. 210mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 48

Część 21, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z organizatorem typu rzep 2 cm x 22 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 49

Część 21, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną dwuwarstwową 160/240x180 cm z samoprzylepnym otworem 10 x 15 cm, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz workiem do zbiórki płynów z filtrem, sztywnikiem i podłączeniem drenu, bez wzmocnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 50

Część 21, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłonami na uchwyt do lampy chirurgicznej z kołnierzem HDPE 114mm, a także folii PE o szer. 120mm dł. 210mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 51

Część 24, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami wykonanymi z laminatu dwuwarstwowego PP + PE o gramaturze 60g/m², dodatkowo wzmocnienie w strefie krytycznej, łączna gramatura 140g/m², chłonność laminatu 680%, chłonność w części wzmocnionej ponad 900%?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe





Pytanie 52

Część 24, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x Serweta chirurgiczna 150cm x 240cm 2-warstwowa ze wzmocnieniem, z przylepcem
- 1 x Serweta chirurgiczna 180cm x 180cm 2-warstwowa ze wzmocnieniem, z przylepcem
- 2 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa ze wzmocnieniem, z przylepcem
- 1 x Serweta na stół Mayo 140cm x 80cm wzmocniona, czerwona
- 1 x Serweta na stół do instrumentarium 150cm x 190cm
- 2 x Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna
- 1 x Pojemnik okrągły poj. 1000ml, niebieski, z podziałką
- 2 x Serweta operacyjna z gazy 17N 6W 45cm x 45cm z nitką RTG i tasiemką
- 50 x Kompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm z nitką RTG
- 2 x Pokrowiec na uchwyt do lamp operacyjnych, o szer. 120mm długości 210mm wykonanej z folii PE?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe


Pytanie 53

Część 25, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety wykonanej z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², o składzie:

- 1 x serweta okulistyka wzmocniona o wymiarach 140 cm x 240 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów, usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm?



140x240cm
1szt./pc.



150x190cm
1szt./pc.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

ZESTAW NR 11

Pytanie 1

Dotyczy części nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koszule z krótkim rękawem tworzącym się wykroju koszuli?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 2

Dotyczy części nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 3

Dotyczy części nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koszule z rękawami bez obszycia wokół krawędzi?



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 4

Dotyczy części nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Koszula Tył rozcięty – wiązana z tyłu na dwie pary troków- przy szyi i w połowie pleców. Pod szyją wycięcie typu U. Krótki rękaw (tworzy się z wykroju)

Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości)

Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 5

Pakiet 3 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze **75x90 z otworem 6x8?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 6

Pakiet 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Serweta 50x75cm z otworem przylepnym 5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 7

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Serweta 50x60cm z otworem przylepnym. 6x8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 8

Pakiet 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Serweta 90x150cm z otworem . przylepnym o średnicy 8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 9

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przedniak?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 10

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch;

- wykonany z włókniny polipropylenowej powlekanej folią PE
- zakładany od przodu oraz zawiązywany na troki przy szyi oraz w pasie
- posiada długi rękaw wykończony elastycznym mankietem



- zapewniający wysoki komfort w trakcie noszenia
- jednorazowego użytku
- stanowi warstwę izolującą i zapewnia wysoki stopień ochrony produkt

- opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 11

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści długość min. 115 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 12

Pakiet 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści :

Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35 g/m² wzmocniony na przedramieniu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem o gramaturze min. 38 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką trójścieżkowego ultradźwiękowo szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk na fartuchu i serwecie widoczny, widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Fartuch zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy min 148 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min 162 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro min.161,5 N - parametry dla strefy krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL. Kolor niebieski.

Równoważne + Próbką 1 sztuka

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 13

Pakiet 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży z włókniny SMMS o gramaturze 40 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 14

Pakiet 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar S, M, L, XL, XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 15

Pakiet 17 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za ręczniki pakowane a 2 sztuki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 16

Pakiet 17 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ręczniki sterylne pakowane a 2 sztuki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 17

Pakiet 17 poz. 4 , 5

Czy Zamawiający dopuści

SPECYFIKACJA:

- wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej ze wstawką przeciwpotną
- o gramaturze 20g/m²
- w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej
- przeciwpotny
- lekki i dobrze przepuszczający powietrze
- zapewniający komfort w trakcie noszenia
- jednorazowego użytku
- zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń
- produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 18

Pakiet 17 poz.4 , 5, 6

Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w folię a 100 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 19

Pakiet 17 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści czepek

- wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej
- o gramaturze 25g/m²
- wykończony dookoła gumką
- lekki i dobrze przepuszczający powietrze
- zapewniający komfort w trakcie noszenia
- jednorazowego użytku
- zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń
- produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 20

Pakiet 25

Czy Zamawiający dopuści skład:

- 1 serweta główna 140 x 150 cm, z otworem 9 x 11 cm wypełnionym folią chirurgiczną. Po dwóch stronach otworu zintegrowane z serwetą prostokątne zbiorniki do przechwytywania płynów wyposażone w kształtki (szytwniki);

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe



Pytanie 21

Pakiet 25

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 45 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 22

Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści Materiał serwet musi być wykonany z minimum dwóch warstw o min. gramaturze 54g/m² na całej powierzchni + elementy chłonne o minimalnej gramaturze 95g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

ZESTAW NR 12

Pytanie 1

Część 2, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie poszwy w rozmiarze 150x200cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ .

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 2

Część 2, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie poszwy w rozmiarze 75x90cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 3

Część 3, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety w rozmiarze 80x75cm z otworem owalnym o w rozmiarze 6x15?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 4

Część 3, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety samoprzylepnej w rozmiarze 90x75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 5

Część 4, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety w rozmiarze 50x60cm z otworem owalnym 6x8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 6

Część 5, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety w rozmiarze 90x150cm z otworem o średnicy 8cm?



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 7

Część 6, Poz. 2,3

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie pozycji, umożliwi to uzyskanie korzystniejszych ofert cenowych, np. bezpośrednio od producentów wyrobu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 8

Część 11, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety niesterylnej z włókniny trójwarstwowej typ SMS o gramaturze włókniny minimum 35g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 9

Część 13, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw osłon na ramię C aparatu RTG zbudowana z: 2 x osłona typu beret (33÷112)x56cm + folia 250x50cm z 10 przylepcami 5x5cm. wykonaną z folii PE o grubości 41 µm ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 10

Część 15, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski mocowaną za uszy, za pomocą nie uciskających, elastycznych uchwytów o szerokości 1,5 ±0,3cm, umożliwiających regulację?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 11

Część 16, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do znieczulenia podpajeczynówkowego o składzie:

- serweta z laminatu 2 warstwowego 50x60 cm z otworem 10 cm i przylepcem wokół otworu, 2 przylepce na rogach górnej, węższej części, serweta o gramaturze 56g/m² - 1 szt.
- serweta foliowana w rozmiarze 50x60 cm służąca do zawinięcia zestawu-1 szt.
- kleszczyki plastikowe typu Pean 13cm - 1 szt.
- kompresy włókninowe 30 g, 4w, rozmiar 7,5x7,5cm-10 cm
- strzykawka 3 ml -1 szt.
- strzykawka 5ml -1 szt.
- igła iniekcyjna 1,2 x 40 mm -1 szt.
- igła iniekcyjna 0,5 x 25 mm - 1 szt.
- opatrunek włókninowym z wkładem chłonnym 10 x 8 cm - 1 szt.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 12

Część 18, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do chirurgii biodra o składzie:

1. Serweta dwuwarstwowa w rozmiarze 260cmx230cm z wycięciem U w rozmiarze 100cmx20cm z dodatkową łatą chłonną o wym. 80 x 120 cm – 1 sztuka



Materiał serwet wykonany z minimum dwóch warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 62g/m² na całej powierzchni + elementy chłonne o gramaturze 63g/m². Wierzchnia warstwa wykonana z wysoko chłonnej włókniny. Górna warstwa po wchłonięciu płynu pozostaje sucha.

Zestaw wykonany z materiału spełniającego wymogi normy EN13795-1-3.

2. Serweta TF (laminat z włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 43g/m²) w rozmiarze 300cmx180cm oraz przylepcem 60 cm – 1 sztuka
3. POKROWIEC NA KOŃCZYŃĘ TF 80X45CM – 1 sztuka
4. Serweta na strój instrumentariuszki 190X150CM służąca do owinięcia zestawu – 1 sztuka
5. OSŁONA PE NA STOLIK PROSTOKĄT MAYO 145X80CM 24GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM – 1 sztuka
6. Serweta L2 laminat 56g w rozmiarze 150X100CM – 2 sztuki
7. TAŚMA MEDYCZNA D/ST EO Z WŁÓKNINĄ 9X50CM – 1 sztuka
8. OSŁONA PE NA UCHWYT DO LAMPY Z KOŁNIERZEM 14X12CM – 2 sztuki
9. TAŚMA RZEP, HACZYKI I PĘTELKI, BIAŁA 20X250MM – 1 sztuka
10. UCHWYT MONOPOLARNY Z 2 PRZYCISKAMI, ELEKTRODĄ PŁASKĄ I KABLEM 3M – 1 sztuka
11. POJEMNIK PLAST TYP NERKA 700ML 25X10,5X5CM SKALA NIEBIESKI – 2 sztuki
12. SERWETA OPERACYJNA Z GAZY Z NITKĄ RTG 17-NITKOWA 4-WARSTWOWA 45X45CM - 2 sztuki
13. Serweta l2 w rozmiarze 90cmx75cm – 2 sztuki
14. Kompresy gazowe 17N, 8W, 10X10 RTG – 50 sztuk
15. strzykawka 100 ml ze stożkiem do cewnika usytuowanym centralnie – 1 sztuka
16. KONCÓWKA DO ODSYSANIA YANKAUER CH24 Z KONTROLĄ SIŁY SSANIA Z DRENEM CH25 DŁ 350CM – 1 sztuka
17. OSTRZE CHIRURGICZNE DO SKALPELA NR 24 – 1 SZTUKA
18. OSTRZE CHIRURGICZNE DO SKALPELA NR 22 – 1 SZTUKA

Zapakowany w opakowanie torebka papierowo-foliowa. Na opakowaniu 2 etykiety z nazwą wytwórcy, REF, LOT, Data ważności. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 13

Część 18, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do operacji ręki o składzie:

1. Serweta L2 (włóknina polipropylenowa oraz folia polietylenowo-polipropylenowa o gramaturze 56g/m²) w rozmiarze 300cmx225cm z otworem 4cm z dodatkową warstwą chłonną, elementem elastycznym oraz organizerem na przewody - 1 sztuka
2. Serweta L2 w rozmiarze 150X100 cm z przylepcem – 1 sztuka
3. Serweta na strój instrumentariuszki w rozmiarze 190X150 cm – 1 sztuka
4. POKROWIEC NA KOŃCZYŃĘ L2 55X33CM – 1 sztuka
5. OSŁONA PE NA STOLIK PROSTOKĄT MAYO 145X80CM 24GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM – 1 sztuka
6. Serwetki włókninowe do osuszania rąk 20x40cm – 4 sztuki
7. TAŚMA MEDYCZNA D/ST EO Z WŁÓKNINĄ 9X50CM – 2 sztuki
8. TAŚMA RZEP, HACZYKI I PĘTELKI, BIAŁA 20X250MM – 1 sztuka
9. OSŁONA PE NA UCHWYT DO LAMPY Z KOŁNIERZEM 14X12CM -2 sztuki

Zapakowany w opakowanie torebka papierowo-foliowa. Na opakowaniu 2 etykiety z nazwą wytwórcy, REF, LOT, Data ważności. Sterylizowany tlenkiem etylenu

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 14

Część 21, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do operacji urologicznych TUR o składzie:



1. Serweta urologiczna w rozmiarze 215cmx180cm z otworami 5cm - brzuszny i 4cm kroczy z osłonką na palec, z workiem na płyny, zintegrowanymi nogawicami wykonana z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa oraz folio polietylenowo-polipropylenowa) o gramaturze 56g/m² -1 sztuka
2. Osłona na stolik Mayo w rozmiarze 145X80CM 24GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM – 1 sztuka
3. TAŚMA MEDYCZNA D/ST EO Z WŁÓKNINĄ 9X50CM – 1 sztuka
4. TAŚMA RZEP, HACZYKI I PĘTELKI, BIAŁA 20X250MM – 1 sztuka
5. POJEMNIK PLASTIKOWY OKRĄGŁY 250ML WYS 5CM ŚR DENKA 7,5CM SKALA – 1 sztuka
6. CAMERA COVER 15X250CM – 1 sztuka
7. Serweta na strój instrumentariuszki w rozmiarze 190X150 cm – 1 sztuka
8. Sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m². Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 160cmH₂O, mniej krytycznej min. 37cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 129kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 1,3 log₁₀- - 1 sztuka rozmiar XL oraz 1 szt. rozmiar L
Zapakowany w opakowanie torebka papierowo-foliowa. Na opakowaniu 2 etykiety z nazwą wytwórcy, REF, LOT, Data ważności. Sterylizowany tlenkiem etylenu

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 15

Część 21, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu brzuszno-kroczyowego o składzie:

1. Serweta brzuszno-kroczyowa 265cmx180cm wykonana z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa oraz folio polietylenowo-polipropylenowa) o gramaturze 56g/m² z otworami 15cmx10cm i 28cmx20cmx19cm Prostokąt i trapez ze zintegrowanymi nogawicami i folią chirurgiczną – 1 sztuka
2. OSŁONA PE NA UCHWYT DO LAMPY Z KOŁNIERZEM 14X12CM – 2 sztuki
3. POJEMNIK PLAST OKRĄG 1000ML WYS 8CM ŚR DENKA 12CM SKALA – 1 sztuka
4. OSŁONA PE NA STOLIK PROSTOKĄT MAYO 145X80CM 24GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM – 1 sztuka
5. Serwetki do osuszania rąk włókninowe 40x20 cm – 4 sztuki
6. Kompresy gazowe 17nitkowe 8warstwowe z nitką RTG – 10x10cm – 20 sztuk
7. Tupfery gazowe typu groszek 17nitkowe rozmiar 12x12 cm z nitką RTGw torebce tpf – 10 sztuk
8. Serweta gazowa 17nitkowa 6warstwowa 45x45 cm – 6 sztuk
9. TAŚMA RZEP, HACZYKI I PĘTELKI, BIAŁA 20X250MM – 1 sztuka
10. Serweta na stół instrumentariuszki 190X150CM służąca do zawinięcia zestawu – 1 sztuka
11. Sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m². Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 160cmH₂O, mniej krytycznej min. 37cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 129kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 1,3 log₁₀- - 1 sztuka rozmiar XL oraz 1 szt. rozmiar L
Zapakowany w opakowanie torebka papierowo-foliowa. Na opakowaniu 2 etykiety z nazwą wytwórcy, REF, LOT, Data ważności. Sterylizowany tlenkiem etylenu

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe





Pytanie 16

Część 21, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylneho zestawu do operacji Kroczych o składzie:

1. Serweta w rozmiarze 260cmx240cm wykonana z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa oraz folia polietylenowo-polipropylenowa) o gramaturze 56g/m² otwór prostokąt 15cmx10cm z warstwą chłonną, worek na płyny i zintegrowanymi nogawicami – 1 sztuka
2. OSŁONA PE NA UCHWYT DO LAMPY Z KOŁNIERZEM 14X12CM – 2 sztuki
3. Serweta na stół instrumentariuszki 190X150CM służąca do zawinięcia zestawu – 1 sztuka
4. OSŁONA PE NA STOLIK PROSTOKĄT MAYO 145X80CM 24GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM – 1 sztuka
5. Sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m². Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 160cmH₂O, mniej krytycznej min. 37cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 129kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 1,3 log₁₀- - 1 sztuka rozmiar XL oraz 1 szt. rozmiar L
Zapakowany w opakowanie torebka papierowo-foliowa. Na opakowaniu 2 etykiety z nazwą wytwórcy, REF, LOT, Data ważności. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 17

Część 22, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylneho zestawu specjalistycznego DOZAKŁADANIA PORTU o składzie:

- 1x serweta operacyjna główna 200x280cm z dwoma samoprzylepnymi otworami 22x22cm wypełnionymi folią chirurgiczną. Otwory umieszczone 80cm od górnej krawędzi serwety oraz 60cm od krawędzi bocznych. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m² i nieprzemakalności 202cmH₂O.
- 1x osłona na sondę USG 18x244cm
- 1x żel lubrykacyjny w saszetce 20ml
- 2x fartuch chirurgiczny z włókniny trzywarstwowej SMS o gramaturze 35g/m² z miękkimi poliestrowymi mankietami, szerokie rękawach zapewniające swobodę ruchów, na szyi zapinany na rzepy. Troki zewnętrzne fartuch wykonane metodą ultradźwiękową, połączone kartonikiem. Odporność na rozerwanie na mokro 138 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho 116,7kPa. Odporność na penetrację płynów 37 m H₂O, rozm.L i XL
- 1x osłona na stół Mayo 80x145cm
- 1x taśma samoprzylepna 9x50cm
- 1x serweta na stół instrumentariuszki 100x150cm chłonna na całej powierzchni serwety – osłona zestawu.
- 10 szt kompresy gazowe 10x10cm, 17nitkowe 8 warstwowe
- 10 szt kompresy gazowe 7,5 x7,5cm, 17 nitkowe 8 warstwowe
- 2 szt OSŁONA PE NA UCHWYT DO LAMPY Z KOŁNIERZEM 14X12CM

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 18

Część 23, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylneho zestawu specjalistycznego dolaparoskopii o składzie:





1 x serweta 200 cm x 280 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 20 cm x 20 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysoko chłonne o gramaturze min. 60 g/m²,

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm

1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2cm x 25 cm

1 x osłona na przewody o wymiarach 13 cm x 244 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o grubości 0,041 mm.

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm w postaci worka, Z WARSTWA CHŁONNĄ 76X85 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze min. 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 84 g/m².

10 szt kompresy gazowe 10x10cm, 17nitkowe 8 warstwowe

10 szt kompresy gazowe 7,5 x 7,5cm, 17 nitkowe 8 warstwowe

2 x jednorazowy, jałowy, fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m² wzmocniony na przedramieniu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem o gramaturze 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Łączenie elementów fartucha szwem ultradźwiękowym. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk z rozmiarówką, widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Odporność na przenikanie cieczy 171 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 135 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 243 N/50 mm - parametry dla strefy krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentację medyczną. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: L, XL

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 19

Część 24, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej zestawy specjalistycznej uniwersalnej nieznacznie różniący się od wymaganego:

Zestaw serwet jałowych uniwersalny z dodatkowymi wstawkami chłonnymi

skład zestawu:

- 1 szt. serweta o wymiarze min. 150 x 240 cm samoprzylepna z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 37,5 x 70 cm.

- 1 szt. serweta o wymiarze min 200 x 170 cm samoprzylepna z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 37,5 x 70 cm.

- 2 szt. serwety samoprzylepne o wymiarze 75 x 90 cm z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 37,5 x 70 cm.

- 1 szt. obłożenie na stolik MAYO o wymiarze min. 80 x 140 cm w formie worka – złożone teleskopowo

- 1 szt. serweta na stolik narzędziowy o wym. 150 x 190 cm

- taśma samoprzylepna 9 x 50 cm – 2 szt

- 1 szt. miska nerkowa o pojemności 0,7 L

- 2 szt. serwety operacyjne 45x45 cm, 6 warstwowe z nitką RTG i tasiemką

- 50 szt. kompresy gazowe 10x10cm, 17 nitkowe 8 warstwowe z nitką RTG

- 2 szt. osłona na uchwyt do lampy chirurgicznej z kołnierzem PP o śr. 120 mm. Wykonana z folii PE o długości 140 mm

Materiał serwet wykonany z minimum dwóch warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 62 g/m² na całej powierzchni + elementy chłonne o gramaturze 63 g/m². Wierzchnia warstwa wykonana z wysokochłonnej włókniny. Górna warstwa po wchłonięciu płynu pozostaje sucha.

Zestaw wykonany z materiału spełniającego wymogi normy EN13795-1-3.

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta.

Pozostały skład zestawu i wymagane parametry wyrób spełnia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe



Pytanie 20

Część 25, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie do zabiegów okulistycznych o składzie:

1. Serweta TF (laminat z włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 43g/m² m² na całej powierzchni, wierzchnia warstwa wykonana z wysoko chłonnej włókniny) w rozmiarze 280X180 cm z otworem 10x15 cm wypełnionym folią, w którym znajduje się wycięcie na oko w rozmiarze 4 na 6 cm i workiem do gromadzenia płynów po prawej i po lewej stronie, usztywnione metalowymi wkładkami (brzegi worka można formować) – 1 sztuka

2. Serweta na strój instrumentariuszki w rozmiarze 190X150 cm – 1 sztuka

Zapakowany w opakowanie torebka papierowo-foliowa. Na opakowaniu 2 etykiety z nazwą wytwórcy, REF, LOT, Data ważności. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Zestaw wykonany z materiału spełniającego wymogi normy EN13795-1-3.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytania do projektu umowy:

Pytanie 21

Czy Zamawiający zgodzi się aby w § 8 pkt 2 zmieniono zwrot „Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy” na „Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jednakże przed odstąpieniem wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy na piśmie” ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 22

Czy Zamawiający zgodzi się, aby termin uregulowania zapłaty był uważany się dzień, w którym należność wpłynie na konto Wykonawcy ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

ZESTAW NR 13

Pytanie 1

Część 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe

Pytanie 2

Część 2, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści trzyelementowy komplet pościeli : poszwa na poduszkę, poszwa na kołdrę oraz prześcieradło?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 3

Część 2, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m², wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.





Pytanie 4

Część 7, poz. 1

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 69 cm x 107 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 5

Część 7, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe

Pytanie 6

Część 17, poz. 4-6

Czy zamawiający wydzieli poz.4-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 7

Część 17, poz. 4

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany w całości z włókniny polipropylenowej, nieperforowanej, o gramaturze 25 g/m², bez możliwości wywinięcia, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 8

Część 17, poz. 4

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 9

Część 17, poz. 5

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany w całości z włókniny polipropylenowej, nieperforowanej, o gramaturze 25 g/m², bez możliwości wywinięcia, z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.



Pytanie 10

Część 17, poz. 5

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 11

Część 17, poz. 6

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, nieperforowanej, o gramaturze min. 16 g/m², w kolorze niebieskim, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 12

Część 17, poz. 6

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

ZESTAW NR 14

Pytanie 1

CZĘŚĆ NR 3

Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety posiadającej otwór okrągły zamiast owalny? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2

CZĘŚĆ NR 3

Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75cm x 90cm z otworem okrągłym o średnicy 7cm otoczonym przylepcem? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 3

CZĘŚĆ NR 4

Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50cm x 60cm z otworem o średnicy 7cm (zamiast 8cm) otoczonym przylepcem? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 4

CZĘŚĆ NR 4





Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 45cm x 75cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 5

CZĘŚĆ NR 5

Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 90cm x 150cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 6

CZĘŚĆ NR 5

Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 100cm x 150cm z otworem o średnicy 10cm otoczonym taśmą lepłą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe

Pytanie 7

CZĘŚĆ NR 5

Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 120cm x 150cm z otworem o średnicy 7cm otoczonym taśmą lepłą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe

Pytanie 8

CZĘŚĆ NR 10

Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na przewody w rozmiarze 13 x 250cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

ZESTAW NR 15

Pytanie 1

Część 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji sterylną, jednorazową osłonę na kamerę posiadającą pierścień ułatwiający zakładanie o wymiarach 15cm x 244cm. Końcówka perforowana zaopatrzona w nierozmakającą taśmę mocującą.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe





Pytanie 2

Część 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji jednorazową sterylną bez lateksową uniwersalną 3-częściową osłonę na aparat RTG ramię C, wykonaną z bezbarwnej folii PE, posiadającą część górną z elastyczną gumką o wymiarach 91cm x 76 cm – 1 szt, część dolną z elastyczną gumką o wymiarach 91cm x 76 cm – 1 szt, osłona na ramię C o wymiarach 250 cm x 50 cm -1 szt z regulowanymi klipsami dla łatwej fiksacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe

Pytanie nr 3

Dotyczy wzoru umowy zał. nr 8 – §8 ust. 1 pkt 1)

Prosimy o modyfikację zapisów umowy w sposób następujący:

„1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) *w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia - za każdy dzień zwłoki względem któregośkolwiek z terminów którym mowa w § 3 ust. 9 lub § 7 ust. 4 ”*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4

Dotyczy wzoru umowy zał. nr 8 – §8 ust. 1 pkt 2)

Prosimy o modyfikację zapisów umowy w sposób następujący:

„1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

2) *w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy – w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego albo Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,”*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 5

Dotyczy wzoru umowy zał. nr 8 – §8 ust. 7

Prosimy o modyfikację zapisów umowy w sposób następujący:

7. Poza przypadkami określonymi w przepisie art. 456 ustawy Pzp i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, bądź pozostałych postanowieniach Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 3 umowy, w przypadkach, gdy:



1) jednorazowa zwłoka Wykonawcy względem terminu głównego wykonania dostawy wskazanego zgodnie z § 3 ust. 9 Umowy, przekroczy 7 dni roboczych,

2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego Towaru w terminie 3 dni roboczych od upływu terminu na wymianę Towaru,

3) w razie wystąpienia innych niż powyższe okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co należy rozumieć w szczególności utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji Przedmiotu umowy, ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizowanych dostaw lub ich jakości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 6

Dotyczy wzoru umowy zał. nr 8 – §8 ust. 10 i 11

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie §8 ust. 10 i 11 z zapisów umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 7

Dotyczy wzoru umowy zał. nr 8 – §8 ust. 10

Prosimy o modyfikację zapisów umowy w sposób następujący:

„10. Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji dostawy Towaru tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, bądź jest już w zwłoce względem umówionego terminu, Zamawiający może po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, mając na uwadze cel umowy, powierzyć wykonanie dostawy Towaru podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Dyrektor

ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem

Agnieszka Kozak

