



Poznań, dnia 19 marca 2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-15/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów i adaptacją pomieszczeń Centralnego Laboratorium**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zestaw nr 1

Dotyczy Części 4

1. Czy Zamawiający zaakceptuje analizator, w którym kalibracja nie jest wczytywana, lecz wykonuje się ją bardzo rzadko (raz na serię odczynników, około 2 x rok). Oznaczeń APTT i PT się nie kalibruje. Kalibracja jest archiwizowana (10 ostatnich kalibracji).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator posiadał funkcję szacunkowego określania interferencji HIL wraz z porównaniem graficznym znalezionej w próbce poziomu interferencji z progami ostrzegawczymi (poziomym powyżej którego interferencja może mieć wpływ na wynik, ustalonym indywidualnie dla danego parametru) oraz generowaniem odpowiednich flag dla próbek ze znalezionymi interferencjami?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3. Czy ze względu na niską ilość badań Zamawiający zrezygnuje z konieczności oferowania materiałów dla codziennej kontroli jakości dla oznaczeń planowanych w ilości 100 /2 lata?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4. Czy Zamawiający zaakceptuje osocza deficytowe do czynników krzepnięcia o trwałości 24 h na pokładzie analizatora?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
5. Czy Zamawiający zaakceptuje odczynniki do oznaczania białka C stabilne 5 dni na pokładzie analizatora?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
6. Czy ze względu na to, że jedyną pracą budowlaną jest stosunkowo prosta czynność montażu klimatyzatora, którą wykona firma będąca dostawcą klimatyzatora, Zamawiający zechce zrezygnować z podpisywania osobnej Umowy na prace remontowo-budowlane?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 2

I. Dotyczy SWZ, Rozdział III, pkt 4 ppkt 6):

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie: „jeśli dotyczy”.

Odczynniki oferowane w ramach **Części nr 3** zgodnie z Dyrektywą 98/79/WE należą do podkategorii "wszystkie inne wyroby do diagnostyki in vitro". Grupa ta jest definiowana w Dyrektywie IVD jako grupa o najniższym potencjalnym ryzyku i jako taka nie podlega obowiązkowi angażowania jednostki notyfikowanej ani wydawania świadectw partii wyrobów w procedurze znakowania CE oraz rejestracji wyrobów IVD. Do powyżej grupy zostały zaklasyfikowane oferowane przez nas produkty. Jednocześnie dzięki posiadanej certyfikacji ISO 9001 i ISO 13486 możemy potwierdzić, że każdy wyrób Wykonawcy (i tym samym każda partia odczynników Wykonawcy) musi przejść ściśle kontrole jakości zanim zostanie wprowadzona na rynek sprzedaży. W związku z powyższym, publikowanie dokumentacji dotyczącej pojedynczej partii (tj. świadectw dla danych partii wyrobów) nie jest dla naszych produktów obowiązkowe.

Uprzejmie prosimy również o odpowiednią modyfikację w **Załączniku nr 5 do SWZ – Umowa dostawy §2 ust. 6** i dodanie zwrotu „nie dotyczy Części nr 3”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i tym samym modyfikuje zapis Rozdziału III, pkt 4, ppkt 6) SWZ poprzez dodanie zwrotu: „jeśli dotyczy”. Jednocześnie Zamawiający w Załączniku nr 5 do SWZ – Wzorzec Umowy dostawy, w paragrafie 2 ust. 6 wprowadza zapis: „nie dotyczy Części nr 3”.

II. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy oraz Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz oferty oraz Załącznika nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia:

Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych części, do których Wykonawca przystępuje?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.





III. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 1 do Części nr 3, Warunki Serwisu Lp. 39:

Upzejmie prosimy o ujednoczenie zapisu z Załącznikiem nr 5b do SWZ – Umowa dzierżawy §4 ust. 4 i zastąpienie zwrotu „do 24 godzin (przez 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta).” wyrażeniem „do 48 godzin w dni robocze”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym zapis Załącznika nr 3 do SWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia, Załącznika nr 1 do Części nr 3, Warunki serwisu l.p. 39 otrzymuje brzmienie: „Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: „do 48 godzin w dni robocze”

Prosimy o tożsamą modyfikację w Załączniku nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 2 do Części nr 3, Warunki Serwisu Lp. 21 oraz w Załączniku nr 3 do Części nr 3, Warunki Serwisu Lp. 17 i w Załączniku nr 4 do Części nr 3, Warunki Serwisu Lp. 35.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza tożsamą modyfikację w wszystkich załącznikach dotyczących Części nr 3 – Warunki serwisu. Tym samym Załącznik nr 2 do Części nr 3, Warunki Serwisu Lp. 21 oraz w Załączniku nr 3 do Części nr 3, Warunki Serwisu Lp. 17 i w Załączniku nr 4 do Części nr 3, Warunki Serwisu Lp. 35. – otrzymują brzmienie: „Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii: „do 48 godzin w dni robocze”

IV. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 1 do Części nr 3, Warunki Serwisu Lp. 40:

Upzejmie prosimy o ujednoczenie zapisu z Załącznikiem nr 5b do SWZ – Umowa dzierżawy §4 ust. 5 i zastąpienie zwrotu „(przez 7 dni w tygodniu, w tym soboty, niedziele, święta)” wyrażeniem „w dni robocze”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym zapis Załącznika nr 3 do SWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 1 do Części nr 3, Warunki Serwisu Lp. 40 otrzymuje brzmienie: „Czas usunięcia zgłoszonej awarii do 2 dni roboczych od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii.”

Prosimy o tożsamą modyfikację w Załączniku nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 2 do Części nr 3, Warunki Serwisu Lp. 22 oraz w Załączniku nr 3 do Części nr 3, Warunki Serwisu Lp. 18 i w Załączniku nr 4 do Części nr 3 Warunki Serwisu Lp. 36.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza tożsamą modyfikację w wszystkich załącznikach dotyczących Części nr 3 – Warunki serwisu. Tym samym Załącznik nr 2 do Części nr 3, Warunki Serwisu Lp. 22, Załącznik nr 3 do Części nr 3, Warunki Serwisu Lp. 18 i Załącznik nr 4 do Części nr 3 Warunki Serwisu Lp. 36. Otrzymują brzmienie: „Czas usunięcia zgłoszonej awarii do 2 dni roboczych od momentu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii.”

V. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 1 do Części nr 3, Warunki Serwisu Lp. 41:

Upzejmie prosimy o ujednoczenie zapisu z Załącznikiem nr 5b do SWZ – Umowa dzierżawy §4 ust. 6 i zastąpienie zwrotu „W przypadku awarii trwającej dłużej niż 48 godzin” wyrażeniem „W przypadku awarii trwającej dłużej niż 14 dni”.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 3 do SWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia – w zakresie Załącznika nr 1 do Części nr 3, Warunki Serwisu, l.p. 41, który otrzymuje brzmienie: „W przypadku awarii trwającej dłużej niż 2 dni robocze zapewnienie wykonania badań na zastępczym analizatorze lub wskazanie podwykonawcy dysponującego tym samym lub porównywalnej jakości analizatorem, który w czasie naprawy będzie wykonywał badania na koszt Wykonawcy.”

Jednocześnie Zamawiający dokonuje ujednoczenia w/w zapisu z Załącznikiem nr 5b do SWZ – Wzorem Umowy dzierżawy §4 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: „W przypadku awarii trwającej dłużej niż 2 dni robocze Wyzierzawiający zapewni wykonanie badań na zastępczym aparacie lub wskaże Podwykonawcę dysponującego tym samym lub porównywalnej jakości aparatem, który w czasie naprawy będzie wykonywał badania, na koszt Wyzierzawiającego.”

Prosimy o tożsamą modyfikację w Załączniku nr 3 do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 2 do Części nr 3, Warunki Serwisu Lp. 23. oraz w Załączniku nr 3 do Części nr 3, Warunki Serwisu Lp. 19 i w Załączniku nr 4 do Części nr 3 Warunki Serwisu Lp. 37.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza tożsamą modyfikację w Załączniku nr 3 do SWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 2 do Części nr 3, Warunki Serwisu, l.p. 23 oraz w Załączniku nr 3 do Części nr 3, Warunki serwisu l.p. 19 i w Załączniku nr 4 do części nr 3, Warunki Serwisu Lp. 37

VI. Dotyczy Załącznika nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 1 do Części nr 3, Wymagania Dodatkowe Lp. 47:

Prosimy o ujednoczenie zapisu z Załącznikiem nr 5 do SWZ – Umowa dostawy §2 ust. 2 i zastąpienie zwrotu „Dostawa odczynników w przeciągu max. 3 dni roboczych” wyrażeniem „Dostawa odczynników w przeciągu max. 5 dni roboczych”.

Prosimy o tożsamą modyfikację w Załączniku nr 3 do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia, Załączniku nr 4 do Części nr 3, Wymagania Dodatkowe Lp. 43.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i tym samym modyfikuje zapis Załącznika nr 3 – Opisu Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 1 do Części nr 3, Wymagania Dodatkowe l.p. 47, który otrzymuje brzmienie: „Dostawa odczynników w przeciągu max. 5 dni roboczych”.

Zamawiający wprowadza tożsamą modyfikację w Załączniku nr 3 do SWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia, Załączniku nr 4 do Części nr 3, Wymagania Dodatkowe, l.p. 43.

VII. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Umowa dostawy §2 ust. 3:

Prosimy o uzupełnienie zapisu dotyczącego terminu dostaw pilnych odczynników. Proponujemy dodanie po zwrocie „w terminie 24 godzin” wyrażenia „w dni robocze przy założeniu, że zamówienie Wykonawca otrzyma do godz. 13:30 danego dnia roboczego”.

Dodanie powyższego zapisu umożliwi Wykonawcy zaproponowanie krótkiego terminu dostaw odczynników.





Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, Tym samym zapis Załącznika nr 5 do SWZ – Umowa dostawy §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Dostawy w trybie awaryjnym będą realizowane w terminie do 24 godzin w dni robocze od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego na zasadach określonych w ust. 2, przy założeniu, że Wykonawca otrzyma zamówienie do godziny 13:30 danego dnia roboczego.”

VIII. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Umowa dostawy §2 ust. 4:

Czy Zamawiający dopuści fakturę, która zawiera wszystkie wymagane przez Zamawiającego dane oprócz nazwy producenta/wytwórcy w przypadku gdy nazwa producenta/wytwórcy będzie każdorazowo wskazana na opakowaniu dostarczonych odczynników?

Dopuszczenie takiej możliwości jest również korzystne dla Zamawiającego gdyż umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego większej liczby ofert, nie blokując rezygnacji Wykonawcy z udziału w postępowaniu z powodu technicznej formy faktury.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisem paragrafu 2 ust. 4 Wzoru Umowy dostawy – Załącznika nr 5 do SWZ „W przypadku braku możliwości umieszczenia powyższych informacji na fakturze (m.in. nazwy producenta/wytwórcy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zamieścił je w odrębnym dokumencie dołączonym do faktury.”

IX. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Umowa dostawy §2 ust. 5:

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy? Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: [www.....](#)”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza proponowany zapis do Załącznika nr 5 do SWZ – Umowa dostawy §2 ust. 5, poprzez uzupełnienie zapisu o proponowany zwrot: „lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: [www.....](#)”.

X. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Umowa dostawy §3 ust. 2:

Czy Zamawiający dopuści kontakt e-mailowy w sprawach merytorycznych i informowania o potencjalnych zagrożeniach, na wskazany w §3 ust. 2 adres e-mail w celu przyspieszenia przepływu informacji między Wykonawcą a Użytkownikiem w trakcie realizacji Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

XI. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Umowa dostawy §5 ust. 6:

Prosimy o usunięcie zapisu lub o jego modyfikację poprzez dodanie zdania:

„z wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Upierzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację w Załączniku nr 5b do SWZ – Umowa dzierżawy §5 ust. 10.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

XII. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Umowa dostawy §9 ust. 1 lit b i c:

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od kwoty netto określonej w §4 ust. 1.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia netto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Prosimy również o tożsamą modyfikację w Załączniku nr 5b – Umowa dzierżawy §6 ust. 1 lit. c i d.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

XIII. Dotyczy Załącznika nr 5a do SWZ – Umowa na roboty budowlane (przystosowanie pomieszczeń):

Upierzejmie prosimy o potwierdzenie, że Załącznik nr 5a do SWZ – Umowa na roboty budowlane nie dotyczy Części nr 3.

Wymagany przez Zamawiającego w Części 3 zakres prac nie stanowi robót budowlanych ani remontu w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, lecz prace mające na celu utrzymanie obiektu budowlanego w dobrym stanie techniczno-użytkowym (jak np. malowanie ścian).

Wymagane w części 3 roboty należy zakwalifikować jako **bieżącą konserwację**, która nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.

Ewentualnie prosimy o dostosowanie postanowień Załącznika nr 5a do SWZ dla części nr 3 do wskazanego w Załączniku nr 3 do SWZ – Opisze Przedmiotu Zamówienia, Załączniku nr 4 do Części nr 3 lit. C rodzaj prac.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymagany w Części nr 1, Części nr 2, Część nr 3, Części nr 4 zakres prac nie stanowi robót budowlanych ani remontu w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. Wymagane w/w Częściach prace należy zakwalifikować jako bieżącą konserwację, która nie wiąże się z koniecznością pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 5a – Wzoru umowy poprzez dostosowanie jego postanowień zawartych w paragrafie 1 i w paragrafie 2 do wymaganego zakresu prac określonych w Opisze Przedmiotu Zamówienia we wszystkich Częściach postępowania.





XIV. Dotyczy Załącznika nr 5b do SWZ – Umowa dzierżawy §2 ust. 4:

Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

XV. Dotyczy Załącznika nr 5b do SWZ – Umowa dzierżawy §3 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanych zapisów, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis:

„Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydierżawiającego (Wykonawcy).”

Uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację w §3 ust. 3 lit. e) i usunięcie zwrotu „określonej w §3 ust. 1”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

XVI. Dotyczy Załącznika nr 5b do SWZ – Umowa dzierżawy §6 ust. 1 lit. b):

Uprzejmie prosimy o zastąpienie wyrażenia „wartości umowy netto określonego w §5 ust. 1 ” zwrotem „wartości czynszu miesięcznego określonego w §5 ust. 2”.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

XVII. Dotyczy Wzoru Załącznika do Umowy dzierżawy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych §10 ust. 4:

Uprzejmie prosimy pod zwrocenie „Kontakt do Inspektorów Ochrony Danych” wyrażenia „lub osoby do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych”.

Wykonawca nie polega obowiązkowi posiadania Inspektora Danych Osobowych, ale może podać kontakt od osoby zajmującej się sprawami z zakresu ochrony danych osobowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego zapisu w paragrafie 10 ust. 4 wzoru Załącznika do Umowy dzierżawy – Wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zestaw nr 3

I. Dotyczy OPZ Część nr 3, Załącznik nr 1 Tabela A pkt 9:

W związku z wymogiem zaoferowania analizatora z możliwością oznaczania parametru PLT-O, prosimy Zamawiającego, o potwierdzenie, iż wymaga aby wymieniony parametr miał określony zakres liniowości, nie gorszy niż PLT-I, potwierdzony specyfikacją zawartą w instrukcji producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

II. Dotyczy OPZ Część nr 3, Załącznik nr 1 Tabela A, pkt 13:

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy uzna parametr za spełniony przy zaoferowaniu analizatora podstawowego o wydajności 100 oznaczeń na godzinę dla oznaczeń CBC i CBC+DIFF i 83 oznaczeń na godzinę dla oznaczeń CBC+DIFF+RET?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

III. Dotyczy OPZ Część nr 3, Załącznik nr 1 Tabela A pkt 15:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu, czy wymagana liniowość dla próbek pierwotnych bez wstępnego rozcieńczenia zarówno manualnego, jak i automatycznego dla RBC ma wynosić minimum 8 mln w 1 µl, dla WBC minimum 400 x 10³ w 1 µl, zaś dla PLT minimum 4000 x 10³ w 1µl?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

IV. Dot. OPZ Część nr 3, Załącznik nr 1 Tabela A pkt 24; Załącznik nr 4 Tabela A pkt 21:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany analizatora miał również możliwość manualnego wyboru dodatkowego trybu pomiaru dla próbek leukopenicznych, co daje Użytkownikowi możliwość decyzji kiedy i w jakiej sytuacji klinicznej dodatkowy pomiar będzie wykonany?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany parametr.

V. Dotyczy OPZ Część nr 3, Załącznik nr 1 Tabela A pkt 26; Załącznik nr 4 Tabela A pkt 23:

W związku z tym, że aktualnie na rynku diagnostycznym funkcjonuje kilku dostawców zapewniających udział w Zewnątrz laboratoryjnej Międzynarodowej Kontroli Jakości, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie w jakim programie Kontroli chciałby uczestniczyć.

Odpowiedź: Kontrola Jakości Randox

VI. Dotyczy OPZ Część nr 3, Załącznik nr 1 Tabela A pkt 27; Załącznik nr 4 pkt 24:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, iż wymaga zaoferowania jednego rodzaju materiału kontrolnego dla wszystkich parametrów krwi obwodowej łącznie z retikulocytami.

Odpowiedź: Tak

VII. Dotyczy OPZ Część nr 3,

Załącznik nr 1 Tabela A pkt 38, pkt 39, pkt 40;





Załącznik nr 2 Tabela A pkt 20, pkt 21, pkt 22;

Załącznik nr 3 Tabela A pkt 16, pkt 17, pkt 18;

Załącznik nr 4 Tabela A pkt 34, pkt 35, pkt 36;

Czy Zamawiający uzna parametry za spełnione przy zaoferowaniu:

- możliwości zgłaszania awarii i zgłoszeń serwisowych 24h/dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem ogólnego adresu email, numeru faksu, poczty głosowej;

- czasu reakcji (odebranie zgłoszenia) do 24h w dni robocze, do 36h w dni wolne od pracy i święta;

- aby przestąpienie do naprawy awarii nastąpiło w ciągu 24 godzin w dni robocze jeżeli niemożliwe jest usunięcie awarii w sposób zdalny;

- czasu usunięcia zgłoszonej awarii do 48 godzin w dni robocze;

- bezpośredni kontakt do Inżynierów Serwisu w godzinach 8-16 w dni robocze;

- telefoniczne i zdalne wsparcie techniczno-serwisowe w dni wolne od pracy w godzinach dyżuru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązania i odpowiednio modyfikuje zapisy w Części nr 3, tj.: Załącznika nr 1, Tabela A, pkt 38, pkt 39, pkt 40; Załącznika nr 2, Tabela A, pkt 20, pkt 21, pkt 22; Załącznika nr 3, Tabela A pkt 16, pkt 17, pkt 18; Załącznika nr 4 Tabela A pkt 34, 35, 36.

VIII. Dotyczy OPZ Część nr 3, Załącznik nr 1 Tabela A pkt 49; Załącznik nr 4 Tabela A pkt 44:

Zwracamy się z prośbą o podanie czy Zamawiający wymaga, aby oprócz instrukcji w języku polskim w formie papierowej oferowany analizator posiadał wbudowaną instrukcję obsługi w języku polskim, która daje możliwość automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizator oraz ułatwia wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji i czynności związanych z obsługą analizatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

IX. Dotyczy OPZ Część nr 3, Załącznik nr 2 Tabela A pkt 30:

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania odczynników i materiałów zużywalnych pochodzących od innego producenta niż oferowany analizator do przygotowywania i wybarwiania rozmazów krwi obwodowej. Zaznaczamy, że odczynników i materiałów zużywalnych są dedykowane do tego analizatora i dopuszczone do użytku przez producenta analizatora.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

X. Dotyczy OPZ Część nr 3, Załącznik nr 4 Tabela A pkt 6:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, że zaoferowany analizator do wykonywania badań CITO, o takich samych parametrach technicznych i wydajności, co analizator podstawowy, będzie wykorzystywany do oznaczania morfologii CBC, CBC+DIFF, a tym samym nie ma wymogu dostępności na tym analizatorze aplikacji umożliwiającej wykonywanie oznaczeń RET, PLT-O i analizy płynów z jam ciała.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

XI. Dotyczy OPZ Część nr 3, Załącznik nr 4 Tabela A pkt 12:

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy uzna parametr za spełniony przy zaoferowaniu analizatora do oznaczeń morfologii krwi w trybie cito o wydajności 100 oznaczeń na godzinę dla oznaczeń CBC i CBC+DIFF?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

XII. Dotyczy OPZ Część nr 3, Załącznik nr 4 A pkt 25:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie analizatora posiadającego pamięć wyników analizy (wraz z grafikami): 100 000 próbek oraz danych pacjentów - 10 000 osób.

Z przyczyn technicznych archiwizowanie nieograniczonej ilości wyników jest niemożliwe. Każde urządzenie posiada ograniczoną ilość pamięci.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zestaw nr 4

PYTANIA DO SWZ:

1. Dotyczy Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia, **Załącznik nr 1 do Części nr 1, A Zintegrowany system analizatorów biochemiczno – immunochemicznych przeznaczonych do badań chemii klinicznej i immunochemii z jednej próbki pierwotnej, pkt 8 oraz Załącznik nr 2 do Części nr 1, A Zintegrowany system analizatorów wsparcia biochemiczno – immunochemicznych przeznaczonych do badań z zakresu chemii klinicznej, immunochemii i diagnostyki zakażeń z jednej próbki pierwotnej, pkt. 8:**

Prosimy o potwierdzenie, czy ww punkty dotyczą reagentów do oznaczeń i nie dotyczą płynów systemowych? Jeśli dotyczą również płynów, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania jednego odczynnika systemowego różniącego się sposobem konfekcjonowania pomiędzy systemem głównym i wspomagającym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania jednego odczynnika systemowego różniącego się sposobem konfekcjonowania pomiędzy systemem głównym i wspomagającym.

2. Dotyczy Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia, **Załącznik nr 1 do Części nr 1, A Zintegrowany system analizatorów biochemiczno – immunochemicznych przeznaczonych do badań chemii klinicznej i immunochemii z jednej próbki pierwotnej, punkt 8 oraz Załącznik**





nr 2 do Części nr 1, A Zintegrowany system analizatorów wsparcia biochemiczno – immunochemicznych przeznaczonych do badań z zakresu chemii klinicznej, immunochemii i diagnostyki zakażeń z jednej próbki pierwotnej, pkt. 8 oraz Załącznik nr 1 do Części nr 1, A Zintegrowany system analizatorów biochemiczno – immunochemicznych przeznaczonych do badań chemii klinicznej i immunochemii z jednej próbki pierwotnej, punkt 13:

W związku z wymogiem kompatybilności odczynników pomiędzy systemami głównym i wspomagającym, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaferowania jednego odczynnika do wykonania na kanale otwartym, który przed wstawieniem go na pokład analizatora wymaga przelania całej jego zawartości do odpowiedniej kasety bez konieczności odmierzenia jakichkolwiek ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaferowania jednego odczynnika do wykonania na kanale otwartym, który przed wstawieniem na pokład analizatora wymaga przelania całej jego zawartości do odpowiedniej kasety bez konieczności odmierzenia ilości.

3. Dotyczy Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia, **Załącznik nr 1 do Części nr 1, B. Wykaz asortymentu odczynnikowego, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych zaplanowanych do wykonania 550 800 badań biochemicznych i immunochemicznych w zintegrowanym systemie analizatorów biochemiczno - immunochemicznym, 1 planowan ilość badań, poz. 5 oraz Załącznik nr 2 do Części nr 1, B. Wykaz asortymentu odczynnikowego, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych zaplanowanych do wykonania 349 680 badań biochemicznych i immunochemicznych w zintegrowanym systemie analizatorów wsparcia biochemiczno - immunochemicznym, poz. 14:**

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaferowania odczynnika o dolnym zakresie wykrywalności 0,3 mg/L i zakresie pomiarowym 0,6-350 mg/L?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony.

4. Dotyczy Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia, Wykaz asortymentu odczynnikowego poz. 29 i 31:
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaferowania odczynnika do HCG o dolnej granicy oznaczalności 0,2 mIU/ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku granicy wykrywalności testu 0,2mIU/ml i granicy próby ślepej 0,1mIU/ml, ze względu na zmianę sposobu definiowania dolnej granicy pomiarowej, zgodnie z nowymi wymogami EP17-A2 CLSI.

5. Dotyczy **Załącznik nr 1 do Części nr 2: Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów podstawowych połączonych ze sobą do kompleksowej analizy moczu (automatycznego wykonania badania fizykochemicznego moczu z automatyczną analizą elementów upostaciowionych moczu). A. Automatyczne analizatory do badania ogólnego oraz elementów upostaciowionych moczu (dwóch analizatory podstawowe): AUTOMATYCZNY ANALIZATOR DO ODCZYTU PASKÓW TESTOWYCH, Punkt 3.**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania analizatora z 2017 roku, po pełnym przeglądzie serwisowym i z pełną gwarancją bezpłatnego serwisu na cały okres trwania umowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza analizator z 2017 roku, po pełnym przeglądzie serwisowym i z pełną gwarancją bezpłatnego serwisu przez cały okres realizacji umowy.

6. Dotyczy **Załącznik nr 1 do Części nr 2: Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów podstawowych połączonych ze sobą do kompleksowej analizy moczu (automatycznego wykonania badania fizykochemicznego moczu z automatyczną analizą elementów upostaciowionych moczu). Załącznik nr 2 do Części nr 2: Dostawa odczynników, pasków, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badania ogólnego moczu wraz z dzierżawą analizatora wsparcia. A. Analizator do badania ogólnego moczu (analizator wsparcia), Punkt 3**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania analizatora z 2017 roku, po pełnym przeglądzie serwisowym i z pełną gwarancją bezpłatnego serwisu na cały okres trwania umowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza analizator z 2017 roku, po pełnym przeglądzie serwisowym i z pełną gwarancją bezpłatnego serwisu przez cały okres realizacji umowy.


7. Oferowane analizatory oraz systemy wymagają do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o odczynnikach, kontrolach, kalibratorach, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS. Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu? Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów).





GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

ul. Polna33, 60-535 Poznań, NIP: 781-16-21-484, REGON: 000288840, KRS: 0000002866

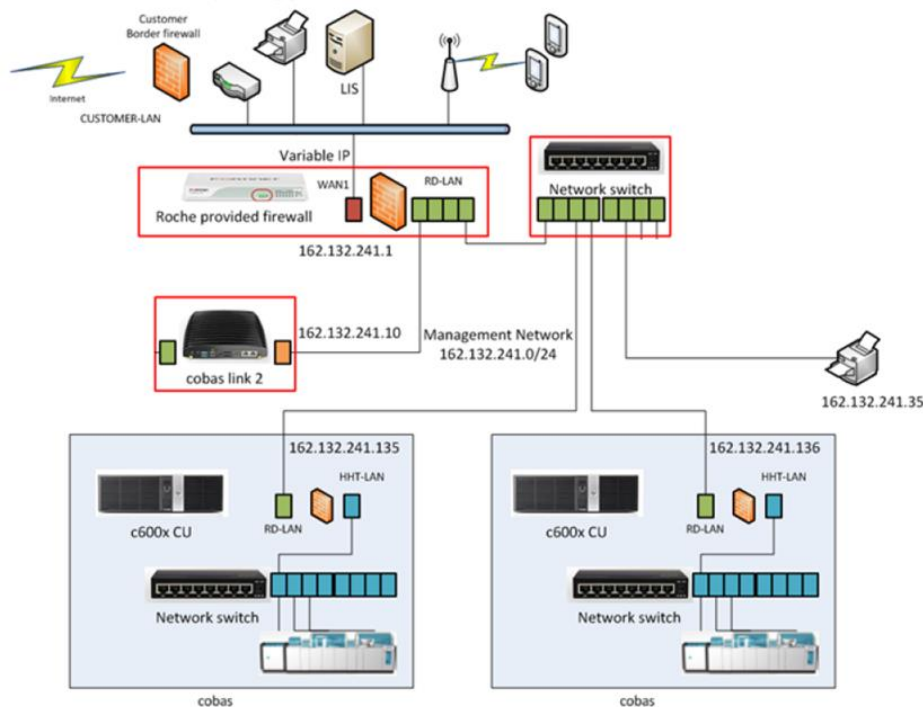

Odpowiedź: Zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu zgodnie ze specyfikacją zawartą w pytaniu.

8. Dotyczy Załącznika Nr 3 do SWZ, Część nr 1, Załącznik nr 1 do Części nr 1; B; 1. Planowana ilość badań oraz Załącznik nr 2 do Części nr 1, B, 1. Planowana ilość badań:

Prosimy o potwierdzenie, czy Planowana ilość badań na 2 lata zawiera ilości oznaczeń potrzebne do przeprowadzenia kalibracji i kontroli?

Odpowiedź: Tak, planowana ilość badań na 2 lata, zawiera ilości oznaczeń potrzebne do przeprowadzenia kalibracji i kontroli.

9. Dotyczy: Załącznika nr 3 do SWZ, Część Nr 1, Tabela 1: Odczynniki do badań biochemicznych i immunochemicznych oraz Część nr 2, Tabela 1 : Odczynniki do kompleksowej analizy moczu:

Prosimy o potwierdzenie, czy wartości w tabelach mają być wyliczone na okres 24 miesiące analogicznie jak w Tabelach 2 (czynsz dzierżawy)?

Odpowiedź: Tak.

10. Dotyczy: Załącznika nr 3 do SWZ, Część Nr 1, Tabela 1: Odczynniki do badań biochemicznych i immunochemicznych oraz Część nr 2, Tabela 1 : Odczynniki do kompleksowej analizy moczu: "UWAGA! Formularz należy dostosować do rodzaju oferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych z uwzględnieniem wymaganych ilości badań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załączniku nr 1 do SWZ."

Prosimy o zweryfikowanie odniesienia do Załącznika nr 1 do SWZ, ponieważ Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający koryguje oczywistą omyłkę pisarką występującą w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu asortymentowo – cenowym, występująca w zapisie umieszczonym pod Tabelą asortymentowo – cenową dotycząca odczynników, który otrzymuje brzmienie: : "UWAGA! Formularz należy dostosować do rodzaju oferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych z uwzględnieniem wymaganych ilości badań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załączniku nr 3 do SWZ." – w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.

11. Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ, Załącznik nr 2 do Części nr 1, pkt B, 1. Planowana ilość badań: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia kontroli zewnątrzlaboratoryjnej do parametru antygen raka płaskonabłonkowego (SCC-Ag) w związku z brakiem dostępności na rynku.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstąpi do wymogu zapewnienie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej do parametru SCC-Ag, jednakże w momencie pojawienia się na rynku tej kontroli, Wykonawca ma obowiązek jej zapewnienia.



GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

kontakt: office@gpsk.ump.edu.pl

KONTO BANKOWE BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002





12. Dot. załącznika nr 1 część 1 tabela nr 2 **Tabeli 2: Czynniki dzierżawy zintegrowanego systemu analizatorów biochemicznych – immunochemicznych przeznaczonych do badań chemii klinicznej i immunochemii – w okresie 24 miesięcy**: W związku z wymogiem zaoferowania oprogramowania do analizy ryzyka występowania najczęstszych aberracji chromosomowych u płodu zwracamy się z prośbą o możliwość wyceny tego systemu jako osobnych dwóch pozycji: koszt licencji i koszt konserwacji w **Tabeli 2: Czynniki dzierżawy zintegrowanego systemu analizatorów biochemicznych – immunochemicznych przeznaczonych do badań chemii klinicznej i immunochemii – w okresie 24 miesięcy**.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIA DO UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE – Załącznik nr 5a do SWZ

§2 ust. 1 lit. u) – W celu zapewnienia Wykonawcy możliwości wywiązania się z obowiązków wynikających z ww. zapisu prosimy o modyfikację postanowienia: „(...) w **odpowiednim** terminie wskazanym przez Zamawiającego **nie krótszym niż 10 dni roboczych**”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, tym samym modyfikuje zapis §2 ust. 1 lit. u) Wzoru umowy – Załącznika nr 5a, który otrzymuje brzmienie: „przywroćenie na własny koszt do stanu pierwotnego zaplecza budowy zorganizowanego przez Wykonawcę wraz z usunięciem szkód spowodowanych na skutek jego działania w trakcie robót, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych.”

§2 ust. 1 lit. v) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia zgodnie z propozycją: „usuwania usterek i wad w ramach gwarancji, w **terminie wynikającym z Umowy**”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

§2 ust. 1 lit. x) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia w taki sposób, aby w przypadkach, gdy wykonane badania potwierdzą zgodność/jakość materiałów koszty tych badań pokrywał Zamawiający?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

§4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z postanowienia końcowej części: „**jednakże nie później niż do dnia 31.05.2024 roku**”? Zwracamy uwagę, że ze względu na trwającą procedurę zamówieniową data zawarcia umowy jest trudna do ustalenia, a w związku z tym nie jest możliwe wskazanie przewidywanego początkowego terminu liczenia wskazanych w zapisie 30 dni. Bez względu na termin podpisania kontraktu Wykonawca powinien mieć zapewnioną możliwość wykonywania prac w ustalonym uprzednio i znanym mu czasie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

§6 ust. 8 – Czy Zamawiający doprecyzuje postanowienie poprzez wskazanie, że zmniejszenie zakresu umowy nie może być wyższe niż 10% wartości umowy brutto?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

§7 ust. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z postanowienia końcowej części: „co jednocześnie zwalnia Zamawiającego z zapłaty Wykonawcy tej części wynagrodzenia”? Zwracamy uwagę, że wątpliwości dotyczące rozliczeń z podwykonawcami nie powinny odnosić automatycznych skutków w sferze uprawnienia Wykonawcy do otrzymania należnego wynagrodzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

§8 ust. 16 pkt 2) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę frazy "2 dni" na "3 dni robocze"?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

§8 ust. 18 – Czy Zamawiający stosownie do brzmienia art. 471 k.c. i n. Wyrazi zgodę na zmianę słowa „gwarantuje” na „zobowiązuje się”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

§11 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie w postanowieniu **minimalnego** terminu na usunięcie wady robót na „14 dni”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapis §11 ust. 2 Wzoru umowy – Załącznika nr 5a do SWZ, który otrzymuje brzmienie: „Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady może zostać dokonane w formie pisemnej i e-mailem. Zamawiający zawiadamiając Wykonawcę o wadzie wyznaczy mu jednocześnie termin do jej usunięcia nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż miesiąc.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z faksowej formy informowania o wykryciu wady, pozostawiając formy pisemną i mailową, wykorzystywane obecnie powszechnie zarówno przez wykonawców jak i Zamawiających?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

§11 ust. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby usunąć z postanowienia fragment „i ryzyko”?

Wykonawca zwraca uwagę, że nie może ponosić odpowiedzialności za skutki działań/zaniechań podmiotów trzecich, których wybór pozostaje wyłącznie po stronie Zamawiającego, stosownie do treści art. 433 pkt 3) ustawy Pzp.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.





§12 ust. 1 pkt 1) i 2) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości współczynnika kary do 0,2%? Wskazujemy, iż powszechnie przyjętym współczynnikiem kary umownej za zwłokę dla umów o roboty budowlane jest kara od 0,05% do 0,5%. Należy mieć na względzie, że kara w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę także spełni należycie swoją funkcję stymulacyjną i kompensacyjną. Jednocześnie powyższe powinno uwzględniać fakt, że ryzyka kontraktowe (w tym związane z karami) są wliczane do ceny umownej przez wykonawców.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

§12 ust. 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie limitu kar do „20%”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

§13 ust. 2 oraz §14 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia/rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? Wyznaczenie dodatkowego czasu może w praktyce stanowić skuteczne narzędzie prewencyjne, zapobiegające potrzebie zerwania umowy i poszukiwania innego wykonawcy po nowej, zapewne wyższej cenie. Jednocześnie termin na działania naprawcze powinien zapewniać możliwość podjęcia niezbędnych działań.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

§14 ust. 7 – Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie postanowienia, stosownie do zasad odpowiedzialności Wykonawcy wynikających z Kodeksu cywilnego:

„Jeżeli Zamawiający rozwiąże Umowę z winy Wykonawcy, ma prawo odzyskania od Wykonawcy wszelkich strat, jakie poniósł, potrącając ich wartość z wynagrodzenia ustalonego w trybie określonym w ust. 6.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

PYTANIA DO UMOWY DZIERŻAWY – Załącznik nr 5b do SWZ

§2 ust. 2 – Czy stosownie do uwag dot. §4 ust. 1 umowy na roboty budowlane Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z postanowienia końcowej części: „jednakże nie później niż do dnia 30.06.2024 roku.”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

§4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu/części/modułu, a nie całego aparatu? Naprawy aparatury w ciągłym użytkowaniu są normalnym zjawiskiem, a w związku z tym, w pierwszej kolejności Wykonawca powinien mieć zapewnioną możliwość przywrócenia sprawności sprzętu. Pozostawienie tak restrykcyjnych zapisów, jak proponowane obecnie przez Zamawiającego będzie wiązało się z ponoszeniem przez Wykonawcę nieproporcjonalnie dużego ryzyka finansowego, które będzie musiało zostać uwzględnione w cenie oferty, co wpłynie na koszt zamówienia, a co finalnie nie jest zjawiskiem korzystnym dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

§5 ust. 10 - Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z art. 433 pkt 3) ustawy Pzp, dlatego prosimy o modyfikację zapisów zgodnie z poniższym:

„Opóźnienia w płatnościach przez Dzierżawcę **do 30 dni**, nie spowodują zaprzestania realizacji przedmiotu umowy przez Wyzdierżawiającego.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

§6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie limitu kar do „20%”? Zaproponowana wartość jest stosowana powszechnie w branży medycznej. Należy także mieć na uwadze, że limity odpowiedzialności kontraktowej wykonawcy są zmuszeni uwzględniać w ramach oferty cenowej. Jednocześnie, odpowiedzialność na zasadach ogólnych k.c. każdorazowo dopełnia ochronę Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

§7 ust. 3 b) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania / odstąpienia / wypowiedzenia umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? Wyznaczenie dodatkowego terminu może w praktyce stanowić skuteczne narzędzie prewencyjne, zapobiegające potrzebie zerwania umowy i poszukiwania wykonawcy po nowej, zapewne wyższej cenie. Jednocześnie termin na działania naprawcze powinien zapewniać możliwość podjęcia niezbędnych działań.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

§8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uwzględni w treści postanowienia sposób liczenia okresu obowiązywania umowy poprzez wskazanie, że dzierżawa będzie obowiązywać „nie wcześniej niż od daty odbioru prac adaptacyjno - remontowych – stosownie do regulacji wynikających z §2 ust. 2?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

§9 ust. 5.5. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia w taki sposób, aby podstawą waloryzacji była także średnia arytmetyczna z dwóch następujących po sobie kwartalnych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikających z komunikatów Prezesa GUS poprzedzających wnioski o waloryzację, wynosząca co najmniej 5%? Zaproponowane zasady waloryzacji nie uwzględniają uwarunkowań rynkowych,





które w ocenie Wykonawcy w prosty sposób w większości przypadków przekładają się na działalność przedsiębiorców. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia poprzez dodanie do niego następujących zapisów:

„Warunek powstania uprawnienia do żądania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest uważany za spełniony także w przypadku, gdy średnia arytmetyczna z dwóch następujących po sobie kwartalnych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikających z komunikatów Prezesa GUS poprzedzających wnioski o waloryzację wynosi co najmniej 5%.

Przyjmuje się, że wartość inflacji, o której mowa wyżej wpływa na koszt wykonania zamówienia odpowiednio do wysokości średniej arytmetycznej, o której mowa w tym postanowieniu, przy czym waloryzacja następować będzie w wysokości wynoszącej połowę wyliczonego jak wyżej wskaźnika.”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

PYTANIA DO UMOWY DOSTAWY – Załącznik nr 5 do SWZ

§5 ust. 6 - Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z art. 433 pkt 3) ustawy Pzp, dlatego prosimy o modyfikację zapisów zgodnie z poniższym:

„Opóźnienia w płatnościach przez Dzierżawcę **do 30 dni**, nie spowodują zaprzestania realizacji przedmiotu umowy przez Wydierżawiającego.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

§7 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

§9 ust. 1 lit. a. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wartości współczynnika kary do 0,7%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

§9 ust. 1 lit. b. oraz c. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację ww. postanowień w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia netto dotyczącego **niezrealizowanej części umowy**? Jeśli dostawy towaru będą w znaczącej mierze realizowane w sposób prawidłowy w trakcie trwania umowy, a dla przykładu – przyczyna rozwiązania będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru lub wystąpi pod koniec okresu obowiązywania umowy, to zastrzeżona kara umowna naliczana od ogólnej wartości całej umowy będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. Ponadto, zgodnie z §2 ust. 8 Wykonawca nie ma pewności co do realizacji pełnego zakresu umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

§9 ust. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez zmniejszenie wartości maksymalnej kar do poziomu 15%? Zaproponowana przez Zamawiającego wartość w sposób ewidentny odbiega od wartości przyjmowanych na rynku, nie stanowiąc wobec treści §2 ust. 8 wzoru mechanizmu ochronnego dla Wykonawcy, przewidzianego przez ustawodawcę. Należy zauważyć, że w sytuacjach gdy szkoda przewyższa zastrzeżone kary Zamawiający może dochodzić odpowiedzialności uzupełniającej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

§10 ust. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego postanowienia stosownie do brzmienia art. 433 pkt 1) ustawy Pzp oraz zasad ogólnych odpowiedzialności dłużnika za zawnioną nieterminową realizację obowiązków (art. 471 k.c.) poprzez zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”?

Ponadto, w związku z tym, że termin realizacji zamówień są liczone w dniach roboczych zwracamy się o zmianę frazy "dni kalendarzowe" na "dni robocze"?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

§10 ust. 5 oraz §11 ust. 2 pkt b) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do tychże postanowień zastrzeżenia, że przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowej realizacji umowy i wyznaczy termin nie krótszy niż 5 dni roboczych na prawidłową realizację umowy? Chcąc zapobiegać potrzebie poszukiwania nowego wykonawcy proponujemy, aby ewentualne naruszenia mogły zostać naprawione w ramach bieżącego kontraktu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

§13 ust. 5.5. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia w taki sposób, aby podstawą waloryzacji była także średnia arytmetyczna z dwóch następujących po sobie kwartalnych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikających z komunikatów Prezesa GUS poprzedzających wnioski o waloryzację, wynosząca co najmniej 5%? Zaproponowane zasady waloryzacji nie uwzględniają uwarunkowań rynkowych, które w ocenie Wykonawcy w prosty sposób w większości przypadków przekładają się na działalność przedsiębiorców. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia poprzez dodanie do niego następujących zapisów:

„Warunek powstania uprawnienia do żądania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest uważany za spełniony także w przypadku, gdy średnia arytmetyczna z dwóch następujących po sobie kwartalnych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikających z komunikatów Prezesa GUS poprzedzających wnioski o waloryzację wynosi co najmniej 5%.

Przyjmuje się, że wartość inflacji, o której mowa wyżej wpływa na koszt wykonania zamówienia odpowiednio do wysokości średniej arytmetycznej, o której mowa w tym postanowieniu, przy czym waloryzacja następować będzie w wysokości wynoszącej połowę wyliczonego jak wyżej wskaźnika.”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.





PYTANIA DO UMOWY POWIERZENIA – Załącznik do umowy dzierżawy

§2 ust. 1 lit. g - RODO nakłada na administratora obowiązek zgłoszenia stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. Wedle regulacji *Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679* termin 72h na zawiadomienie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 RODO rozpoczyna swój bieg w przypadku Administratora dopiero od powiadomienia go o tym fakcie przez procesora. Proponowany przez Zamawiającego termin w zależności od rodzaju incydentu naruszenia danych – może być terminem niewystarczającym, niedostosowanym do danej sytuacji faktycznej. Wykonawca proponuje zatem jego wydłużenie do „48 godzin”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

§4 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na podanie informacji o planowanym audycie oraz jego zakresie na „minimum 14-dniowy” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

§4 ust. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw nr 5

Część nr 2:

1) Prosimy o podanie dokładnych wymiarów obecnych drzwi i otworu drzwiowego x 2.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, co następuje: obecnie występują drzwi pływające, głównie drewniane, drewnopochodne, malowane. Ościeżnice regulowane i opaski dekoracyjne drewniane, drewnopochodne, malowane. Szerokość światła w przejściu drzwi nr 1 to 90cm. Szerokość światła w przejściu drzwi nr 2 to 130cm, gdzie światło w przejściu skrzydła głównego to 90cm. Skrzydło o szerokości 40cm blokowane – otwieralne. Ościeżnice obudowane opaskami systemowymi w kolorze drzwi i ościeżnicy.

2) Prosimy o podanie dokładnych wymiarów (szerokość, długość, wysokość) powierzchni płytek do przygotowania i malowania.

Odpowiedź: Łączna powierzchnia płytek ceramicznych pomieszczenia właściwego i przedsionka, przeznaczonych do malowania farbą przeznaczoną do płytek ceramicznych, do pomieszczeń typu: laboratorium wynosi 32m². Płytki sięgają do wysokości 2,14m od podłogi.

3) Prosimy o podanie dokładnych wymiarów powierzchni ścian i sufitów do malowania.

Odpowiedź: Łączna powierzchnia ścian i sufitów pomieszczenia właściwego i przedsionka przeznaczonych do malowania farbą przeznaczoną do pomieszczeń typu laboratorium wynosi 33,5m². Malowanie ścian od wysokości 2,14m.

4) Prosimy o podanie dokładnych wymiarów granicznych dot. miejsca do zamocowania klimatyzatora

Odpowiedź: Jednostka wewnętrzna o szerokości nie większej niż 90cm, wysokości nie większej niż 35cm. Wysokość montażu jednostki wewnętrznej od podłogi 240cm.

Część nr 2:

Wnioskujemy o podanie rodzaju drzwi (2 szt.), które obecnie znajdują się w laboratorium i przeznaczone są do wymiany (czy futryna/ościeżnica jest drewniana, czy metalowa czy inna i jaka) oraz wnioskujemy o informację na jaki rodzaj ościeżnicy (czy futryna/ościeżnica jest drewniana, czy metalowa czy inna i jaka) na zostać dokonana wymiana.

Odpowiedź: Obecnie występują drzwi pływające, głównie drewniane, drewnopochodne, malowane. Ościeżnice regulowane i opaski dekoracyjne drewniane, drewnopochodne, malowane. Ościeżnice obudowane opaskami systemowymi w kolorze drzwi i ościeżnicy.

W ramach wykonywanych prac należy kompleksowo wymienić obecne drzwi na drzwi wykonane z aluminium (skrzydło, ościeżnice, opaski, obudowy) w kolorze białym, uzgodnionym z Zamawiającym, w celu licowania kolorystycznego z innymi drzwiami, uwzględnić montaż odpowiednich do rozwiązania opasek, maskownic, listew systemowych w celu odtworzenia zabudowy zarówno ścian jak i podłogi.

Zestaw nr 6

Prosimy o wyjaśnienia dotyczące części nr 2 zawarte w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do SWZ.

Czy Zamawiający zaakceptuje analizator hybrydowy w którym moduł do osadu i moduł do pasków stanowią jeden analizator, co pozwoli na zaoszczędzenie cennej przestrzeni laboratoryjnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany analizator hybrydowy przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Zestaw nr 7

PYTANIA DO SWZ:

Dotyczy Załącznik nr 1 do Części nr 1:

Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemiczno –immunochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu analizatorów biochemiczno-immunochemicznego przeznaczonych do badań z zakresu chemii klinicznej i immunochemii z jednej próbki pierwotnej wraz z zapewnieniem prawidłowych warunków pracy analizatorów poprzez dostarczenie 3 klimatyzatorów oraz podłączenie analizatorów do systemu informatycznego Eskulap a także przystosowanie pomieszczeń do w/w analizatorów. A. Zintegrowany





system analizatorów biochemiczno – immunochemicznych przeznaczonych do badań chemii klinicznej i immunochemii z jednej próbki pierwotnej pkt 53, Załącznik nr 2 do Części nr 1: Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemiczno - immunochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu analizatorów wsparcia biochemiczno-immunochemicznego, przeznaczonych do badań z zakresu chemii klinicznej, immunochemii, diagnostyki zakażeń oraz do badań immunochemicznych – badań specjalistycznych, w tym przesiewowej diagnostyki prenatalnej wraz z oprogramowaniem do analizy ryzyka występowania najczęstszych aberracji chromosomowych u płodu z jednej próbki pierwotnej oraz podłączenie zintegrowanego systemu analizatorów pomocniczych do systemu informatycznego Eskulap, z dwukierunkową transmisją danych. A. Zintegrowany system analizatorów wsparcia biochemiczno – immunochemicznych przeznaczonych do badań z zakresu chemii klinicznej, immunochemii i diagnostyki zakażeń z jednej próbki pierwotnej. Punkt 31, Część nr 2 Dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawa dwóch analizatorów podstawowych połączonych ze sobą do kompleksowej analizy moczu (ze stołem laboratoryjnym): automatycznego wykonania badania fizykochemicznego moczu oraz analiza elementów upostaciowionych wraz z zapewnieniem prawidłowych warunków pracy analizatorów poprzez dostarczenie klimatyzatora. Dostawa odczynników kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych i dzierżawa analizatora wsparcia. Podłączenie analizatorów podstawowych oraz analizatora wsparcia do systemu informatycznego Eskulap z dwukierunkową transmisją danych, a także przystosowanie pomieszczenia do w/w analizatorów na okres 24 miesięcy. Załącznik nr 1 do Części nr 2: Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów podstawowych połączonych ze sobą do kompleksowej analizy moczu (automatycznego wykonania badania fizykochemicznego moczu z automatyczną analizą elementów upostaciowionych moczu). A. Automatyczne analizatory do badania ogólnego oraz elementów upostaciowionych moczu (dwóch analizatory podstawowe), punkt 35, Załącznik nr 2 do Części nr 2: Dostawa odczynników, pasków, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badania ogólnego moczu wraz z dzierżawą analizatora wsparcia. A. Analizator do badania ogólnego moczu (analizator wsparcia) punkt 15.

Zwracamy się z prośbą o szczegółowy opis zakresu integracji.

Odpowiedź: Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wymaga, aby dostarczone analizatory laboratoryjne zostały zintegrowane z posiadanym przez Zamawiającego systemem LIS Eskulap. Zamawiający wymaga komunikacji dwukierunkowej (wysyłanie zleceń i odbieranie wyników badań). Zamawiający nie przewiduje pośredniczenia w rozmowach z dostawcą systemu LIS i integracji z ich systemami. Koszty integracji są częścią ceny oferty składanej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. Zamawiający nie posiada licencji umożliwiających wykonanie integracji dostarczanych urządzeń z systemem LIS Eskulap.

Dotyczy Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia, Wykaz asortymentu odczynnikowego poz. 29:

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania odczynnika do oznaczania HCG o dolnej granicy wykrywalności 0,2 mIU/ml? W związku z nowymi wymogami EP17-A2 CLSI (Instytutu Standardów Klinicznych i Laboratoryjnych; dawniej NCCLS) zmienił się sposób definiowania dolnej granicy pomiarowej i obecnie dla testu Elecsys HCG opisany jest jako: granica próby ślepej = 0,1 mIU/ml, granica wykrywalności = 0,2 mIU/ml. Aktualny opis w ulotkach metodycznych nie jest związany ze zmianą składu odczynnika, który pozostaje taki sam, a jedynie z redefinicją dolnej granicy pomiarowej.

Odpowiedź: Tak uznamy warunek za spełniony w przypadku granicy wykrywalności testu 0,2mIU/ml i granicy próby ślepej 0,1mIU/ml ze względu na zmianę sposobu definiowania dolnej granicy pomiarowej, zgodnie z nowymi wymogami EP17-A2 CLSI.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

