

Milicz, 20.02.2024 r.

Dotyczy: postępowania na dostawę opatrunków
Nr sprawy MCM/WSM/ZP04/2024

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

ZADANIE NR. 1

Pytanie 1

Pakiet 1 poz. 7-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji z uwagi na fakt, że producent zaprzestał produkcji i sprzedaży opisanego opatrunku?

Odpowiedź: NIE

ZADANIE NR. 4

Pytanie 2

ZADANIE Nr 4, Poz. nr 1 –Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przenośnej jednorazowej pompy próżniowej generującej w sposób ciągły podciśnienie o wartości 120 mmHg, przeznaczona dla jednego pacjenta, działająca 21 dni. W zestawie zawierająca komplet baterii 2szt. AA, dren łączący pompę z opatrunkiem ze złączem „Luer” oraz 2 szt. opatrunków (różne rozmiary do wyboru przez Zamawiającego) z możliwością wymiany baterii w trakcie terapii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 3

2.ZADANIE Nr 4, Poz. nr 2 –Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków do terapii podciśnieniowej, posiadających delikatny silikonowy przyłepiec, rdzeń zamykający wysięk i szkodliwe komponenty w swojej strukturze. Opatrunek posiada dren kompatybilny z pompą do terapii podciśnieniowej i umożliwiający zastosowanie kompresjoterapii. Kanały w rdzeniu pozwalają na przemieszczanie się wysięku poprzez strukturę opatrunku. Warstwa pianki wspomaga rozprowadzenie podciśnienia. Zewnętrzna warstwa folii zapewnia barierę przeciwko bakterii, jest wodoodporna. Dostarczany w zestawie z paskami mocującymi (6 szt.) Do zastosowania z pompą do Podciśnieniowej Terapii Ran. Dostępnych w rozmiarach: 10 x 20 cm, 10 x 30 cm, 10 x 40 cm, 16 x 16 cm, 16 x 21 cm, 16 x 31 cm, 21 x 21 cm, 26 x 26 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

ZADANIE NR 6

Zadanie 6, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści tupfer gazowy z nitką RTG typu fasolka 15x15cm?

Odpowiedź: TAK

Zadanie 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści tupfer gazowy z nitką RTG typu kula 20x20cm lub 30x30cm?

Odpowiedź: TAK 30x30

Zadanie 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści tupfer gazowy z nitką RTG typu kula 20x20cm?

Odpowiedź: TAK

ZADANIE NR 10

Zadanie 10, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: TAK

ZADANIE 10, POZYCJA 10

Czy Zamawiający dopuści setony pakowane a'200szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: TAK

ZADANIE 10, POZYCJA 16, 17

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'40szt, przewiązywane 4 x 10szt?

Odpowiedź: NIE

ZADANIE 10, POZYCJA 18

Czy Zamawiający dopuści serwety 4 warstwowe?

Odpowiedź: NIE

ZADANIE 10, POZYCJA 20-21

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2szt lub a'5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: NIE

ZADANIE 10, POZYCJA 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a'10 sztuk w opakowaniu, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: TAK

ZADANIE 10, POZYCJA 10

Czy Zamawiający dopuści seton a'200 sztuk w opakowaniu, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: TAK

ZADANIE NR 12

Zadanie nr 12 poz. 1-2: Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk.

Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia, zawartym w SWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

Odpowiedź: TAK

ZADANIE 12, POZYCJA1-3:

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga opakowania, w którym jest 30 szt. pieluchomajtek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga(w przypadku mniejszej ilości w opakowaniu wymagane przeliczenie)

ZADANIE 12, POZYCJA 1-3: Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.

Odpowiedź: TAK

ZADANIE 12, POZYCJA 1-3: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu ciężkim. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki z przedzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Cztery przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Indykator wilgotności: tuszowy nadruk - rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy- dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną po wpływem cieczy. Oddychające w całości, laminat w części centralnej, włóknina w obszarze bioder?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

ZADANIE 12, POZYCJA 1-3: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o następujących chłonnościach (wg. metody ISO 11948-1) orazretencji(badana metodą NAFC)

Rozm. M - 2800 g, retencja 790 g

Rozm. L - 3100 g, retencja 920 g

Rozm. XL - 3100 g, retencja 920 g

Odpowiedź: TAK

Dot. Umowy:

1. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: TAK

1. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Zadanie nr 12, pozycje: 1, 2, 3 i 7): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

2. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Zadanie nr 12; pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtki dla dorosłych:
 - z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza;

Odpowiedź: NIE

- z falbankami wewnętrznymi skierowanymi do wewnątrz, które unoszą się tworząc rynną kierującą mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu);

Odpowiedź: NIE

- posiadające system szybkiego wchłaniania, który utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta;
- chłonności:
 - ✓ Pozycja 1 - co najmniej 3070g;

Odpowiedź: TAK

- ✓ Pozycja 2 - co najmniej 3180g;

Odpowiedź: TAK

- ✓ Pozycja 3 - co najmniej 2850g.

Odpowiedź: TAK

Różnica pomiędzy oczekiwaną przez Zamawiającego chłonnością wyrobów, a chłonnością oferowanych produktów jest znikoma i w żaden sposób nie wpłynie na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobów oraz nie zwiększy ilości używanych produktów. Dodatkowo należy nadmienić, iż wg międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30% (przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948), których poziom retencji jest badany według metody 19-48-01. Badanie wykonane metodologią NAFC nie jest wiążące ani wymagane przez polskie prawo PZP, jak również EU PZP. Organizacja NAFC jest firmą prywatną, której badania pełnią funkcję czysto poglądową na temat danego produktu - dla klienta, który zlecił wykonanie badania a wyniki retencji mogą mieć różne wyniki w zależności od zastosowanej metodologii.

- spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Należy nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SWZ dopuszcza produkty tylko jednego producenta na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, niż w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy.

3. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (Zadanie nr 12, pozycje 1, 2, 3) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu paroprzepuszczalnego jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych i bocznych mikcjach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

4. Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (Zadanie nr 12, pozycje 1, 2, 3) pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Brak ściągacza taliowego powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz może wydostawać się w miejscach, w których nie ma dobrego przylegania do ciała pacjenta, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak minimum jednego – tylnego,

ściągacza taliowego naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza co najmniej jeden ściągacz taliowy

5. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia Zadanie nr 12; pozycja: 2): pieluchomajtki dla dorosłych pakowane a'28, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź: TAK

6. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Zadanie nr 12; pozycja: 4): majtki chłonne pakowane a'15, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź: TAK

7. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Zadanie nr 12; pozycja: 7): złożenia oferty jednorazowy wysoko chłonny, nie uczulający podkład higieniczny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm posiadający innowacyjny wzór (na kształt owoców cytryny), ze specjalnymi mikro kanalikami, który zapewnia większe poczucie miękkości i komfortu ?

Odpowiedź: NIE

8. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Zadanie nr 12, pozycja 1) podkład chłonny o poniższych parametrach:
- pikowana, delikatna włóknina wierzchnia
 - warstwa chłonna z pulpy celuzowej z dodatkiem superabsorbentu SAP
 - składa się z pięciu warstw (włóknina, 2 warstwy tkaniny, pulpa celulozowa z SAP, folia PE)
 - podfoliowany, nieprzemakalna część spodnia
 - jednorazowego użytku
 - chłonność produktu 1 600 ml?

Odpowiedź: NIE

9. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Zadanie nr 12, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o rekomendowanym obwodzie: od 92cm do maksymalnie 160cm?

Odpowiedź: TAK

10. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Zadanie nr 12, pozycja 2) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o rekomendowanym obwodzie: od 120cm do maksymalnie 170cm?

Odpowiedź: TAK

11. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (Zadanie nr 12, pozycja 3) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o rekomendowanym obwodzie: od 73cm do maksymalnie 130cm?

Odpowiedź: TAK


ZADANIE NR 14

pyt. 1 Czy Zamawiający dopuści wydzieli do odrębnego pakietu z zadania nr 14?

Poz.1

System do przezpochwowej naprawy tylnego defektu dna macicy składający się z siatki propylenowej, monofilamentowej o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym; Gramatura 45 g/m²; porowatość 55-60%.

Implant o anatomicznym kształcie, z dwoma ramionami, każde w plastikowej osłonce, dł. ramion po 17,5 cm z każdej strony, siatka z dodatkową górną wypustką; wymiary siatki: szerokość 6,3 cm x 12 cm, wypustka o wymiarze: szerokość 6,3 cm x 4,0 cm.

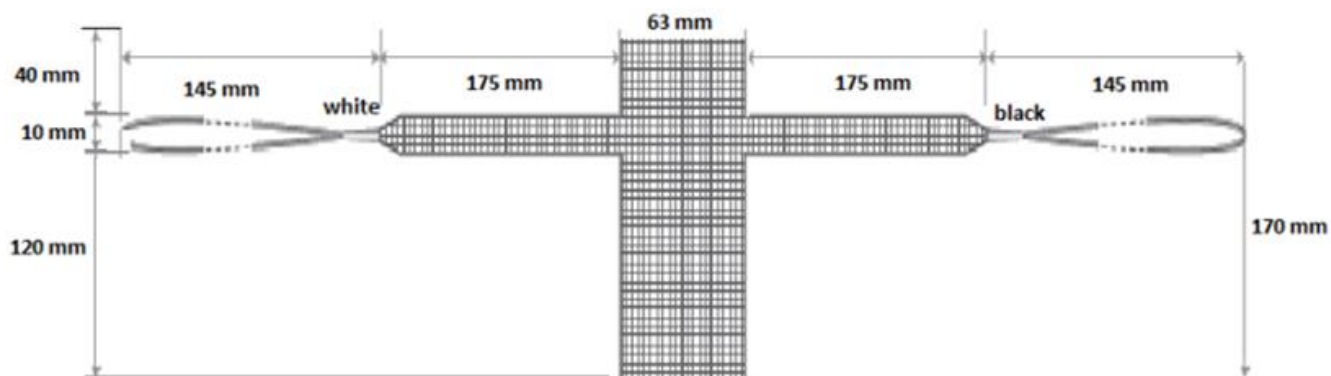


Odpowiedź: NIE

Poz.2

System do dwustronnej fiksacji kikuta pochwy do więzadeł kolcowo-krzyżowych składający się z siatki polipropylenowej, monofilamentowej o utkaniu heksagonalnym w

kształcie odwróconej litery Y; Gramatura 45g/m²; porowatość 55-60%. Dodatkowo 2 narzędzia wielorazowego użytku (do wyboru Zamawiającego) na bezpłatne użyczenie w przypadku wyboru naszych produktów.

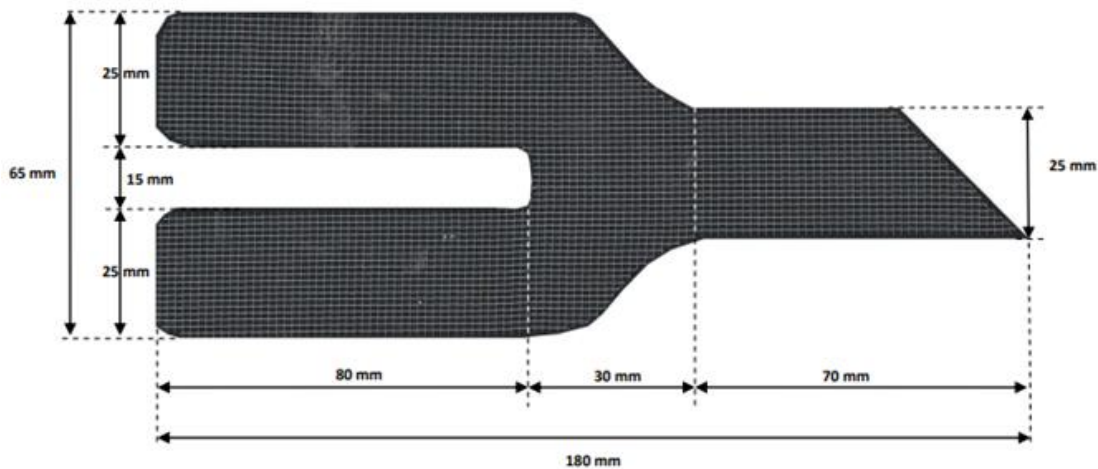

Odpowiedź: NIE


ZADANIE NR 15

pyt. 2 Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 15?

Poz.1


Jednorazowy zestaw do korekcji cystocele, składający się z:

siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 50 x 60 mm (lub 50 x 70 mm) , z podwójnymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe (double TOT), o wielkości oczek 1 x 1,25mm , grubości 0,34 mm i gramaturze 45 g/m², jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metodą przezzasłonową techniką „out-in”.

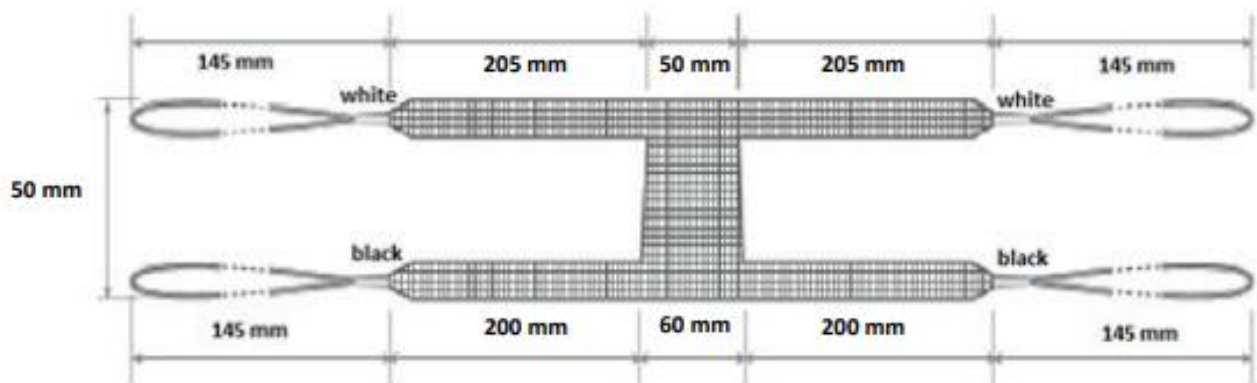

Odpowiedź: NIE


Lub

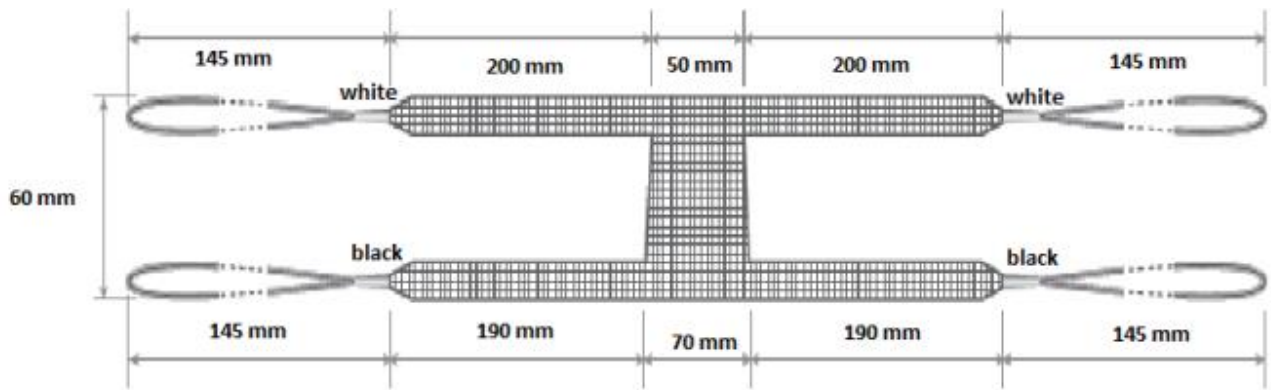

Odpowiedź: NIE

Poz.2

Makroporowatamonofilamentowa polipropylenowa taśma bez koszulki do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Parametry techniczne: szerokość 1,2 cm, długość 55 cm, grubość nici 0,15 mm, gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34 mm, wielkość porów 1 x 1,25 mm. Cechy jakościowe: Taśma jest zakończona długimi wąsami ułatwiającymi implantację, jej splot powoduje łatwe przechodzenie przez powłoki.

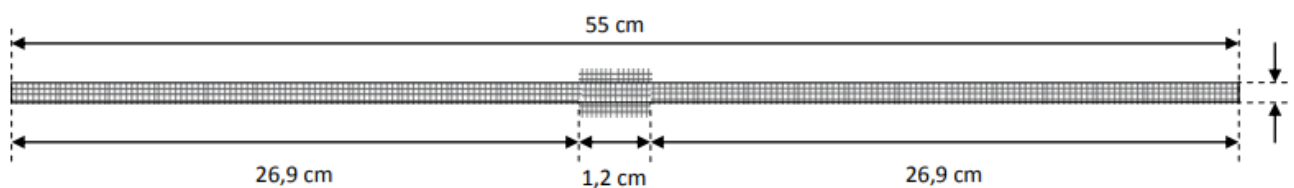

Odpowiedź: NIE

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądaný efekt terapeutyczny.

Prosimy o dopuszczenie w/w materiałów w przetargu. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz

zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 15, pozycji nr 1:

siatkę jednorodną, niewchłaniającą, o anatomicznym kształcie, trapez z 4 ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wielkość porów średnia 0,98 mm, max. 2,31 mm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, szerokość ramion 1,1 cm, podstawa górna 4,5 cm, podstawa dolna 6 cm, wysokość implantu 6 cm (odległość między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)

oraz

1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej do implantacji siatki metoda przezzasłonową?

Odpowiedź: NIE

1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 15, pozycji nr 2:

Taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, jednorazową, niewchłaniającą z polipropylenu monofilamentowego, w plastikowej dwuczęściowej osłonce, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, wielkości porów min. 0,25 mm, średnia 0,98 mm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 µm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach taśmy ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, posiadającą włókna skośne, które zapobiegają deformacji i zwiększają odporność na rozciąganie, bez wplecionej niebieskiej nici?

Odpowiedź: NIE

ZADANIE NR

Dotyczy pakietu nr: 16

Pozycja nr 12

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 16x20, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK

ZADANIE NR 17

Pakiet nr 17

Pozycja 7

1. Prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu:

-Mata absorbcyjna na podłogę, z warstwą antypoślizgową. Rozmiar 80 x 121cm, waga 120g, w tym 15g SAP, wypełnienie airlaid- nieprzepuszczalne, antystatyczne, chłonność 4500ml, Pakowane próżniowo. Karton=50szt. 80 x 121

Odpowiedź : Brak możliwości wyodrębnienia do osobnego pakietu, nie można wprowadzić zmiany w ogłoszeniu, polegającej na zwiększeniu ilości zadań

2. Prosimy o dopuszczenie maty w rozmiarze 80x120 cm i chłonności 4200 ml.

Odpowiedź: NIE