

## DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Łódź, 11.01.2021 r.

e-mail: ewa.twardowska@barlicki.pl

Tel. 42 677-68-24

Znak sprawy: 29/ZP/2020

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu endoskopowego”.**

### Szanowni Państwo!

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) informuje:

- Zamawiający informuje, iż termin składania ofert jest do 19.01.2021 r. do godz. 09:00.**
- Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2021 r. o godz. 10:00.**
- Zamawiający informuje, iż Oferent jest związany przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
- Niniejszym zawiadamiamy, że działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się zmiany uwzględniające wyjaśnienia treści SIWZ:
  - Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ, wzór umowy (załącznik nr 4 i 4 a do SIWZ), załącznik 1A.** Modyfikacja zostaje dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część oraz zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
- W dniach 08-15.12.2020 r. wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:**

#### Pytanie 1

##### Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę jednorazowego użytku z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, długość 230 cm, współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ ( potrzebne są 2 długości )**

#### Pytanie 2

##### Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igły do skleroterapii - z teflonową osłonką odporną na załamania, kateter zapewniający prawidłowe manewrowanie wewnątrz krętych zmian nawet po załamaniu kateteru igły, posiadające zabezpieczenie położenia igły, o długości roboczej tylko 230 cm, o różnych, co najmniej dwóch długościach ostrza igły np. 4 i 6 mm, o różnych średnicach ostrza igły 23 i 25 G, stosowane w endoskopach z kanałem roboczym o średnicy 2.8 mm (długość ostrza i średnicę ostrza igły Zamawiający każdorazowo określi w zapotrzebowaniu). Jednostka miary opakowanie po 10 szt. Oddzielnie zapakowanych pojedynczych sztuk igieł?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ ( potrzebne są 2 długości )**

#### Pytanie 3

##### Dotyczy Pakiet nr 25, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szczotki jednorazowego użytku: do czyszczenia kanałów endoskopów średnica kateteru 1,7 mm, średnica szczoteczek jedna główka 5 mm, druga główka 10 mm, długość całkowita 230 cm?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie 4

##### Dotyczy Pakiet nr 24, poz. 3

Czy Zamawiający **wymaga**, aby zgłębnik gastrostomijny zakładany podczas interwencji operacyjnej umocowany był do powłok brzusznych pod kątem 90 stopni - co gwarantuje pacjentowi wygodę i bezpieczeństwo oraz gwarancje prawidłowego przepływu diety. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie 5

##### Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 2

Czy w pakiecie 1 pozycji 2 kolumnie C nastąpiła pomyłka pisarska? Prosimy o podanie jednostki miary.

**Odpowiedź: Tak. Jednostka miary : szt.**

#### Pytanie 6

##### Dotyczy Pakiet nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania a pakiecie 9 pozycji 1 samorozprężalne stenty przełykowe uwalniane tylko od końca dystalnego? Reszta parametrów jak w siwz.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 7

##### Dotyczy Pakiet nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania a pakiecie 9 pozycji 2 samorozprężalne stenty przełykowe uwalniane tylko od końca dystalnego? Reszta parametrów jak w siwz.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie 8

##### Dotyczy Pakiet nr 6, poz. 13

Czy w pakiecie 6 pozycji 13 kolumnie C nastąpiła pomyłka pisarska? Prosimy o podanie jednostki miary.

**Odpowiedź: Tak. Jednostka miary : szt.**

#### Pytanie 9

##### Dotyczy Załącznika nr 4a do SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4a do SIWZ poprzez nadanie § 3 ust. 6 następującego brzmienia:  
„Określone w umowie wyroby medyczne są własnością Wykonawcy do momentu ich pobrania ze składu konsygnacyjnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Pytanie 10

##### Dotyczy Załącznika nr 4a do SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4a do SIWZ poprzez nadanie § 3 ust. 11 następującego brzmienia:  
„Pobranie wyrobu ze składu konsygnacyjnego jest równoznaczne z dokonaniem sprzedaży oferowanych wyrobów medycznych Zamawiającemu przez Wykonawcę.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Pytanie 11

##### Dotyczy Załącznika nr 4a do SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4a do SIWZ poprzez dodanie § 3 ust. 8a o następującej treści:  
„Zamawiający nie jest uprawniony do pobrania ze składu konsygnacyjnego wyrobu, któremu upłynął termin ważności.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Pytanie 12

##### Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ

Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 3 – załącznik nr 4



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia, łącznie z całkowitym wstrzymaniem zakupu ogólnej ilości asortymentu, jak i poszczególnych ich rodzajów w poszczególnych okresach obowiązywania umowy, jak i w stosunku do całej ilości asortymentu przewidzianego w przedmiocie zamówienia – w zależności od przebiegu leczenia, zmiany profilu świadczonych usług i zmian metod diagnostyczno-terapeutycznych. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za towar już dostarczony, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie 13

##### Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 5 – załącznik nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności, jaką ma u Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy, bez jego uprzedniej pisemnej zgody pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie 14

##### Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ

Dotyczy zapisów umowy § 4 – załącznik nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze.”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie 15

##### Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ

Dotyczy zapisów umowy § 4 – załącznik nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

**Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis: „ Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze, zgodnego z § 4 ust. 1. ”**

#### Pytanie 16

##### Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1 – załącznik nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub asortymentowych w przedmiocie dostawy, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie, nie później jednak niż do 5 dni roboczych (pn – pt, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia uznania reklamacji za zasadną wymieni wadliwy towar na wolny od wad. Za towar wadliwy uważa się między innymi towar niezgodny asortymentowo lub ilościowo ze złożonym zamówieniem lub uszkodzony.”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie 17

##### Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 4 – załącznik nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku niedostarczonego w umownym terminie zgodnie z § 2 ust. 4 lub dostarczonego wadliwego towaru, Zamawiający zastrzega sobie, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, prawo nabycia u osoby trzeciej towaru będącego przedmiotem danego zamówienia lub jego odpowiednika, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienia nie zamykają Zamawiającemu drogi do podjęcia innych przewidzianych prawem oraz zapisami niniejszej umowy czynności związanych z nienależytym wykonaniem postanowień umowy przez Wykonawcę.”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 18**

##### **Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 – załącznik nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 20% na 5%

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 19**

##### **Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2 i 3 – załącznik nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 10% na 5%

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 20**

##### **Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ**

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 2 – załącznik nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca będzie dokonywał wymiany towaru objętego gwarancją w siedzibie Zamawiającego w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną oraz ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 21**

##### **Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ**

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 3d – załącznik nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„gdy Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy;”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 22**

##### **Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ**

Dotyczy zapisów umowy § 12 ust. 3 – załącznik nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności, dokonać przelewu praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 23**

##### **Dotyczy Załącznika nr 4a do SIWZ**

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 4 – załącznik nr 4a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:



„Wykonawca będzie poinformowany o wszelkich uszkodzonych, wadliwych wyrobach medycznych otrzymanych przez Zamawiającego, w ciągu 7 dni roboczych od doręczenia wyrobów medycznych. Wykonawca wymieni uszkodzone wyroby na własny koszt i ryzyko (poniesie wszelkie wydatki z tym związane: opłata za przewóz, cło, fracht, podatki i inne) w terminie 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie 24

##### Dotyczy Pakiet 1, poz.2

Prosimy o dopuszczenie igieł również zapewniających prawidłowe manewrowanie i odpornych na załamania lecz o konstrukcji innej niż wewnętrzny kateter o przekroju w kształcie gwiazdy, dostępne dziesięć rozmiarów:

- dł. robocza 180cm, śr. 0,5mm (25G) – dł. 4mm,
- dł. robocza 180cm, śr. 0,7mm (22G) – dł. 4mm, 5mm i 6mm,
- dł. robocza 180cm, śr. 1,0mm (19G) – dł. 6mm
- dł. robocza 230cm, śr. 0,5mm (25G) – dł. 4mm,
- dł. robocza 230cm, śr. 0,7mm (22G) – dł. 4mm, 5mm i 6mm,
- dł. robocza 230cm, śr. 1,0mm (19G) – dł. 6mm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie 25

##### Dotyczy Pakiet 1, poz.2

Prosimy o dookreślenie co Zamawiający rozumie poprzez jednostkę miary „2 zest.”? Czy nie nastąpiła omyłka i jednostką miary nie powinna być „szt.”?

**Odpowiedź: Tak. Jednostka miary : szt.**

#### Pytanie 26

##### Dotyczy Pakiet 1, poz.2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igieł do skleroterapii z teflonową osłonką odporną na złamanie, kateterem zapewniającym prawidłowe manewrowanie wewnątrz krętych zmian, zabezpieczonym metalową końcówką - zapewniającą przez niepożądanym przebicciem igłą końcówki cewnika podczas wysuwania igły nawet podczas dużego wygięcia aparatu, zabezpieczenie położenia igły w dwóch pozycjach, długość robocza 180 cm i 230 cm, o różnych co najmniej dwóch długościach ostrza igły 4mm i 6mm, o różnych średnicach igły 23G i 25G, do stosowania w endoskopach z kanałem roboczym o śr. 2,8mm.

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie 27

##### Dotyczy Pakiet 2, poz.1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsownic o długości 2300 mm?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ-2 DŁUGOŚCI**

#### Pytanie 28

##### Dotyczy Pakiet 2, poz.2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie klipsów o kacie zagięcia ramion 90°?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie 29

##### Dotyczy Pakiet 2, poz.3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie klipsów o kacie zagięcia ramion 135°?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 30**

**Dotyczy Pakiet 2, poz.4**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczypic o długości 1600 mm.?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 31**

**Dotyczy Pakiet 2, poz.5**

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczypic o maksymalnej szerokości rozwarcia łyżeczki 5 mm?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 32**

**Dotyczy Pakiet 2, poz.6**

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie szczypic o długości 1600 mm, maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 9 mm.?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 33**

**Dotyczy Pakiet 9, poz.1 i 2**

Czy Zamawiający w pozycji 1i 2 dopuści zaoferowanie stentów uwalnianych od końca dystalnego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 34**

**Dotyczy Pakiet 9, poz.3 i 4**

Czy Zamawiający w pozycji 3 i 4 dopuści zaoferowanie stentów wykonanych z drutu nitinolowego?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 35**

**Dotyczy Pakiet 9, poz.3 i 4**

Czy Zamawiający w pozycji 3 i 4 dopuści zaoferowanie stentów o średnicy 10 mm?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 36**

**Dotyczy Pakiet 24, poz.2**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zgłębników z trzema otworami bocznymi i zamkniętym końcem, z jedną linią cieniującą w RTG?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 37**

**Dotyczy Pakiet 1, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści klipsy hemostatyczne o długości roboczej wyłącznie 230cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 38**

**Dotyczy Pakiet 1, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm (23G) lub 0,8 mm (21G) i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego), o kącie ścięcia ostrza igły 23,5°, średnicy narzędzia 2,4mm; kompatybilną z kanałem roboczym 2,8mm, o



długości narzędzia 2300mm, z mechanizmem długopisowym (zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem)?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ-2 DŁUGOŚCI**

#### **Pytanie 39**

##### **Dotyczy Pakiet 8, poz.3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w miejsce istniejących parametrów zaofiarować :  
pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 20 mm; pętla wykonana z plecionego, spiralnego drutu o grubości 0,48mm zapobiegającego ześlizgiwaniu się tkanki; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 40**

##### **Dotyczy Pakiet 8, poz.4**

Ze względu na wycofanie z rynku z dniem 1.04.2020 narzędzi endoskopowych wielorazowego użytku Informujemy, iż nasadki wielorazowego użytku są już niedostępne.

Nasadka jednorazowego użytku kompatybilna do aparatu GIF-Q145 jest dostępna jedynie w zestawach do mukozektomii :

Zestaw (jednorazowego użytku) do wykonania endoskopowej resekcji śluzówkowej w górnym odcinku przewodu pokarmowego, Zawiera cewnik rozpylający (PW-205L), igłę iniekcyjną (NM-401L-0423), elektrochirurgiczną pętlę tnącą (SD-221L-25) oraz nasadkę dystalną D-405-15514; długość całkowita narzędzi 165 cm; pasuje do gastroscopów: GIF-HQ190, -H190, -H180, -H180J, -Q160, -Q145, -140, -XQ140, -H260, -1TH190. Jeżeli Zamawiający dopuści to rozwiązanie prosimy o ponowne określenie wymaganej ilości, zestawy są sprzedawane na sztuki ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilości bez zmian.**

#### **Pytanie 41**

##### **Dotyczy Pakiet 8, poz.5**

Ze względu na wycofanie z rynku z dniem 1.04.2020 narzędzi endoskopowych wielorazowego użytku zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zamiennika: narzędzia jednorazowego użytku który jest zamiennikiem do w/w poz. i występuje tylko w jednym rozmiarze :

Chwytnak palczasty jednorazowego użytku do usuwania polipów i ciał obcych, trójramienny; rozpiętość ramion 20mm. Dł. narzędzia 230cm, min. średnica kanału roboczego 2,8mm. - 5 sztuk w opakowaniu. Jeżeli Zamawiający dopuści to rozwiązanie prosimy o ponowne określenie wymaganej ilości , narzędzie jednorazowe jest sprzedawane w min opak. po 5 sztuk ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilości bez zmian ( z odpowiednim przeliczeniem )**

#### **Pytanie 42**

##### **Dotyczy Pakiet 8, poz.6,7,8**

Ze względu na wycofanie z rynku z dniem 1.04.2020 narzędzi endoskopowych wielorazowego użytku zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zamiennika : narzędzia jednorazowego użytku :

Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułkowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi ?

Jeżeli Zamawiający dopuści to rozwiązanie prosimy o ponowne określenie wymaganej ilości , narzędzie jest sprzedawane w min. opakowaniu zbiorczym po 5 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilości bez zmian**



#### Pytanie 43

##### Dotyczy Pakiet 8, poz.9

Ze względu na wycofanie z rynku z dniem 1.04.2020 narzędzi endoskopowych wielorazowego użytku zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zamiennika : narzędzia jednorazowego użytku : Cewnik typu spray jednorazowego użytku do barwienia śluzówki, długość narzędzia 2400mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,45mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; zawiera mandryn zapobiegający skręcaniu i zagięciu; 6 sztuk w opakowaniu ?

Jeżeli Zamawiający dopuści to rozwiązanie prosimy o ponowne określenie wymaganej ilości , narzędzie jest sprzedawane w min. opakowaniu zbiorczym po 6 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ilości bez zmian ( z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań )**

#### Pytanie 44

##### Dotyczy SIWZ Rozdz. II pkt. 6.12, Rozdz. V pkt. 1.2, wzór umowy Par. 2 ust. 5 (Pakiet nr 2, 4, 8)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy w przypadku zagrożenia życia pacjentów, do max 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od złożenia zamówienia /zapotrzebowania telefonicznego?

Narzędzia endoskopowe są używane do zabiegów planowych, których termin określany jest z wyprzedzeniem.

**Odpowiedź: Tak.**

#### Pytanie 45

##### Dotyczy wzór umowy załącznik 4a

Zwracam się z prośbą o określenie, których pakietów dotyczy – załącznik nr 4A do siwz (wzór umowy komisowej)

**Odpowiedź: Umowa komisowa dotyczy wszystkich pakietów.**

#### Pytanie 46

##### Dotyczy Pakiet 1

Czy zamawiający dopuści w 2. Iglę do skleroterapii - z teflonową osłonką odporną na załamania, wewnętrzny kateter o przekroju w kształcie gwiazdy, zapewniający prawidłowe manewrowanie wewnątrz krętych zmian nawet po załamaniu kateteru igły, posiadające zabezpieczenie położenia igły, o długości roboczej 230 cm, długość ostrza igły np. 5 mm, o różnych średnicach ostrza igły 22 i 25 G, stosowane w endoskopach z kanałem roboczym o średnicy 2.8 mm.

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie 47

##### Dotyczy Pakiet 5 poz.4-5

Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 4,5 i dopuści Poz. 4 Średnica narzędzia 1,8mm. Nastawne przedłużenie igły 0-8 cm Nastawne przedłużenie koszulki 0-4cm Do użycia przy minimalnym kanale roboczym 2,0 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ Poz. 5 Iglę do biopsji histologicznej wysokiej rozdzielczości. Średnica narzędzia w zależności od rozmiaru 1,8 mm. Średnica igły: 19 G; 22 G; 25G. Pokrętło zabezpieczające przedłużoną igłę. Nakłuwany wzór wysokiej rozdzielczości. Nastawne przedłużenie igły 0-8 cm. Nastawne przedłużenie koszulki 0-5 cm. Do użycia przy kanale roboczym 2,0-3,7mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie 48

##### Dotyczy Pakiet 14 poz.1-5



Czy zamawiający dopuści w poz. 1 Proteza samorozprężalna do przełyku całkowicie pokrywana. Usuwalna. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywane, atraumatyczne zakończenia, pokrywana silikonem. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 20-26 mm , długość 6-14 cm. System uwalniania dystalnie o średnicy 24 Fr. i długości 70 cm Poz. 2 Proteza samorozprężalna do przełyku częściowo pokrywana. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, nagie, atraumatyczne zakończenia, pokrywana silikonem. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 20-26 mm , długość 6-14 cm. System uwalniania dystalny o średnicy 24 Fr. i długości 70 cm I Poz. 3 Proteza samorozprężalna do przełyku z systemem antymigracyjnym. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywana silikonem, system antymigracyjny w postaci dodatkowe warstwy wykonanej z niepokrywanej, rozszerzonej siatki nitinolowej mocowanej proksymalnie. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 16-28 mm , długość 6-15 cm. System uwalniania proksymalny lub system dystalny, długość systemu 70 cm. Poz. 4 Proteza samorozprężalna do przełyku z systemem antymigracyjnym i zastawką antyrefluksową. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywana silikonem, system antymigracyjny w postaci dodatkowe warstwy wykonanej z niepokrywanej, rozszerzonej siatki nitinolowej mocowanej proksymalnie, zastawka antymigracyjna typu rękaw, wykonany z PTFE ze wzmocnieniem z pętli drutu nitinolowego. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 20-26 mm , długość 10-12cm. System uwalniania dystalny, długość systemu 70 cm. Poz. 5 Proteza samorozprężalna do górnej części przełyku umieszczana w pobliżu górnego zwieracza (UES). Usuwalna. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, koniec proksymalny krótki, koniec dystalny długi, pokrywana silikonem. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 20,24 mm , długość 10 cm. System uwalniania dystalny, długość systemu 70cm.

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 49**

##### **Dotyczy Pakiet 3**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do przezskórnej endoskopowej gastrostomii z kompletem gazików bez otworów. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 50**

##### **Dotyczy Pakiet 5 poz.4**

Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 5 w pozycji 4**, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł do biopsji aspiracyjnej ze średnicą narzędzia w zależności od rozmiaru 5.2-4.3Fr, do użycia przy min kanale roboczym 2.8mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 51**

##### **Dotyczy Pakiet 5 poz.7**

Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 5 w pozycji 7**, w miejsce pierwotnych parametrów, szczotek cytologicznych do dróg żółciowych na cewnik 6.6 i 8 Fr, długość 185 lub 200cm, Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 52**

##### **Dotyczy Pakiet 7 poz.19**

Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 7 w pozycji 19**, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów samorozprężalnych do dwunastnicy na kanał roboczy 3,7mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 53**

##### **Dotyczy Pakiet 7 poz.20**

Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 7 w pozycji 20**, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów samorozprężalnych do jelita grubego na kanał roboczy 3,7mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 54**

**Dotyczy Pakiet 13 poz.4**

Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 13 w pozycji 4**, w miejsce pierwotnych parametrów, jednofazowych zestawów do wprowadzania stentu w drogach żółciowych, średnica cewnika popychającego 8.5 lub 10 FR, dł. cewnika prowadzącego 318-320cm, min średnica kanału roboczego 3.2-3.7mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 55**

**Dotyczy Pakiet 13 poz.7**

Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 13 w pozycji 7**, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzadeł do dróg żółciowych Soehendry o dł. 278cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 56**

**Dotyczy Pakiet 25 poz.3**

Czy w **pakiecie 25 w pozycji 3** Zamawiający ma na myśli balon zakładany na okres maksymalnie 6 miesięcy, bez metalowego przewodnika z zaworem wyposażonym w znacznik RTG?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 57**

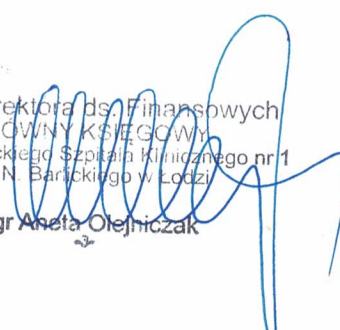
**Dotyczy Pakiet 25 poz.6**

Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 25 w pozycji 6**, w miejsce pierwotnych parametrów, balonu z zakresem napełnienia od 400ml do 700ml. Wg. naszej wiedzy w obecnej chwili na rynku nie są dostępne balony 12 miesięczne o zakresie napełnienia do 850ml co może skutkować brakiem złożenia przedmiotowych ofert.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

**W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia innych treści niż opisane w SIWZ, zaznaczyć gwiazdką (\*) przy danej pozycji w kolumnie b - „przedmiot zamówienia” oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\* - poz. nr ... dokonano zmiany opisu zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.”**

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
  
mgr Agnieszka Świątłowska

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1  
im. N. Barlickiego w Łodzi  
  
mgr Aneta Olejniczak