



Część 2 - Szkło laboratoryjne

poz. 1 aparat Clevengera wg Farmakopei niemieckiej - poziom N powyżej poziomu B

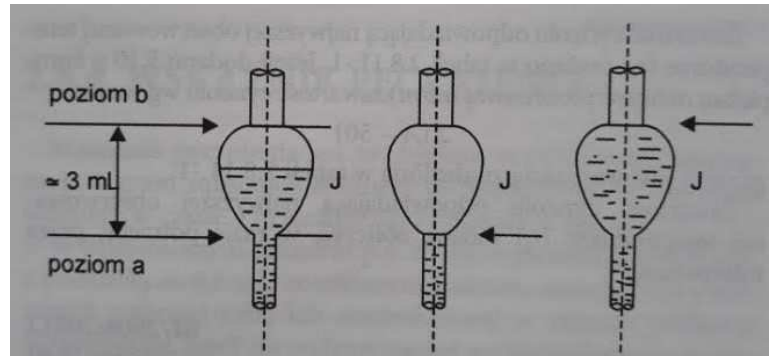

poz. 28 pręt mieszający szklany do mieszadła mechanicznego CAT R17 fi 6mm, długość pręta 300mm.

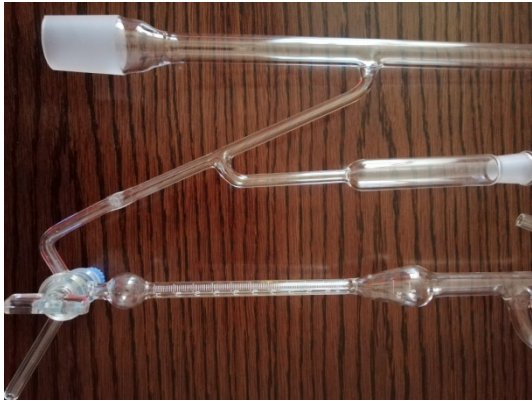