

Milicz, dn. 20.09.2021 r.

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP7/2021

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na: **dostawa zespołów klasycznych, zestawów do artroskopii kolana i barku, śrubopłyty, gwoździ śródszpikowych, zestawów do regeneracji ubytków kostnych i leczenia braków wzrostu, obłożenia operacyjne.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1:

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 1** dopuści możliwość zaferowania płytki o dł. 69-94 mm zamiast 70-90 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 2:

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 2** dopuści możliwość zaferowania płytki lewej/prawej o dł. 91-163mm zamiast 100-150mm lub o dł. 90-160 mm zamiast 100-150 mm, uniwersalnej do lewej i prawej kończyny zamiast lewej i prawej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 3:

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 3** dopuści możliwość zaferowania płytek ramiennych dalszych: przyśrodkowej o dł. 59-136 mm, tylnio bocznej i tylnio-bocznej z hakiem o dł. 65-142 mm, zamiast opisanych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 4:

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 4** dopuści możliwość zaferowania płytki o dł. 107-159 mm zamiast 110-160 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 5:

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 5** dopuści możliwość zaferowania płytki o dł. 106-184 mm zamiast 120-180 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 6:

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania płytki o dł. 116-198 mm zamiast 120-180 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 7:

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 7** dopuści możliwość zaoferowania płytki lewej/prawej o dł. 86-177mm zamiast 90-160mm o dł. 89-173 mm zamiast 100-150 mm, uniwersalnej do lewej i prawej kończyny zamiast lewej i prawej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 8:

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 8** dopuści możliwość zaoferowania płytki wąskiej o szerokości 12 mm i o dł. 59-163 mm zamiast 90-190 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 9:

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 9** dopuści możliwość zaoferowania płytki o dł. 85-190 mm zamiast 90-190 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 10:

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźca puszczelowego uniwersalnego do lewej i prawej kończyny zamiast lewego i prawego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 11:

Dotyczy Pakietu nr 3 i 4: W celu ujednoczenia składanych ofert, zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie ilości wkrętów korowych składających się na jeden zestaw.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający doprecyzowuje, że ilość wkrętów korowych składających się na jeden zestaw wynosi 5.

PYTANIE NR 12:

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania płytki z otworami pod wkrętę o średnicy 3,5 mm zamiast 4,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 13:

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania płytki o dł. 103-199 mm zamiast 80-160 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 14:

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 7** dopuści możliwość zaoferowania gwoździ Rusha o średnicach od 2,4 – 4,0mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 15:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu tworzenia depozytu w zakresie tzw. implantów drobnych tj. **Pakiet nr 5**, na rzecz zamówień realizowanych w ciągu 3 dni roboczych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu.

PYTANIE NR 16:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu nadzoru okresowych kontroli złożonych instrumentarium w związku z faktem, że Zamawiający nie wymaga dostarczania instrumentarium w zakresie **Pakietu nr 5**.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu.

PYTANIE NR 17:

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 6 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania wkrętu kaniulowanego samowierzącego Ø4-4,5mm w długości od 14 do 70 ze skokiem co 2mm, kaniulacją dla Ø4,0 – 1,25mm, dla Ø 4,5 – 1,7mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 18:

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 6 poz. 2** dopuści możliwość zaferowania wkrętu kaniulowanego samowierzącego Ø6,5 niesterylnego z kaniulacją 2,2mm, gwint pełny lub częściowy o długości 16mm lub 32mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 19:

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 6 poz. 3** dopuści możliwość zaferowania wkrętu kaniulowanego samowierzącego Ø2,4mm w długości 10-30mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 20:

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 6 poz. 4** dopuści możliwość zaferowania wkrętu kaniulowanego samowierzącego Ø3,5mm z kaniulacją 1,15mm i długości 10-40mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 21:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu tworzenia depozytu w zakresie tzw. implantów drobnych tj. **Pakiet nr 6**, na rzecz zamówień realizowanych w ciągu 3 dni roboczych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu.

PYTANIE NR 22:

Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Śrubopłyta typu DSB o różnych długościach (w przewodzie 4-otworowa). Płyty z otworami pozwalającymi na kompresję. Pod wkręty korowe 4,5mm. Kąt 135-130 stopni. W zestawie: - śruba doszyjkowa standardowa - śruba kompresyjna, - wkręty korowe śr. 4,5mm z łbem pod otwory płyty, gniazdem imbusowym (bez zapisu opcjonalnie z gwintem do kości osteoporotycznej),

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 23:

Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Śrubopłyta typu DSK o różnych długościach (w przewodzie 6-otworowa). Płyty z otworami pozwalającymi na kompresję. Pod wkręty korowe 4,5mm oraz pod wkręty gąbczaste śr. 6,5mm w części przytulejowej. Kąt 95 stopni. W zestawie: - śruba dokłyckiowa standardowa - śruba kompresyjna, - wkręty korowe śr. 4,5mm z łbem pod otwory płyty, gniazdem imbusowym (bez zapisu opcjonalnie z gwintem do kości osteoporotycznej),

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 24:

Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płyta szeroka około 16mm, 5mm z otworami w dwóch rzędach pod wkręty o średnicy 4,5mm, 4-9 otworowa, stalowa

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 25:

Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płyta wąska ok.. 10mm cienka 4mm z otworami w jednym rzędzie, pod wkręty o średnicy 4,5mm 2-6otworowa, stalowa

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 26:

Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płyta kompresyjna wąska około 10mm, cienka około 4mm, 4-8 otworowa pod wkręty o średnicy 4,5mm stalowa

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 27:

Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płyta kompresyjna szeroka około 16mm, gruba około 5mm 5-12 otworowa długości od 87-199mm, pod wkręty średnicy 4,5mm, stalowa

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 28:


Dotyczy Pakietu Nr 12, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji biodra o składzie:

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm, wzmocniona
- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocniona,
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Obłożenie pacjenta wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Zestaw spełnia normy EN 13795 oraz wymagania ISO 10993.



Odpowiedź Zamawiającego:


Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 29:

Dotyczy Pakietu Nr 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kończyn składający się z:

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
- Serweta podstawowa wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Zestaw spełnia normy EN 13795 oraz wymagania ISO 10993.



Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 30:


Dotyczy Pakietu Nr 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii o składzie:

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo
- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m². Zestaw spełnia normy EN 13795 oraz wymagania ISO 10993.

Do zestawu dołączone osobno sterylne fartuchy chirurgiczne L i XL wzmocnione (do zabiegów w polu „mokrym”)



Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 31:

Dotyczy Pakietu Nr 12, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30 x 80cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 32:

Dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 240 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny standard, L
- 2 x fartuch chirurgiczny standard, XL

Serwety główne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Zestaw spełnia normy EN 13795 oraz wymagania ISO 10993.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 33:

Dotyczy Pakietu Nr 12, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści osłonę z folii PE w rozmiarze 80 x 150 cm, w kształcie walca, ściągnięta elastyczna gumką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 34:

Dotyczy Pakietu Nr 12, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści osłonę z folii PE w rozmiarze 140 x 140 cm, w kształcie beretu, ściągnięta elastyczna gumką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 35:

Dotyczy Pakietu Nr 12, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki płynów w rozmiarze 50 x 50cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwi podłączenia drenów o różnej średnicy. Torba wykonana z przezroczystej folii polietylenowej 0.065 mm. Zintegrowana z przylepcami w górnej części torby.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 36:

Dotyczy Pakietu Nr 12, pozycja 9-10

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMMMS?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 37:

Dotyczy Pakietu Nr 12, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści torbę w rozmiarze 30 x 40cm, zintegrowana z taśmą samoprzylepną w górnej części kieszeni do mocowania do serwet operacyjnych, wyposażona w sztywnik pozwalający kształtować otwór kieszeni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 38:

Dotyczy Pakietu Nr 12, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści torbę w rozmiarze 50 x 60cm, zintegrowana z taśmą samoprzylepną w górnej części kieszeni do mocowania do serwet operacyjnych, wyposażona w sztywnik pozwalający kształtować otwór kieszeni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 39:

Dotyczy Pakietu Nr 12, pozycja 15

Czy Zamawiający miał na myśli zgodność z normą EN 13795?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 40:

Dotyczy Pakietu Nr 12, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną jałową w rozmiarze 75cm x 90cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6 x 8 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 41:

Dotyczy Pakietu Nr 12, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną jałową w rozmiarze 75cm x 90cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o średnicy 7 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 42:

Dotyczy Pakietu Nr 12, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści serwety sterylne w rozmiarze 100 x 150cm?

Odpowiedź Zamawiającego:


Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 43:

Dotyczy Pakietu Nr 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do resekcji przezcewkowej o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczywym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów, z taśmami do regulacji worka.



Odpowiedź Zamawiającego:


Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 44:

Dotyczy Pakietu Nr 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do małych procedur chirurgicznych o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
- 1 x serweta samoprzylepna wzmocniona o wymiarach 200cm x 280cm z otworem o średnicy 10 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

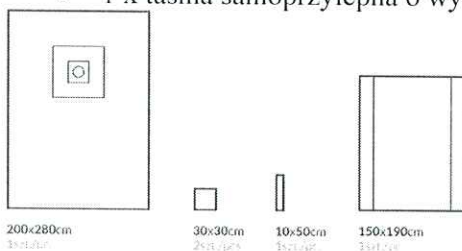

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.


PYTANIE NR 45:

Dotyczy Pakietu Nr 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm składana teleskopowo
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25cm x 30cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75cm x 85cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O. Chłonność wzmocnienia min. 680%.



Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 46:

Czy Zamawiający w punkcie „PAKIET: zestawy do artroskopii barku - Pakiet Nr 9” w podpunkcie 1a dopuści jako rozwiązanie równoważne „Kotwicę tytanową, stożkową, wkręcaną, samogwintującą o średnicy 3.0 mm; 5.0mm i 6.5mm, zaopatrzoną w nić wzmocnioną, poliestrową o wytrzymałości min. 18 kg. Kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzacz, bez igiel”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści. Jest to równoważnik/ekwiwalent.


PYTANIE NR 47:

Czy Zamawiający w punkcie „PAKIET: zestawy do artroskopii barku - Pakiet Nr 9” w podpunkcie 1b wymaga, by oferowane kotwice miały wersję z igłami lub bez w obu rozmiarach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z założeniem operacyjnym, oferowane kotwice/ implanty mają mieć „wersje z igłami lub bez w obu wymiarach” – czyli w każdym rozmiarze implantu ma być wersja zarówno zaopatrzona w igły, jak i wersja ich pozbawiona.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 23.09.2021r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SWZ.


PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Andrzej Oówiejko


WICEPREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Anna Sztandera