



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCYJA TEL. 59 8635 325

ZP.261.27.3.2019



Lębork, dn. 13.09.2019 r.

Uczestnicy postępowania ZP-PN/UE/27/19

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Znak sprawy: ZP-PN/UE/27/19.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Zadanie nr 1

1. *Pozycja 9-16, 26 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 2

2. *Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne w rozmiarze CH6 z balonem 3ml?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
3. *Pozycja 1-3. Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny z prowadnicą wystającą na ok. 7cm w opakowaniu bez drapowania na długości spełniający pozostałe wymagania w SIWZ?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
4. *Pozycja 4-12. Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne sterylizowane tlenkiem etylenu?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
5. *Pozycja 4-12. Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne w opakowaniu folia/folia-papier?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
6. *Pozycja 4, 5. Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne z balonem 3-5ml?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 3

7. *Poz.15. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania drenów T-Kehr 16 x38cm pozostałe parametry zgodnie z SIWZ*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza w poz. 15 (po zmianach pozycja nr 14) zaoferowanie drenów T-Kehr 16x38 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**
8. *Poz.15. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania drenów T-Kehr o długościach 20/50, rozmiary CH 12-21, 24 pozostałe parametry zgodnie z SIWZ*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza w poz. 15 (po zmianach pozycja nr 14) zaoferowanie drenów T-Kehr o długościach 20/50, rozmiary CH 12-21, 24. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**
9. *Poz.5-8. Prosimy zamawiającego o możliwość zaoferowania drenów brzusznych które wykonane są z silikonowanego tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza w pozycji 5-8 zaoferowanie drenów brzusznych które wykonane są z silikonowego tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

10. Poz.14. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania drenu o rozmiarze 30 , pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza w pozycji nr 14 (po zmianach pozycja nr 13) zaoferowanie drenu o rozmiarze 30. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
11. Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści dreny z trokarem w rozmiarach 16F/21cm, 20F-32F/34cm?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
12. Pozycja 3 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
13. Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści cewnik dopępowinowy bez oznaczenia długości i skalowania, z paskiem RTG na długości 5-25cm?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
14. Pozycja 5-8 Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne wykonane w 100% z silikonu o długości 50cm w rozmiarach CH27, CH30, CH33, CH36?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
15. Pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści dreny Redon CH16 o długości 700mm lub 1700mm?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
16. Pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści dreny Redon CH8 o długości 700mm?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
17. Pozycja 13 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?
- Komisja Przetargowa informuje, że wydzielono pozycję nr 13 z Zadania nr 3 i utworzono Zadanie nr 99.
18. Pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści dren połączeniowy w rozmiarze CH 30?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w pozycji nr 14 (po zmianach pozycja nr 13) dren połączeniowy w rozmiarze CH 30.
19. Pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehra wykonane ze 100% silikonu o długości ramion 450mm x 180mm?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w pozycji nr 15 (po zmianach pozycja nr 14) dreny T-Kehra wykonane ze 100 % silikonu o długości ramion 450 mm x 180 mm.
20. Pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer CH 21?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
21. Prosimy o wyłączenie pozycji 13 i utworzenie pakietu 3a pozwoli to na zwiększenie konkurencji a co za tym idzie na znaczące obniżenie kosztów.
- Komisja Przetargowa informuje, że wydzielono pozycję nr 13 z Zadania nr 3 i utworzono Zadanie nr 99.

Zadanie nr 4

22. Pozycja 11. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igły innego producenta niż w poz. 1-10? Powyższy zapis SIWZ sugeruje na konkretnego producenta.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
23. Pozycja 21 Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł do penów za op. a`100szt z przeliczenie na opakowania?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wycenę igieł do penów za op. a`100 szt. z przeliczeniem na opakowania.
24. Pozycja 23 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

25. Poz. 19 i 20. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy będzie wymagać, aby dostarczone igły doszpikowe (dwa rozmiary: dla dorosłych i dzieci pow.12 lat i dla dzieci 0 - 12 lat) posiadały, zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych, nadrukowaną przez producenta etykietę w języku polskim wraz z nazwą firmy będącej autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski, odpowiedzialnym przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za czynności przewidziane przez ustawę o wyrobach medycznych w przypadku wystąpienia incydentu medycznego?
- **Komisja Przetargowa informuje, że nie stawia wymogu w ww. zakresie.**
26. Poz. 19 i 20. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy będzie wymagać, aby Wykonawca był uprawniony przez producenta do dystrybucji na terenie Polski, co związane jest z odpowiedzialnością przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych związaną z akcjami korekcyjnymi dotyczącymi incydentów medycznych i potwierdził to odpowiednim dokumentem autoryzacyjnym od producenta?
- **Komisja Przetargowa informuje, że nie stawia wymogu w ww. zakresie.**
27. Poz. 19 i 20. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy będzie wymagać aby termin przydatności do użycia dostarczonych igieł doszpikowych wynosił przynajmniej 48 miesięcy, dzięki czemu w przypadku ich dłuższego przechowywania nie dojdzie do sytuacji kiedy to nieużyte igły utracą ważność – Zamawiający nie zostanie narażony na straty w wyniku zakupu i nieużycia igieł doszpikowych?
- **Komisja Przetargowa informuje, że nie stawia wymogu w ww. zakresie.**
28. Poz. 19 i 20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie poz. 19 i 20 z pakietu nr 4 tworząc nowy pakiet?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
29. Poz. 1-10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
30. Poz. 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły do pobrań z ściętą pod kątem 45 stopni w rozmiarze 18G 1,2x40mm?
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania igłę do pobrań ściętą pod kątem 45 stopni w rozmiarze 18G 1,2 x 40 mm .**
31. Poz. 11-12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
32. Poz. 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły do iniekcji w rozmiarze 0,5 x 40mm?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
33. Poz. 21-23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
34. Poz. 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły iniekcyjnej do wstrzykiwań insuliny w rozmiarze 0,33 x 12mm?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
35. Poz. 22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kolca przelewowego do rozpuszczania i przelewania płynów z opakowań typu butelka z 2 portami?
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania kolec przelewowy do rozpuszczania i przelewania płynów z opakowań typu butelka z 2 portami.**
36. Poz. 22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zaworu bezigłowego z dwoma drenami i portem?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
37. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, w pozycji 11 dopuści igłę z ostrzem nie sztancującym korka, złącze i oznakowanie barwne na opakowaniu każdej igły zgodne z norma ISO, z otworem bocznym, jałowa, jedn. uż. 18G (1,2 x 30) x 100 szt.?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

38. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, w pozycji 12 dopuści igłę do iniekcji 0,55x25? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
39. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, w pozycji 12 dopuści igłę do iniekcji 0,60x30? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
40. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, w pozycji 13 dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych 0,7x130? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
41. Czy Zamawiający wyłączy pozycję nr 13 z Zadania nr 4?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
42. Czy Zamawiający wyłączy pozycję nr 23 z Zadania nr 4?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
43. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, w pozycji 18 dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych 1,3x88?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
44. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, w pozycji 21 dopuści wycenę za opakowanie a`100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w pozycji nr 21 Zadania nr 4 wycenę za opakowanie a`100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości..
45. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, w pozycji 23 dopuści igłę 1,2x200mm?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 5

46. Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do jamy otrzewnej z drenem o długości 100cm, drenem przedłużającym o długości 40cm oraz igły G16/51mm?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
47. Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw do jamy opłucnej z zestawem trzyigłowym o długości 80mm (14G, 16G, 19G) spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
48. Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw do jamy opłucnej z zestawem trzyigłowym o długości 80mm (14G, 16G, 19G) spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
49. Pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o pojemności całkowitej 2500ml, pojemność worka 2000ml, pojemność komory pomiarowej 500ml, dren o długości 120cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
50. Pozycja 7-8 Czy Zamawiający dopuści worki do moczu w rozmiarze 190x70 mm w opakowaniach a`100 szt.?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania worki do moczu w rozmiarze 190 x 70 mm w opakowaniach a`100 szt.

Zadanie nr 6

51. Poz. 3. Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

52. Poz. 4. Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml, z możliwością stosowania do 7 dni – potwierdzone oświadczeniem producenta?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
53. Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zaciskacze do pępowiny wykonane z polipropylenu ?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania zaciskacze do pępowiny wykonane z polipropylenu.
54. Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści worek na mocz w którym min. dł. drenu wynosi 120cm?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania worek na mocz w którym min. dł. drenu wynosi 120 cm.

Zadanie nr 8

55. Poz. 1-7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniul do wlewów dożylnych z logo producenta na opakowaniu jednostkowym?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
56. Poz. 1-7. Czy Zamawiający wymaga kaniul z 4 paskami kontrastującymi w promieni RTG?
- Komisja Przetargowa informuje, że nie wymaga ale dopuszcza kaniule z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG.
57. Poz. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli do wlewów dożylnych w rozmiarze 2,05 x 45mm z przepływem 270ml/min?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza kaniule do wlewów dożylnych w rozmiarze 2,05 x 45 mm z przepływem 270 ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
58. Poz. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej do wlewów dożylnych wykonanej z FEP z logo producenta na opakowaniu jednostkowym?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
59. Poz. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej do wlewów dożylnych z przepływami:
- 1) 20G 65ml/min
 - 2) 18G 100ml/min
 - 3) 17G 142ml/min
 - 4) 16G 200ml/min
 - 5) 14G 305ml/min?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
60. Poz. 14, 15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przedłużacza do pomp infuzyjnych z średnicą wewnętrzną 1,2mm i zewnętrzną 2,5mm? Pozostałe zgodne z SIWZ
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
61. Poz. 16-18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
62. Poz. 19. Czy Zamawiający wymaga koreczków do kaniul dożylnych z trzpieniem poniżej korka?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
63. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 1 dopuści kaniulę fi 0,7x19 mm przepływ 23ml/min z portem, wykonaną z FEP z koreczkiem domykanym standardowo bez logo producenta na kaniuli i piktogramu wskazującego miejsce otwarcia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
64. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 2 dopuści kaniulę fi 0,9x25 mm przepływ 36ml/min z portem, wykonaną z FEP z koreczkiem domykanym standardowo bez logo producenta na kaniuli i piktogramu wskazującego miejsce otwarcia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

65. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 3 dopuści kaniulę fi 1,1x32 mm przepływ 56ml/min z portem, wykonaną z FEP z koreczkiem domykanym standardowo bez logo producenta na kaniuli i piktogramu wskazującego miejsce otwarcia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
66. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 4 dopuści kaniulę fi 1,3x45 mm przepływ 90ml/min z portem, wykonaną z FEP z koreczkiem domykanym standardowo bez logo producenta na kaniuli i piktogramu wskazującego miejsce otwarcia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
67. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 5 dopuści kaniulę fi 1,5x45 mm przepływ 142ml/min z portem, wykonaną z FEP z koreczkiem domykanym standardowo bez logo producenta na kaniuli i piktogramu wskazującego miejsce otwarcia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
68. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 5 dopuści kaniulę fi 1,5x45 mm przepływ 142ml/min z portem, wykonaną z FEP z koreczkiem domykanym standardowo bez logo producenta na kaniuli i piktogramu wskazującego miejsce otwarcia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
69. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 6 dopuści kaniulę fi 1,7x45 mm przepływ 200ml/min z portem, wykonaną z FEP z koreczkiem domykanym standardowo bez logo producenta na kaniuli i piktogramu wskazującego miejsce otwarcia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
70. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 7 dopuści kaniulę fi 2,1x45 mm przepływ 305ml/min z portem, wykonaną z FEP z koreczkiem domykanym standardowo bez logo producenta na kaniuli i piktogramu wskazującego miejsce otwarcia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
71. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 8 dopuści kaniulę bezpieczną, do wlewów dożylnych, w rozmiarach: 22G (0,9), dł.25mm, przepływ: 36ml/min, 20G (1,1), dł.32mm, przepływ: 56ml/min, 18G (1,3), dł. 45mm, przepływ: 90ml/min; 17G (1,5), dł. 45mm, przepływ: 142ml/min; 16G (1,7), dł. 45mm, przepływ: 200ml/min; 14G (2,1), dł. 45mm, przepływ: 305ml/min (rozmiary do wyboru przez zamawiającego). Wykonana z PUR, z 6 paskami kontrastującymi. Wklucie z dodatkowym portem iniekcyjnym – zabezpieczonym obrotowym - samo domykającym się koreczkiem z oznaczeniem Logo producenta kaniuli na korpusie, koreczek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów, pakowane w sztywny, szczelny blister – pack dokładnie dopasowany do kształtu wkłucia, na opakowaniu informacje o materiale z jakiego wykonana jest kaniula, informacja o braku zawartości LATEXU, data ważności, wszystkie parametry kaniuli: rozmiar, średnica. zew., długość kaniuli oraz przepływ?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
72. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 9 dopuści system bezigłowy posiadający objętość wypełnienia 0,085ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
73. Czy Zamawiający wyłączy pozycję 10-12 i 14-18 z Zadania nr 8?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
74. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8, w pozycji 19i 20 dopuści opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 9

75. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 9 wkłuc centralnych z trzyswiatłowym cewnikiem w rozmiarze wymaganym przez Zamawiającego, wykonanym z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, w zestawie prowadnica druciana odporna na zaginięcie z końcówka J, skrzydełka mocujące, rozszerzadło, strzykawka, igła ostra, cienkościenna.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania zestawu wkłuc centralnych o ww. parametrach.

76. Czy zamawiający kierując się uzyskaniem jak najlepszej ceny i zwiększając konkurencyjność zgodzi się na zaoferowanie wysokiej jakości zestawu wg. poniższej charakterystyki:

Cewnik trójświatłowy 7Fr o długości 20cm o przekrojach okrągłych na całej długości i charakteryzujący się wysokimi przepływami jak poniżej:

14G (2,11mm) / przepływ 5100 ml/h

18G (1,25mm)/ przepływ 1350 ml/h

18G(1,25 mm)/ przepływ 1350 ml/h

**Cewnik skalowany widoczny w RTG, światła cewnika identyfikowane kolorem na całej długości ,
prowadnica nitinolowa typ J 0,035''(0,89mm) x 50cm w aplikatorze ułatwiającym wprowadzenie,

**igła 18G (1,25mm) x 40mm,*

** strzykawką 5 ml ,*

** hydrofilne rozszerzadło 8 Fr (2,67mm x 12cm) ?*

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania cewnik o ww. parametrach.**

Zadanie nr 10

77. Poz. 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym, ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane TYVEK, posiadała dedykowany do niej system mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm oraz z 3 paskami do prowadzenia linii?

- **Komisja Przetargowa informuje, że nie wymaga ale dopuszcza aby kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym, ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane TYVEK, posiadała dedykowany do niej system mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm oraz z 3 paskami do prowadzenia linii.**

78. Poz. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do iniekcji z zabezpieczeniem przed zakłuciem po użytkowaniu w postaci plastikowej osłonki aktywowanej poprzez nacisk kciukiem, zapewniające szczelne połączenie ze strzykawką, ramię jednoelementowe, w kolorze identyfikującym rozmiar igły zgodnie z kodem kolorystycznym, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwi iniekcje pod małym kątem oraz nie zasłania miejsca iniekcji, sterylizowane tlenkiem etylenu.

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

79. Poz. 2-3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w/ pozycji do osobnego pakietu?

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

80. Poz. 2-3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli do wlewów dożylnych wykonanej z FEP? Pozostałe zgodne z SIWZ

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

81. Poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły bezpiecznej z plastikowym zatrzaskiem wewnątrz nasadki igły?

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

82. Poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w/ pozycji do osobnego pakietu?

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 11

83. Poz. 1-5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki bez kolorystycznego oznakowania na pojedynczym opakowaniu?

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

84. Poz. 1-4. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej z pojedynczą skalą?
• Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
85. Poz. 5, 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 3 częściowej z rozszerzona skalą 20/22ml pakowane po 50 szt.?
• Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
86. Poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki iniekcyjnej dwuczęściowej 20ml wydłużonej do 24ml?
• Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
87. Poz. 10. Czy Zamawiający wymaga strzykawki cewnikowej z podwójną skalą?
• Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
88. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11 poz. 1-4 dopuści strzykawkę z mlecznym tłokiem z kontrastującą czarną skalą?
• Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania strzykawkę z mlecznym tłokiem i kontrastującą czarną skalą. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
89. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11 poz. 1 dopuści strzykawkę z mlecznym tłokiem z kontrastującą czarną skalą rozszerzoną do 2,5ml co 0,1 ml, bez zawartości ftalanów, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na każdym opakowaniu zbiorczym, posiadającą nazwę producenta na cylindrze?
• Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
90. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11 poz. 2 dopuści strzykawkę z mlecznym tłokiem z kontrastującą czarną skalą rozszerzoną do 6 ml co 0,2 ml, bez zawartości ftalanów, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na każdym opakowaniu zbiorczym, posiadającą nazwę producenta na cylindrze?
• Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
91. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11 poz. 3 dopuści strzykawkę z mlecznym tłokiem z kontrastującą czarną podwójną skalą rozszerzoną do 12 ml co 0,5ml, bez zawartości ftalanów, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na każdym opakowaniu zbiorczym, posiadającą nazwę producenta na cylindrze?
• Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
92. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11 poz. 4 dopuści strzykawkę z mlecznym tłokiem z kontrastującą czarną podwójną skalą rozszerzoną do 24 ml co 1ml, bez zawartości ftalanów, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na każdym opakowaniu zbiorczym, posiadającą nazwę producenta na cylindrze?
• Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
93. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11 poz. 5 dopuści strzykawkę 20 ml ze skalą rozszerzoną do 24 ml co 1ml, z podwójną kryzą zabezpieczającą przed wypadnięciem tłoka po pobraniu pełnej objętości strzykawki, opakowanie zawierające 100 szt., oznaczone kodem kolorów?
• Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
94. Czy Zamawiający wyłączy pozycję 5 z Zadania nr 11?
• Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
95. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11, w pozycji 6 i 9 dopuści opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
• Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w pozycji nr 6 i 9 Zadania nr 11 opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.
96. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11, w pozycji 9 dopuści strzykawkę z igłą 0,50x16mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
• Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w pozycji 9 Zadania 11 strzykawkę z igłą 0,50 x 16 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

97. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11, w pozycji 9 dopuści strzykawkę z igłą 0,45x12mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w pozycji nr 9 Zadania nr 11 strzykawkę z igłą 0,45 x 12 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

98. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu 1 producenta dla pozycji 1-4 w Zadaniu nr 11?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 12

99. Pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści przewodnice intubacyjne o następujących rozmiarach i dopasowaniu do rurek intubacyjnych:

- 2,0 mm (275mm) do 2,5mm-3,5mm,
 - 3.3 mm (320 mm) do 4,0mm-5,5mm,
 - 4.7 mm (340 mm) do 6,0mm-10mm,
- pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

100. Pozycja nr 11 – Czy zamawiający odstąpi od zapisu, „zgrzewana miejscowo dla prawidłowego utrzymania wyprofilowanego kształtu rurki”, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zad. 101. Pozycja nr 11 - 15 – Czy zamawiający odstąpi od zapisu, „zamawiający wymaga aby asortyment z poz. 11 – 15 pochodził od jednego producenta”?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 13

102. Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej ceny wydzieli pozycje nr 1 i nr 2 do osobnego pakietu oraz dopuści wysokiej jakości jednostopniowy zestaw do konikotomii wg charakterystyki:

Zestaw do szybkiej konikotomii Quicktrach dla dorosłych. Zestaw do wykonania konikopunkcji metodą jednostopniową. Zawiera: Iglę punkcyjną z nałożoną kaniulą o śr. 4 mm z łącznikiem 15mm do worka resuscytacyjnego i łącznikiem Luer; stoper kontroli głębokości wklucia; strzykawkę do kontroli aspiracji gazów; taśmę do umocowania kaniuli. Zestaw pakowany na tacce, sterylne.

Zad. Zestaw do szybkiej konikotomii Quicktrach dla dzieci. Zestaw do wykonania konikopunkcji metodą jednostopniową. Zawiera: Iglę punkcyjną z nałożoną kaniulą o śr. 2 mm z łącznikiem 15mm do worka resuscytacyjnego i łącznikiem Luer; stoper kontroli głębokości wklucia; strzykawkę do kontroli aspiracji gazów; taśmę do umocowania kaniuli. Zestaw pakowany na tacce, sterylne.

Zestaw do szybkiej konikotomii Quicktrach dla niemowląt. Zestaw do wykonania konikopunkcji metodą jednostopniową. Zawiera: Iglę punkcyjną z nałożoną kaniulą o śr. 1,5 mm z łącznikiem 15mm do worka resuscytacyjnego i łącznikiem Luer; stoper kontroli głębokości wklucia; strzykawkę do kontroli aspiracji gazów; taśmę do umocowania kaniuli. Zestaw pakowany na tacce, sterylne?

- Komisja Przetargowa informuje, że potrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 14

103. Poz. 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości rękawic posiadających rolowany mankiet, bez taśmy adhezyjnej, wzmocniony, zapobiegający zsuwaniu się rękawicy z mankieta fartucha.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania wysokiej jakości rękawice posiadające rolowany mankiet, bez taśmy adhezyjnej, wzmocniony, zapobiegający zsuwaniu rękawicy z mankieta fartucha.

Zadanie nr 17

104. Do strzykawki automatycznej jakiego producenta są wymagane wkłady?

- Komisja Przetargowa informuje, że wymagane przez Zamawiającego wkłady mają być kompatybilne z automatyczną strzykawką SIRINGE 2000 TK.

105. Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie wężyk spiralnego z limitem ciśnienia do 325 PSI?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
106. Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wymaga drenu z zastawką bezzwrotną, czy bez zastawki?
- Komisja Przetargowa informuje, że nie stawia wymogu w ww. zakresie.
107. Czy zamawiający w zadaniu nr 17 poz. 2 miał na myśli wężyki spiralne TK długości 1,52 m z limitem ciśnienia do 400 PSI (2758 kPA) MAX?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w poz. 2 Zadania nr 17 wężyki spiralne TK długości 1,52 m z limitem ciśnienia do 400 PSI (2758 kPA) MAX.

Zadanie nr 22

108. Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły kulkowej luer pakowanej a' 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym tj. 4 opakowania? Pozostałe parametry igły bez zmian.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w poz. nr 1 igłę kulkową luer pakowaną a' 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie tj. 4 opakowania. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 24

109. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do zamawiającego o umożliwienie udziału w postępowaniu poprzez wyrażenie zgody na cewników permanentnych o niewielkich różnicach technicznych lecz o takiej samej funkcjonalności, wykonany z durathanu, materiału wytrzymałego, miękkiego, elastycznego, odpornego na środki dezynfekcyjne, posiada mufkę poliestrową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki, końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy, przekrój 15,5 Fr, Rozmiary: 31/36 cm; 35/40 cm; 43/48 cm; 50/55 cm - do wyboru przez zamawiającego
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

110. Czy zamawiający kierując się uzyskaniem jak najlepszej ceny i zwiększając konkurencyjność zgodzi się na zaoferowanie wysokiej jakości zestawu wg. poniższej charakterystyki:

Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy:

- cewnik o rozmiarze 14 FR charakteryzujący się wysokimi przepływami 400 ml/min ;

- przekrój cewnika "podwójne D";

- cewnik zakończony niesymetrycznie - różnica 3 cm pomiędzy kanałem żylnym a tętniczym .

Cewnik wykonany z termoplastycznego poliuretanu (carbothan);

- posiada mufę poliestrową;

- ramiona cewnika wykonane z termoplastycznego poliuretanu, kodowane kolorami zaciski , zakończone koreczkami ;

- dostępne do wyboru długość cewnika do mufy/ długość całkowita:

*19cm/24cm,

* 23cm/28cm,

* 27cm/32cm,

* 31cm/36cm,

* 35cm/40cm,

* 50cm/ 55cm;

W skład zestawu wchodzi:

* cewnik z nadrukiem pojemności kanałów na ramionach cewnika i grubości cewnika na rozgałęźniku, *igła typu Y 18g/1,25mm x 7cm z bocznym portem,

*wysokiej jakości prowadnica nitinolowa typu J o grubości 0,035''/0,089mmx 70cm umieszczona w skalowanym podajniku z ząbkowym rolką do łatwiejszej aplikacji,

* rozszerzadła:

dla cewnika 14 Fr: 12 FRx 11cm , 14 FR x 14cm, trzecie rozszerzadło 16Fr z rozrywalną koszulka roboczą (zawiera zastawkę hemostatyczną) ,

* bagnet do tunelizacji 18cm,

* strzykawka 10ml,

* skalpel 11,

* 2 nakrętki/ koreczki,

**skrzydelka do przyszycia cewnika oraz dodatkowo plaster z rzepem do bezszwowego zamocowania cewnika, 2 opatrunki w formie plastra, naklejka identyfikacyjna pacjenta. Cewniki dostępne w wersji prostej i zagiętej. Zestawy pakowane sterylnie z pełną i dokładną charakterystyką składu zestawu na opakowaniu wraz 2 naklejkami z nr kat, nr serii, terminem przydatności do wklejenia np. w kartę pacjenta dla identyfikacji konkretnego cewnika?*

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 27

111. *Bardzo proszę o przesłanie po 1 próbce z pkt 1 i 2, w celu weryfikacji wzorów kopert.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że w celu weryfikacji wzorów kopert zostały w pkt 1 i 2 podane wymagania dot. przedmiotowego asortymentu..**
112. *Bardzo proszę o informację czy koperty medyczne w pakiecie nr 27 są zamykane na klapkę, czy też wysuwane na kciuk.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że nie stawia wymogu w ww. zakresie.**

Zadanie nr 28

113. *Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem i drenem o długości 210cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w poz. 7 maskę tlenową z nebulizatorem i drenem o długości 210 cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ.**
114. *Pozycja 8-10 Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
115. *Czy zamawiający dopuści w pozycji 5 i produkt czysty mikrobiologicznie?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w poz. 5 produkt czysty mikrobiologicznie.**
116. *Czy zamawiający wyłączy z zadania pozycje 1-6 i utworzy oddzielny pakiet pozwoli to na zachowanie zasad konkurencyjności, oraz pozwoli na obniżenie kosztów?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
117. *Poz. 1. Czy zamawiający wymaga maskę tlenową jednorazową o anatomicznym kształcie, wykonaną z delikatnego medycznego materiału PCV, nie zawierającą lateksu oraz szkodliwych ftalanów, z antyzagięciowym drenem tlenowym o dł. 200 cm ze standardowym złączem, z blaszką dopasowującą do nosa, maska z otworami bocznymi ułatwiająca wydech?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania maskę o ww. parametrach.**
118. *Poz. 2. Czy zamawiający wymaga drenu tlenowego o długości 200 cm ze standardowym złączem, o przekroju gwiazdkowym, antyzagięciowym, wykonanego z bardzo delikatnego medycznego PVC, nie zawierającego szkodliwych ftalanów?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania dren o ww. parametrach.**
119. *Poz. 3. Czy zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową jednorazową o anatomicznym kształcie, wykonaną z delikatnego medycznego materiału PCV, nie zawierającą lateksu oraz szkodliwych ftalanów, z antyzagięciowym drenem tlenowym o dł. 200 cm ze standardowym złączem, z blaszką dopasowującą do nosa, maska z otworami bocznymi ułatwiająca wydech, w jednym uniwersalnym rozmiarze pediatrycznym?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
120. *Poz. 4, 5, 6. Czy zamawiający dopuści jako równoważny cewnik do podawania tlenu przez nos mikrobiologicznie czysty?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w poz. 4, 5, 6 cewnik do podawania tlenu przez nos mikrobiologicznie czysty.**
121. *Poz. 5, 6, Czy zamawiający dopuści jako równoważny cewnik do podawania tlenu przez nos w jednym uniwersalnym rozmiarze dla dzieci i niemowląt, produkt mikrobiologicznie czysty?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

122. Poz. 8, 9, 10, 11, 12, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 28 pozycji nr 8, 9, 10, 11 oraz 12 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

123. Poz. 13, Czy Zamawiający wymaga maskę tlenową z nebulizatorem wykonaną z materiału PCV, z blaszką dopasowującą się do nosa, z antyzagięciowym drenem tlenowym o dł. 2m ze standardowym złączem, nebulizator z dyszą Venturiego o poj. 8ml, produkt czysty mikrobiologicznie?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w poz. 13 maskę o ww. parametrach.

Zadanie nr 30

124. Poz. 26. Czy Zamawiający wyłączy ww. pozycje i stworzy odrębny pakiet z wyłączoną pozycją, co umożliwi producentom podkładów złożenie ofert konkurencyjnych cenowo i pozwoli na zachowanie zasad uczciwej konkurencji, tj. przystąpienie do przetargu większej liczby oferentów?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

125. Poz. 26. Czy Zamawiający na potwierdzenie wymaganej chłonności podkładów wymaga załączenia do oferty karty danych technicznych?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza złożenie karty danych technicznych na potwierdzenie wymaganej chłonności podkładów.

Zadanie nr 32

126. W związku ze zmianą stanu prawnego dotyczącego ŚOI zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie możliwości zaoferowania rękawic spełniających normy EN 374 – 1 (z wyl. pkt. 5.3.2), 2, 3 lub normy EN ISO 374-1, 2, 4, 5 i EN ISO 16523-1.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania rękawice spełniające ww. normy.

127. Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia do oferty dla pozycji nr 1 badań producenta w zamian za kartę techniczną producenta.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza się możliwość załączenia do oferty dla pozycji nr 1 badań producenta w zamian za kartę techniczną producenta.

128. Poz. 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic sekcyjnych w rozmiarach: 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10 do wyboru przez Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zaoferowanie rękawic sekcyjnych w rozmiarach: 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10 do wyboru przez Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

129. Poz. 5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic diagnostycznych neoprenowych, bezpydrowych, z wewnętrzną warstwą powlekaną poliakrylanem, która jest innym rodzajem polimeru.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zaoferowanie rękawic diagnostycznych neoprenowych, bezpydrowych, z wewnętrzną warstwą powlekaną poliakrylanem.

Zadanie nr 34

130. Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy w rozmiarze 150x190cm?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w poz. 1 serwetę na stół narzędziowy w rozmiarze 150 x 190 cm.

131. Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę ginekologiczną o parametrach: serweta w rozmiarze 160cm/240cm x 180cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza 10cm x 15cm, zintegrowana z torbą stożkową 35cm x 50cm wyposażoną w sztywnik, filtr oraz port do podłączenia drenu?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

132. *Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze materiału podstawowego min. 35g/m²?*
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
133. *Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze wzmocnienia min. 40g/m²?*
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
134. *Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch zapinany na standardowy rzep?*
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
135. *Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 65cm H₂O?*
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
136. *Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch z BI materiału wzmocnionego = 3,2?*
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
137. *Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kieszeń przylepną w rozmiarze 30x40cm?*
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
138. *Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści uchwyt Velcro w rozmiarze 2x22cm?*
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
139. *Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe w rozmiarze 23cm?*
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
140. *Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści ręczniczki w rozmiarze 30x30cm?*
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
141. *Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści materiał obłożenia o następujących parametrach: odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N, odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O, współczynnik pylenia < 1.3log₁₀, chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%?*
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
142. *Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu TYVEK?*
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
143. *Pozycja 1 Czy Zamawiający odstąpi od I klasy palności dla materiału obłożenia?*
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
144. *Poz. nr 1 - czy Zamawiający uznaje skład Zestawu ginekologicznego za skład minimalny?*
- Komisja Przetargowa informuje, że Zamawiający uznaje skład Zestawu ginekologicznego za skład minimalny.

Zadanie nr 35

145. *Poz. 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania produktu w opakowaniu po 50 szt po odpowiednim przeliczeniu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.*
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zaoferowanie produktu w opakowaniu po 50 szt. po odpowiednim przeliczeniu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
146. *Poz. 3. Prosimy o doprecyzowanie czy wpisując jednostkę miary nie doszło do pomyłki? Czy Zamawiający oczekuje 30 opakowań opisanego produktu?*
- Komisja Przetargowa informuje, że w poz. 3 zmieniono jednostkę miary ze szt. na op.
147. *Pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści myjkę niepodfoliowaną, wykonaną w całości z poliestru o gramaturze: przód – 100g/m², tył – 70g/m², pozostałe parametry zgodne z SIWZ?*
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
148. *Pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 17 x 24,5 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?*
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 40

149. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny elektrod EKG w zadaniu 40. w przeliczeniu na opakowania jednostkowe 50 sztuk. Ilość zaoferowanych opakowań zostanie odpowiednio przeliczona.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wycenę elektro EKG w przeliczeniu na opakowania jednostkowe 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem.
150. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 40. poz. 2 równoważnej elektrody EKG o rozmiarze 45x43 mm. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w poz. 2 elektrody EKG o rozmiarze 45 x 43 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
151. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 40. poz. 2 równoważnej elektrody EKG o rozmiarze 51x36 mm. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
152. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 40. poz. 2 równoważnej elektrody EKG o rozmiarze 50x36 mm. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
153. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 40. poz. 3 równoważnej elektrody EKG do Holtera o rozmiarze 55x41 mm. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w poz. 3 elektrody EKG do Holtera o rozmiarze 55 x 41 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
154. Poz. 1, 2, 3. Prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny za op. – 50 szt., z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wycenę za opakowanie – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.
155. Poz. 1, 2, 3. Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszczono (j.w.).
156. Poz. 1. Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody dla dzieci w kształcie 10-płatkowego kwiatka o rozmiarze 25,7 mm.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania elektrody dla dzieci w kształcie 10-płatkowego kwiatka o rozmiarze 25,7 mm.
157. Poz. 2. Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody dla dorosłych o rozmiarze 44 x 30 mm.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
158. Poz. 2. Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody dla dorosłych o rozmiarze 40 x 36 mm.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
159. Poz. 2. Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody dla dorosłych o rozmiarze 42 x 36 mm.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
160. Poz. 3. Prosimy o wyjaśnienie czy elektroda do holtera ma posiadać podłużne wycięcie bez przecięcia boków elektrody służące do przełożenia kabla?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza w elektrodzie do holtera podłużne wycięcie bez przecięcia boków elektrody służące do przełożenia kabla.

Zadanie nr 41

161. Poz. 1, 2. Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod do czasowej stymulacji o długości 110 cm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w poz. 1 i 2 Zadania nr 41 elektrody do czasowej stymulacji o długości 110 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zadanie nr 42

162. Czy w pakiecie 42 Zamawiający oczekuje zaofiarowania 500 czy 5000 elektrod? Elektrody tego typu są pakowane w opakowania jednostkowe zawierające parę elektrod gotową do użycia, które mogą być sprzedawane osobno, nie w opakowaniach po 10 szt.
- Komisja Przetargowa informuje, że oczekuje zaofiarowania 500 (pięćset) elektrod. Dopuszcza się opakowania jednostkowe zawierające parę elektrod. Jednocześnie informujemy, że zmieniono jednostkę miary z opakowań na sztuki.
163. Poz. 1.. Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do defibrylacji w op. – 2 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i ich wyceną.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaofiarowania elektrody do defibrylacji w opakowaniach 2 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i ich wyceną.
164. Poz. 1. Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod do defibrylacji nieoryginalnych będących zamiennikiem oryginalnych elektrod Quick Combo EDGE System ze złączem REDI PAK
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
165. Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści elektrody Quick-Combo pakowane a'2 szt. z przeliczeniem na 2500op. ?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaofiarowania elektrody Quick-Combo pakowane a'2 szt.

Zadanie nr 43

166. Poz. 1, 6. Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycjach należy zaofiarować papiery oryginalne czy Zamawiający dopuści również papiery będące zamiennikami oryginalnych papierów producentów MITSUBISHI (poz. 1) i SONY (poz. 6).
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaofiarowania papiery będące zamiennikami oryginalnych papierów producentów Mitsubishi (poz. 1) i Sony (poz. 6).
167. Poz. 1, 6. Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia próbek w pozycji nr 1 i 6, ze względu na ich wysoki koszt, w przypadku gdy wykonawca zaofiaruje oryginalne papiery producentów MITSUBISHI (poz. 1) i SONY (poz. 6), których parametry i jakość jest znana pracownikom Zamawiającego.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
168. Poz. 4. Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 104 mm x 40 m.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
169. Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści papier do EKG MR Gold w rozmiarze 210mm x 20m z przeliczeniem na 1200 rolek?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
170. Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści papier do EKG Ascard 3 Gold w rozmiarze 104mm x 40m z przeliczeniem na 150 rolek?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 45

171. Poz. 9 i 12. Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie z zadania 45 pozycji 9 – zestaw uniwersalny do krótkich procedur oraz 12- zestaw uniwersalny wzmocniony i utworzenie z nich osobnego pakietu.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 46

172. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 3 „układ jednorazowy dla noworodka do respiratora (kompatybilne z respiratorem Sechrist)”, i stworzenie dla tej pozycji osobnego zadania wraz z opisem:
- „Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratorów z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech o średnicy 10 mm, posiadający w drenie na linii wdechowej spiralną grzałkę a na linii wydechowej pułapkę wodną ze sprężyną – wykonaną w technologii gwarantującej łatwe i bezpieczne opróżnianie pułapki wodnej poprzez automatyczne uszczelnienie układu w momencie odkręcenia pułapki.

- dren łączący respirator z komorą nawilzacza o dł. 67 cm, posiadający adapter od strony respiratora o śr. M 15 mm, adapter od strony komory nawilżającej śr. F 22 mm, oraz posiadający wejście typu luer lock
 - dren na odcinku, komora nawilżająca, część Y o dł. 150 cm. W odległości 110 cm od komory nawilżającej umiejscowione wejście na czujnik temperatury;
 - część wydechowa składająca się z drenu o dł. 65 cm, oraz drenu o dł. 95 cm. posiadającym wejście typu luer lock, przy części Y, oba dreny na linii wydechowej połączone pułapką wodną, całkowita dł. linii wydechowej 165 cm.
 - w komplecie dren proksymalny; (dł. 185 cm)
- Część Y obrotowa ułatwiająca umiejscowienie rurki intubacyjnej, oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; w zestawie komplet adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów.
- 2 adaptory o dł. 75 mm, wejście z jednej strony o śr. M 18 mm / F 15 mm, wejście z drugiej strony elastyczne M 14 mm.
 - 2 adaptory o dł. 33 mm, wejście z jednej strony o śr. M 13 mm, wejście z drugiej strony M 15 mm.
 - 2 adaptory o dł. 33 mm, wejście z jednej strony o śr. M 15 mm, wejście z drugiej strony M 7 mm.
 - 1 adapter o dł. 43 mm, wejście z dwóch stron o śr. M 22 mm.
 - 1 adapter o dł. 33 mm, wejście z jednej strony o śr. M 15 mm, wejście z drugiej strony o śr. M 12 mm. adapter wyposażony w wejście typu luer lock
 - 1 zapasowa końcówka do drenu proksymalnego

Przepływ gazów powyżej 4L/min (oznakowanie na etykiecie). Układ na całej długości powinien zachować średnicę 10 mm, jako standard układów oddechowych noworodkowych, średnica 10 mm. na całej długości zapobiega zwiększeniu tzw. 'przestrzeni martwej'.

Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury stosowanego do modelu nawilzacza MR850 firmy Fisher&Paykel.

Komplet musi zawierać uniwersalną komorę samonapełniająca posiadającą dwa pływaki – jeden odpowiadający za kontrolę maksymalnego poziomu wody a drugi zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Oba pływaki zamocowane na ścianie bocznej komory, w tym jeden pływak pracujący w ruchu wahadłowym a drugi w płaszczyźnie pionowej. Zastosowane dwa pływaki zwiększają bezpieczeństwo pacjenta przy zachowaniu stałego poziomu wody. Komora posiadająca wskaźnik poziomu wody. Posiadająca zintegrowany, nierozłączalny dren o długości 90 cm zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym. Komora gotowa do użycia natychmiast po wpięciu jej w butelkę z wodą do iniekcji. Pasująca do wszystkich nawilzaczy Fisher&Paykel z serii MR, oraz większości nawilzaczy innych firm dostępnych na rynku. Otwór wejścia 22 mm M (zewnętrzna średnica), Otwór wyjścia 22 mm M (zewnętrzna średnica). Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu."

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 47

173. Poz. 1. Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do osobnego zadania lub prosimy o odstąpienie od wymogu pierścienia okalającego, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 50

174. Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wziernik j. u. do otoskopów w opakowaniach a' 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem?

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania wziernik w opakowaniach a' 100 szt z odpowiednim przeliczeniem.**

Zadanie nr 55

175. Czy zamawiający oczekuje aby absorpcja CO2/l była w zakresie 178-200 CO2/L?

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza absorpcję CO2/l w zakresie 178-200 CO2/l.**

176. Czy Zamawiający oczekuje wapna o rozmiarze granulatu 2-4 mm, wilgotności 12-18 %, absorpcji min 130 l/kg, bez zawartości KOH w opakowaniach 5 kg?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaferowania wapno o rozmiarze granulatu 2-4 mm, wilgotności 12-18 %, absorpcji min 130 l/kg, bez zawartości KOH w opakowaniach 5 kg.
177. Z uwagi na to, iż niektóre parametry i właściwości wapna mogą szkodliwie wpływać na pacjenta poprzez ryzyko rozpadu anestetyków i pojawienia się tlenku węgla („czadu”), prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wapno sodowane ma być ze wskaźnikiem zużycia (zmieniające barwę z białej na fioletową), w postaci granulek, o parametrach: kruchość 95%, zawartość wilgoci wody 12-19% , absorpcja CO₂ 19%), współczynnik pochłaniania w przybliżeniu 140l/kg, łączna zawartość metali alkaicznych do 4%, w opakowaniu 4,5 kg (5 litrów)?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wapno o ww. parametrach.

Zadanie nr 56

178. Czy Zamawiający oczekuje nakłuwacza bezpiecznego (nożyka) w rozmiarze 0,8 x 2,0 mm (100-200 ul) typu grzybek ?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaferowania nakłuwacz bezpieczny (nożyk) w rozmiarze 0,8 x 2,0 mm (100-200 ul) typu grzybek.

Zadanie nr 57

179. Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szczotkę dwustronną do czyszczenia kanałów endoskopu o średnicy włosia 6mm / 6mm z plastikową kulką ochronną, wyciory długości 20mm i długości roboczej 250cm lub szczotkę o średnicy włosia 5mm / 10mm z plastikową kulką ochronną, wyciory długości 20mm i długości roboczej 230cm? Wspomniane wyżej wyroby nadają się do kanału endoskopu o śr. roboczej 2,8 - 4,2mm.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
180. Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści szczotkę dwustronną do czyszczenia kanałów endoskopu o średnicy włosia 6mm / 6mm z plastikową kulką ochronną, wyciory długości 20mm i długości roboczej 250cm lub szczotkę o średnicy włosia 5mm / 10mm z plastikową kulką ochronną, wyciory długości 20mm i długości roboczej 230cm? Wspomniane wyżej wyroby nadają się do kanału endoskopu o śr. roboczej 2,8 - 4,2mm.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 58

181. Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie termometru cyfrowego z prostą nie giętą zaokrąglaną końcówką pomiarową, nie zawierający rtęci, całkowicie wodoodporny, nadający się do dezynfekcji przez zanurzenie w płynie dezynfekcyjnym, do pomiaru temp. ciała u dorosłych i dzieci (w pachwinie i pod pachą), bez elementów szklanych ?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaferowania termometr o ww. parametrach.

Zadanie nr 59

182. Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści szczotkę jałową z gąbką bez detergentu w op. 40 szt. z przeliczeniem na 6 opakowań ?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaferowania w poz. 2 szczotkę jałową z gąbką bez detergentu w op. 40 szt. z przeliczeniem na 6 opakowań.

Zadanie nr 60

183. Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić z zadania 60 do osobnego pozycję 1 - Czujnik jednorazowy do pomiaru kapnometrii dla dzieci i dorosłych zaintubowanych i niezaintubowanych do defibrylatora Lifepac 12, 15, 20?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

184. *Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z zadania nr 60 pozycji 2 i utworzenie z niej nowego pakietu.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że wydzielono pozycję nr 2 z Zadania nr 60 i utworzono nowe Zadanie nr 101.**

Zadanie nr 61

185. *Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy i irygacji worków o poj. 1750ml z jednym otworem centralnym i z jednym otworem bocznym ?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 62

186. *Poz.14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiennika ciepła i wilgoci którego waga wynosi 8g , a skuteczność nawilżania 26mg/l ?. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.*

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania wymiennik ciepła i wilgoci którego waga wynosi 8 g. a skuteczność nawilżania 26 mg/l.**

187. *Poz. 15. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania układu oddechowego z 2 rurami o dł. 200cm , pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.*

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

188. *Czy zamawiający wyłączy z zadania pozycje 15-17 i utworzy oddzielny pakiet pozwoli to na zachowanie zasad konkurencyjności, oraz pozwoli na obniżenie kosztów?*

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

189. *Poz. 9-17. Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji i możliwość uzyskania najlepszej oferty, wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?*

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

190. *Poz. 9. Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji i możliwość uzyskania najlepszej oferty, dopuści w powyższym zakresie łyżki do laryngoskopu, światłowodowe, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nieodkształcająca się łyżka wykonana niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu. Kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO (tzw. Zielona specyfikacja) Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego. Wytrzymały zatrzask kulkowy osadzony w plastikowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Włókna światłowodu osadzone w rdzeniu z tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wewnątrz jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol Ce, numer seryjny i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) na łyżce. Pakowanie w podwójne opakowanie jednostkowe folia- folia (łyżka umieszczona w kieszonce foliowej, całość zapakowana w jednostkowe opakowanie foliowe) z oznaczeniem daty ważności, rozmiaru łyżki i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Każdy rozmiar kodowany innym kolorem. Kompatybilne ze wszystkimi rękojeściami wykonanymi w systemie GREEN.*

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

191. *Poz. 14. Czy Zamawiający dopuści filtr o masie 9.5 g?*

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w poz. 14 filtr o masie 9,5 g.**

192. *Poz. 15. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z dwoma gałęziami o długości 180 cm, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?*

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

193. *Poz. 16. Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne, jednorazowego użytku, wykonane z medycznego PCV, spełniający pozostałe wymagania?*

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w poz. 16 maski anestetyczne, jednorazowego użytku, wykonane z medycznego PCV, spełniające pozostałe wymagania.**

194. Pozycja nr 1 – Czy zamawiający odstąpi od parametru dotyczącego obwodu oddechowego jakim jest „antybakteryjność”, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
- Komisja Przetargowa informuje, że **podtrzymuje zapisy SIWZ.**
195. Pozycja nr 9 – Czy zamawiający dopuści tyżki światłowodowe o następujących rozmiarach: 2 (długość 120mm, szerokość 21mm), 3 (długość 140mm, szerokość 21 mm), 4 (długość 160mm, szerokość 21mm), o długości od końca części akrylowej do końca tyżki wynoszącej około 38mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
- Komisja Przetargowa informuje, że **podtrzymuje zapisy SIWZ.**
196. Pozycja nr 14 – Czy zamawiający dopuści filtr do rurki tracheostomijnej o wadze 10 g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
- Komisja Przetargowa informuje, że **dopuszcza do zaferowania filtr do rurki tracheotomijnej o wadze 10 g. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**
197. Pozycja nr 15 – Czy zamawiający dopuści w układzie oddechowym anestetycznym rury karbowane o długości 180cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
- Komisja Przetargowa informuje, że **podtrzymuje zapisy SIWZ.**
198. Zamawiający w pakiecie nr 62, poz. 1 wymaga:
 „obwód oddechowy jednorazowego użytku do respiratora dla dorosłych z powłoką antybakteryjną, z workiem 2 l składający się z trzech rur karbowanych, dwóch portów oraz łącznika Y z portami Luer Lock”
 Czy Zamawiający w pakiecie nr 62, poz. 1 dopuści obwód oddechowy gładki wewnętrznie zapobiegający gromadzeniu się bakterii, pozostałe parametry bez zmian?
 Zamawiający opisując przedmiot zamówienia opisał obwód oddechowy 1 producenta, przez co naruszył zapisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie art. 7 ust. 1 Ustawy PZP dotyczące zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz **uniemożliwia złożenie oferty konkurencyjnej.**
 Zamawiający musi zachować zasadę uczciwej konkurencji (art. 29 ust. 2 Pzp). Nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła, szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców (art. 29 ust. 3 Pzp).
 Powłoka antybakteryjna w obwodzie oddechowym charakteryzuje tylko 1 producenta, a nie daje możliwości dłuższego stosowania niż standardowe obwody gładkie wewnętrznie.
 Nie dość, że Zamawiający otrzyma produkt 2-3 razy droższy od standardowego, to produkt ten nie pozwoli na dłuższe lub bezpieczniejsze stosowanie. Proponowane przez nas obwody oddechowe gładkie wewnętrznie mają bardzo gładką powierzchnię wewnętrzną, dzięki czemu nie powodują kolonizacji bakterii, a pozwalają Zamawiającemu na oszczędność kosztów, przy równoczesnym dbaniu o pacjenta oraz równoważne funkcjonowanie układu oddechowego.
- Komisja Przetargowa informuje, że **podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 65

199. Pozycja 1,2. Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego producenta pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (pojemniki, mocowniki).
- Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, oraz w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpracują z dowolnym źródłem ssania. Wkłady wykonane z polietylenu. Wkłady częściowo sprasowane. Wkłady oraz kanistry (pojemniki) występują o pojemności 1000 ml oraz 2000 ml. Pojemniki wyposażone są w uchwyt do mocowania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i

bezpieczeństwem użytkowania.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196) który spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki w przypadku wybrania naszej oferty.

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania antybakteryjny system do odsysania na ww. zasadach.**

200. *Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy 5,6 mm ?*

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w poz. 2 dren o średnicy 5,6 mm.**

201. *Dot. poz. 3. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie zaistniała omyłka w opisie przedmiotu zamówienia w poz. nr 3, gdyż wkłady w takiej postaci nie mogą być kompatybilne z kanistrami z pozycji nr 1.*

Wobec powyższego prosimy o zaakceptowanie wkładów workowych kompatybilnych z pojemnikami wyspecyfikowanymi w pozycji nr 1, które charakteryzują się następującymi cechami:

- wykonany jest z cienkiej poliolefiny, dzięki czemu jest dostarczany w postaci sprasowanej dla zmniejszenia powierzchni magazynowej
- wyposażony jest w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową
- pokrywa wkładu wyposażona jest w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrem ze zintegrowanym króćcem ssącym
- posiada tylko jeden króciec przyłączeniowy - do pacjenta, dzięki czemu podczas wymiany, obsługiwane jest tylko jedno złącze. Króciec jest kątowy, schodkowy, obrotowy z możliwością jego odłączenia dla uzyskania przyłącza ortopedycznego o średnicy 12 mm
- jest samo zasysający
- wyposażony jest w pętlę do demontażu worka zarówno przez osoby prawo i leworęczne
- jest wyposażony w specjalny port do stosowania proszku żelującego
- posiada datę ważności nadrukowaną na opakowaniu zbiorczym

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania wkłady workowe o ww. parametrach.**

Zadanie nr 68

202. *Poz. 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz 4 układu oddechowego o podanych niżej parametrach:*

Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR850 lub MR730. Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, rura karbowana koloru niebieskiego o długości całkowitej 150 cm, Ø wew. 10 mm, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej o długości 110 cm z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza Ø wew. 22 mm, zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850 lub MR730), z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego z generatorem. W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm.

Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową. Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem o długości 65 cm, z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów. W komplecie zestaw adapterów o różnych średnicach.

Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasiemek. Wylot gazów z generatora za pomocą rozciągliwego drewnu w zakresie 27 – 70 cm. Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach (S, M, L). Każdy rozmiar oznakowany trwałym kolorem, w celu szybkiej identyfikacji.

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

203. *Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz 4 komory nawilżacza o następujących parametrach:*

Uniwersalna komora samonapełniająca do nawilżaczy dla dorosłych, dzieci i noworodków posiadającą dwa pływaki – jeden odpowiadający za kontrolę maksymalnego poziomu wody a drugi zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Oba pływaki zamocowane na ścianie bocznej komory, w tym jeden pływak pracujący w ruchu wahadłowym a drugi w płaszczyźnie pionowej. Zastosowane dwa pływaki zwiększają bezpieczeństwo pacjenta przy zachowaniu stałego poziomu wody. Komora posiadająca wskaźnik poziomu wody. Posiadająca zintegrowany, nierozłączalny dren o długości 90 cm zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym. Komora gotowa do użycia natychmiast po wpięciu jej w butelkę z wodą do iniekcji. Pasująca do wszystkich nawilżaczy Fisher&Paykel z serii MR, oraz większości nawilżaczy innych firm dostępnych na rynku. Otwór wejścia 22 mm M (zewnętrzna średnica), Otwór wyjścia 22 mm M (zewnętrzna średnica). Produkt mikrobiologicznie czysty

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 72

204. *Czy zamawiający dopuści próżnościąg położniczy jałowy „KIWI”, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany, ergonomiczny uchwyt oraz łatwo dostępny zawór zwalniający próżnię, ze wskaźnikiem wartości wytworzonej próżni, w postaci czytelnej podziałki. Dodatkowo próżnościąg posiada wskaźnik siły ciągnięcia, pozwalający uniknąć przekroczenia bezpiecznej wartości i tym samym zmniejszyć możliwość komplikacji. Próżnościąg posiada atraumatyczne miseczki o średnicy 50mm lub elastyczne miękkie miseczki w kształcie dzwonu o średnicy 59mm?*

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania próżnościąg położniczy o ww. parametrach.**

Zadanie nr 73

205. *Pozycja 1 Czy zamawiający dopuści zestaw ochrony biologicznej o składzie:*

- Kombinezon ChemSafe kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC, typ 3 + 4 + 5 + 6, zgodny z EN 1149-5, EN 1073, EN14126 – 1 szt.
- Półmaska filtrująca typu FFP3 NR D EN z zaworem, zgodna z EN 149: 2001 + A1:2009 – 1 szt.
- Okulary ochronne – google zgodne z normą EN 166, I klasa optyczna – 1 szt.
- Rękawice nitylowe, bezpudrowe, niebieskie, kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej Dyrektywy Europejskiej 89/686/EEC, testowane zgodnie z EN 374-2, EN 374-3, EN 420, EN 455, AQL 1,5 – 1 para
- Rękawice chemiczne testowane zgodnie z EN388, EN374 – 1 para
- Ochraniacze na buty, foliowe, długie, mocne – 1 para
- Worek na odpady w celu zebrania po użyciu wszystkich elementów zestawu i poddania utylizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami – 1 szt.



- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zestaw o ww. parametrach.**

Zadanie nr 79

206. *Poz. 1-3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?*

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

207. *Poz. 1-3. Czy Zamawiający wymaga worków do osłony przed światłem w kolorze żółtym?*

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 80

208. Poz. 1, 2, 3. Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2, 3 do osobnego zadania lub prosimy o odstąpienie od wymogu pierścienia okalającego, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 83

209. Pozycja 1. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF mankietu.
- Komisja Przetargowa informuje, że rezygnuje z pozycji nr 1, tym samym zostaje ona usunięta z Zadania nr 83.
210. Pozycja 2. Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w pakiecie 83, wydzieli pozycje: 2 i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.
- Komisja Przetargowa informuje, że wydzielono pozycję nr 2 i utworzono nowe Zadanie nr 100.

Zadanie nr 84

211. Poz. 1. Prosimy o dopuszczenie kocy o następujących parametrach:
- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
 - wykonane z miękkiej tkaniny
 - strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
 - unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
 - mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
 - odporne na płyny
 - brak zawartości lateksu
 - przezierny dla promieni RTG
 - uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych (system mocowania za pomocą wiązania)
 - Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
212. Poz. 1a. Prosimy o dopuszczenie koca na całe ciało pacjenta o wymiarach: 195 x 100 cm
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
213. Poz. 1b. Prosimy o dopuszczenie koca pediatrycznego / na dolną część ciała, o wymiarach: 120 x 100 cm
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania koc o wymiarach 120 x 100 cm.
214. Poz. 1c. Prosimy o dopuszczenie koca na górną część ciała, o wymiarach: 192 x 57 cm
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania koc o wymiarach 192 x 57 cm.
215. Poz. 1 d, e. Prosimy o dopuszczenie koca pod pacjenta o wymiarach: 217 x 91 cm
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania koc o wymiarach 217 x 91 cm.
216. Pozycja nr 1.A. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca o rozmiarze 215x100cm?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania koc o rozmiarze 215 x 100 cm.
217. Pozycja nr 1.B. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca o rozmiarze 160x80cm?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania koc o rozmiarze 160 x 80 cm.

218. *Pozycja nr 1.C. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca na górną część ciała o rozmiarze 195x64cm?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania koc o rozmiarze 195 x 64 cm.**
219. *Pozycja nr 1.D. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca o rozmiarze 215x100cm?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania koc o rozmiarze 215 x 100 cm.**
220. *Pozycja nr 1.E. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca pod całe ciało o rozmiarze 215x100cm?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania koc o rozmiarze 215 x 100 cm.**

Zadanie nr 88

221. *Pozycja 1 Czy zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu folia-papier?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
222. *Pozycja 1 Czy zamawiający dopuści aby kod kreskowy znajdował się na etykietach samoprzylepnych?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
223. *Pozycja 1 .B Czy zamawiający dopuści serwetę z laminatu o wymiarach 50x75 cm z otworem przylepnym 7cm lub 6x8 cm?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
224. *Pozycja 1 .F Czy zamawiający dopuści pęsetę w rozmiarze 14,5cm?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
225. *Pozycja 1 .G Czy zamawiający dopuści imadło metalowe w rozm. 15cm?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
226. *Pozycja 1 .H Czy zamawiający dopuści nożyczki w rozmiarze 11,5cm?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
227. *Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zakładania szwów o następującym składzie:*
- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
 - 1 x pęseta chirurgiczna metalowa, 12 cm
 - 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
 - 1 x igłotrzymacz, 12 cm
 - 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre, 11 cm
 - 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml (zapakowana)
 - 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
 - 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)
 - 1 x serweta włókninowa, 50 x 50 cm (barierowa)z przylepnym otworem 5 x 10 cm (celuloza i polietylen) gramatura 50 g/m²
 - 1 x serweta włókninowa nieprzylepna, 60 x 60 cm (barierowa) (celuloza i polietylen) gramatura 50 g/m²
- Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami. Na opakowaniu etykieta główna z wymaganymi informacjami oraz dwie samoprzylepne etykiety. Na jednej z nich wymagane informacje w formie kodu kreskowego.
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania zestaw o ww. parametrach.**

Zadanie nr 89

228. *Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści ręczniki pakowane a`1 szt?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania ręczniki pakowana a`1 szt.**

Zadanie nr 91

229. Poz. 3, 4. Prosimy o wydzielenie pozycji 3, 4 do osobnego zadania lub prosimy o odstąpienie od wymogu pierścienia okalającego, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
230. Poz. 3. Prosimy o podanie, czy chodzi o czujniki wielorazowe czy jednorazowe?
- Komisja Przetargowa informuje, że poz. 3 dotyczy czujników wielorazowych.

Zadanie nr 92

231. Poz. 4. Czy Zamawiający wymaga w poz. 4 igły motylkowej 0,8 mm z drenem 190 mm – 200 mm do posiewu, pakowanej indywidualnie, gotowej do użycia bez konieczności łączenia elementów?
- Komisja Przetargowa informuje, że wymaga w poz. 4 igły motylkowej 0,8 mm z drenem 190 mm – 200 mm do posiewu, pakowanej indywidualnie, gotowej do użycia bez konieczności łączenia elementów.
232. Poz. 4 i 5. Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe igieł motylkowych zawiera 120 szt., zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania. Uwzględnienie minimalnego opakowania handlowego, zapobiegnie ewentualnym nieporozumieniom podczas realizacji umowy.
- Komisja Przetargowa informuje, że zmieniono w poz. 4 ilość na 480 szt., natomiast w poz. 5 na 2.040.
233. Poz. 6, 7, 8, 9. Czy Zamawiający wymaga aby igły systemowe w poz. 6, 7, 8 i 9 były na stałe zespolone z holderem, pakowane indywidualnie, w blistry?
- Komisja Przetargowa informuje, że wymaga aby igły systemowe w poz. 6, 7, 8 i 9 były na stałe zespolone z holderem, pakowane indywidualnie w blistry.
234. Poz. 13. Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe nakłuwaczy zawiera 200 szt., zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania. Uwzględnienie minimalnego opakowania handlowego, zapobiegnie ewentualnym nieporozumieniom podczas realizacji umowy.
- Komisja Przetargowa informuje, że zmieniono w poz. 13 ilość na 55.600 szt.
235. Poz. 26. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w poz. 26 oczekuje zaoferowania strzykawko-probówek do OB. niewymagających pipet i kompatybilnych z aparatem w poz. 35?
- Komisja Przetargowa informuje, że zmieniono treść poz. 26 na następującą: „Strzykawko-probówka do OB. Kompatybilna z aparatem w poz. 35.
236. Poz. 29. Zważywszy na fakt, iż jednostką handlową widniejącą na fakturze jest zestaw (składający się z 1000 szt. kapilar, 2000 szt. zatyczek oraz 1000 mieszadełek), zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego i umożliwienie wyceny 1 zestawu, przy przeliczeniu szacunkowej ilości na 14 zestawów.
- Komisja Przetargowa informuje, że zmieniono jednostkę miary na „zestaw”, ilość na 14 zestawów oraz treść asortymentu na: „Zestaw do gazometrii kapilarnej PET, 100 ul, składający się z 1000 szt. kapilar, 2000 szt. zatyczek oraz 1000 mieszadełek.”
237. Dot. Ocena jakości Zadanie nr 92, SWIZ rozdz. XIII pkt 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że ocena jakości – „Pojemność strzykawko-probówek do hematologii o średnicy 11-12 mm” – dotyczy poz. 25 (tak jak jest to zapisane w załączniku nr 7 do SIWZ), a nie poz. 26, która zawiera strzykawko-probówki do OB.
- Komisja Przetargowa potwierdza, że ocena jakości – „Pojemność strzykawko-probówek do hematologii o średnicy 11-12 mm” – dotyczy poz. 25. Jednocześnie informujemy, że zmieniono przedmiotowe zapisy SIWZ.

Zadanie nr 95

238. *Dot. całego zadania Czy Zamawiający prawidłowo określił jednostkę miary? Czy jednostką miary nie powinny być opakowania? Np. w pozycji 4 Zamawiający zamierza zakupić 8 szt. szkiełek.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że w poz. 1-7 Zadania nr 95 zmieniono jednostkę miary ze szt. na op.**
239. *Dot. pozycji od 1 do 5 Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe pakowane po 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej przez Zamawiającego?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania szkiełka nakrywkowe pakowane po 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.**
240. *Dot. pozycji 6 i 7 Czy Zamawiający dopuści szkiełka o wymiarach 76 x 26 x 1 mm?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w poz. 6 i 7 szkiełka o wymiarach 76 x 26 x 1 mm.**
241. *Czy zamawiający nie popełnił omyłki w kolumnie „jednostka miary”? W kolumnie tej Zamawiający wpisał „szt.”, natomiast liczba sztuk szkiełek wpisana w kolumnie ilość w pozycji 2, 3, 4, 5 nie daje pełnych opakowań.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że w poz. 1-7 Zadania nr 95 zmieniono jednostkę miary ze szt. na op.**
242. *Poz 2. czy zamawiający dopuści szkiełka pakowane po 200 szt?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w poz. 2 szkiełka pakowane po 200 szt.**
243. *Poz 3. czy zamawiający dopuści szkiełka pakowane po 200szt?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w poz. 3 szkiełka pakowane po 200 szt.**
244. *Poz. 6. Czy zamawiający dopuści szkiełka podstawowe cięte?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
245. *Poz 7. Czy zamawiający dopuści szkiełka podstawowe cięte dwustronnie matowe?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 96

246. *Dot. poz. 5 i 6 Czy Zamawiający nie będzie wymagał, aby płyty do oznaczania grup krwi posiadały rowek usztywniający? Wprowadzenie tego wymogu oznaczałoby, że tylko firma Medlab-Products z siedzibą w Raszynie będzie mogła złożyć ofertę na zadanie 96. Wspomniany Wykonawca jest jedynym producentem płyt na polskim rynku z rowkiem usztywniającym, a jego praktyki w zakresie sprzedaży płyt do analizy grup krwi z rowkiem usztywniającym uniemożliwiają innym Wykonawcom oferowanie tego produktu.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że nie wymaga ale dopuszcza ww. rozwiązanie.**
247. *Poz. 5, 6 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt białych czy przezroczystych?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że wymaga płyt białych.**
248. *Poz. 7 – Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki z gwintem?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza pojemniki z gwintem.**
249. *Poz. 11 – Prosimy o podanie średnicy probówek do jakich ma pasować statyw?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że do średnicy 11-14 mm.**
250. *Dot. pozycji 5. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający rozumie przez to płyty serologiczne na 30 testów 5x6 celek?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że zmieniono treść poz. nr 5 na następującą: „Płyty do oznaczania grup krwi na 30 miejsc reakcyjnych (5x6 cel) z tworzywa sztucznego (PVC). Wymaga się płyt białych.”**
251. *Dot. pozycji 5. Czy Zamawiający wymaga płyt z tworzywa białego czy przezroczystego.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że wymaga płyt z tworzywa białego.**

252. Dotyczy pozycji 6. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający rozumie przez to płyty serologiczne na 30 testów 5x7 celek?
- Komisja Przetargowa informuje, że zmieniono treść poz. nr 6 na następującą: „Płyty do oznaczania grup krwi na 35 miejsc reakcyjnych (5x7 cel) z tworzywa sztucznego. Wymaga się płyt białych.”
253. Dotyczy pozycji 6. Czy Zamawiający wymaga płyt z tworzywa białego czy przezroczystego
- Komisja Przetargowa informuje, że wymaga płyt z tworzywa białego.
254. Dotyczy pozycji 7. Czy Zamawiający dopuści pojemniki z zakrętką z PE?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania pojemniki z zakrętką z PE.

Zadanie nr 97

255. (Poz. 1-4) Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy Ila czy dopuszcza niższą klasę I?
- Komisja Przetargowa informuje, że w poz. 1-4 wymaga aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy Ila.
256. (Poz. 1-6) Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający? Czy wymaga wyrobów sterylizowanych radiacyjnie (sterile - R) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?
- Komisja Przetargowa informuje, że dla poz. 1-6 wymaga wyrobów sterylizowanych radiacyjnie.
257. Czy Zamawiający w pakiecie 97, poz. 8 dopuści końcówki sterylne, pakowane w woreczkach po 5 sztuk?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
258. Dot. poz. 1 Czy Zamawiający nie będzie wymagał, aby wymazówki nie posiadające podłoża transportowego (wymazówki suche) były sklasyfikowane jako produkt klasy Ila i dopuści do zaoferowania wymazówki klasy I? Zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010r. O wyrobach medycznych (dalej Ustawa), Dyrektywą MDD 93/42/WEG UE oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (dalej Rozporządzenie), wymazówki w zależności od sposobu ich stosowania mogą być: wyrobami medycznymi inwazyjnymi (inwazyjny wyrób medyczny lub wyposażenie wyrobu medycznego, który jest wprowadzony lub które jest wprowadzane w całości lub w części do wnętrza ludzkiego ciała przez otwory ciała albo przez jego powierzchnię- art. 2 pkt. 15 Ustawy), jeśli pobierany jest materiał z otworów ciała lub jego wnętrza wyrobami nieinwazyjnymi (par. 1 ust. 9 Rozporządzenia) – jeśli służą do pobierania i przeniesienia materiału do badań bez kontaktu z ciałem ludzkim.
- Niezależnie od tego czy są wyrobami inwazyjnymi czy nieinwazyjnymi- wymazówki są wyrobami medycznymi chwilowego użytku, gdyż mają kontakt z ciałem krócej niż 60 min. (par. 2 ust. 1 Rozporządzenia). Zgodnie z Rozporządzeniem- jako wyrobu nieinwazyjnego – wymazówki z podłożem transportowym nie dotyczy reguła Ila (par. 4 ust. 2 ppkt. 2 lit. a). Tak więc zgodnie z Regułą 1 oraz Regułą 2 lit. b należy je zaliczyć do klasy I. Natomiast jeśli chodzi o wymazówki jako wyroby inwazyjne chwilowego użytku- to zgodnie z Regułą 5- również zaliczane są do klasy I. W związku z powyższym wielu wytwórców nie klasyfikuje wymazówek bez podłoża do klasy Ila, a tylko – zgodnie z Rozporządzeniem – do klasy I. Zarówno wymazówki klasy I, jak i wymazówki klasy Ila podlegają obowiązkowi certyfikowania przez Jednostkę Notyfikowaną, dlatego też klasa Ila nie wskazuje na to, że wymazówki te posiadają lepszą jakość niż wymazówki klasy I, zwłaszcza, że produkowane są w tych samych warunkach, z tych samych produktów, przez tych samych producentów.
- Niedopuszczenie wymazówek bez podłoża transportowego klasy I stanowi utrudnienie uczciwej konkurencji, poprzez uniemożliwienie złożenia ważnych ofert wielu wykonawców, którzy oferują wymazówki klasy Ila tylko z podłożem transportowym.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
259. Dot. poz. 5 i 6 Rozumiemy, że Zamawiający zgadza się na dowolny rodzaj spakowania ez po 10 lub 20 szt., pod warunkiem, że będą sterylne spakowane, niezależnie od tego czy opakowanie będzie posiadać strunowe zamknięcie, czy nie. Zamknięcia strunowe promowane przez niektórych

wykonawców na rynku są pozornie lepszym rozwiązaniem, gdyż wyrób sterylny otworzony traci swą sterylność raz na zawsze w momencie pierwszego otwarcia, niezależnie od tego czy jest potem zamykany strunowym zamknięciem czy też nie.


- Komisja Przetargowa informuje, że nie stawia wymogu w ww. zakresie.
260. Dot. poz. 8 Czy Zamawiający dopuści końcówki sterylne pakowane po 50 szt. w pudełku ze statywem, z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej przez Zamawiającego?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania końcówki sterylne pakowane po 50 szt. w pudełku ze statywem, z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez Zamawiającego.
261. Dot. poz. 10 Czy Zamawiający dopuści końcówki żółte niesterylne o pojemności 5-200 µl?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania końcówki żółte niesterylne o pojemności 5-200 µl.
262. Poz 12 Czy zamawiający dopuści pojemniki do moczu o wymiarach 25x80 mm? pozostałe parametry pozostają zgodne z SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania pojemniki do moczu o wymiarach 25 x 80 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
263. Poz 13 Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 25 ml z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania pojemniki o pojemności 25 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
264. Poz 16 Czy Zamawiający dopuści szalki o wysokości 15 mm z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów ?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
265. Poz. 8 – Czy Zamawiający zaakceptuje końcówki niesterylne pakowane po 50 sztuk, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
266. Poz. 8 – Czy Zamawiający zaakceptuje końcówki sterylne ale pakowane nie w statyw lecz w woreczkach po 5 sztuk, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
267. Dotyczy pozycji 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na końcówki sterylne, czyste molekularnie z filtrem?
- Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 7 końcówki sterylnej, czyste molekularnie z filtrem.
268. Dotyczy pozycji 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnej części?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
269. Dotyczy pozycji 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki 30 ml o wymiarach ok. Ø30x80 mm, pozostałe parametry bez zmian?
- Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 12 pojemnika 30 ml o wymiarach ok. Ø30x80 mm, pozostałe parametry bez zmian.
270. Dotyczy pozycji 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pełnego opakowania handlowego tj. 1000 sztuk probówek ?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 98

271. Pozycja 1: Prosimy o uściślenie czy w zadaniu nr 98 pozycja 1 Zamawiający wymaga tylko 180 sztuk opasek identyfikacyjnych dla dorosłych? Jeśli tak, to czy zamawiający dopuści wycenę dla 200 sztuk, ponieważ opaski identyfikacyjne pakowane są w najmniejsze opakowania zbiorcze po 100 sztuk?
- Komisja Przetargowa informuje, że zmieniono ilość wymaganych sztuk na 18.000. Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze po 100 sztuk.

272. *Pozycja 2: Prosimy o uściślenie czy w zadaniu nr 98 pozycja 2 Zamawiający wymaga tylko 150 szt. opasek identyfikacyjnych dla noworodków? Jeśli tak, to czy zamawiający dopuści wycenę dla 200 sztuk, ponieważ opaski identyfikacyjne pakowane są w najmniejsze opakowania zbiorcze po 100 szt.?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że zmieniono ilość wymaganych sztuk na 1.500. Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze po 100 szt.**
273. *Pozycja 5: Prosimy o uściślenie czy w zadaniu nr 98 pozycja 5 Zamawiający wymaga 2000 szt. kieliszków do leków? Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a'75 sztuk z przeliczeniem na 27 pełnych opakowań, co daje ilość 2 025 sztuk? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że zmieniono jednostkę miary ze szt. na op. Tym samym Zamawiający wymaga 2.000 opakowań po 75 szt. w opakowaniu.**
274. *Pozycja 11: Prosimy o uściślenie ile opakowań a'100 sztuk szpatulek sterylnych wymaga Zamawiający w zadaniu nr 98 pozycja 11?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że zmieniono jednostkę miary ze szt. na op. Zamawiający oczekuje 40 op. po 20 szt. w opakowaniu, lub 16 op. po 50 szt. w opakowaniu, lub 8 op. po 100 szt. w opakowaniu.**
275. *Pozycja 13: Czy Zamawiający w zadaniu 98, pozycja 13 dopuści basen plastikowy sanitarny: długość: 510 mm; szerokość: 299 mm; wysokość: 142 mm; pozostałe wymagania zgodne z SIWZ? Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym.
W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że z uwagi na pojemność posiadanych myjni podtrzymuje zapisy SWIZ.**
276. *Poz. 1-2. Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Patrz odpowiedź nr 271 i 272.**
277. *Poz. 2. Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm, pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, , długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaferowania w poz. 2 opaski identyfikacyjne o ww. parametrach.**
278. *Poz. 5. Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Patrz odpowiedź nr 273.**
279. *Poz. 8. Czy zamawiający dopuści pojemniki o wysokości 200-220 mm, pozostałe wymagania bez zmian?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaferowania pojemniki i wysokości 200-220 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**
280. *Poz. 11. Czy zamawiający oczekuje 40 sztuk szpatulek czy 40 opakowań po 100 szt szpatulek?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że oczekuje 40 op. po 20 szt. – patrz odpowiedź nr 274.**

281. Poz. 11. Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Patrz odpowiedź nr 274 i 280.
282. Poz. 12. Czy zamawiający dopuści miarki o długości min. 100 cm?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania miarki o długości min. 100 cm.
283. Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści opaski do identyfikacji noworodków z regulacją paska 12 oczek?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania opaski do identyfikacji noworodków z regulacją paska 12 oczek.
284. Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści stazy gumowe o średnicy 8mm i długości 400mm z rozciągliwością na poziomie 600%?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania stazy gumowe o średnicy 8 mm i długości 400 mm z rozciągliwością na poziomie 600%.
285. Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane po 90 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania kieliszki do leków pakowane po 90 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań.
286. Pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści basen sanitarny z pokrywką taki jak na dołączonym zdjęciu ?

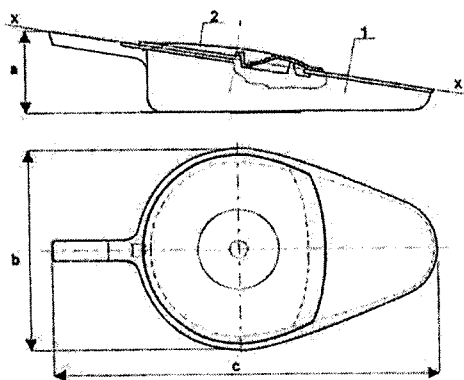

a= 142.0mm b= 299.mm c= 510.0mm
poz. 1 – zbiornik; poz. 2 - pokrywa

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. zapisów SIWZ

287. SIWZ – rozdział XII pkt. 3 lit. c) – sposób obliczenia ceny. Prosimy o zmianę sposobu obliczania wartości brutto. Według obecnych zapisów rozdziału XII pkt. 3 lit. c) SIWZ wartość brutto wyliczana jest z mnożenia ilości sztuk przez cenę jednostkową brutto. Zgodnie z par 106e ust. 1 pkt. 14 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z późn. zm.) faktura powinna zawierać kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Kwota VAT jest wówczas iloczynem wartości sprzedaży netto i stawki VAT (z uwzględnieniem podziału na poszczególne stawki). Tak więc podstawową ceną wyjściową do obliczania wartości brutto jest cena jednostkowa netto. Jeżeli Zamawiający będzie chciał wyliczyć cenę jednostkową netto z otrzymanej ceny jednostkowej brutto i porównać ją z otrzymaną ceną jednostkową netto na fakturze, to poprzez zaokrąglenia może dojść do rozbieżności między faktyczną ceną jednostkową netto proponowanego produktu, a tą wyliczoną z ceny jednostkowej brutto. Zmiana sposobu obliczania wartości brutto na: $\text{cena jednostkowa netto} \times \text{ilość} = \text{wartość netto} + \text{wartość podatku VAT}$ pozwoli uniknąć rozbieżności wynikających z matematycznej zasady zaokrąglania cyfr po przecinku.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

288. *Projekt umowy – par. 1 ust. 3. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 1 ust. 3. Art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) zakazuje jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związana, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 ustawy Pzp.*

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

289. *Dot. zapisów SIWZ rozdz. III pkt 8, Umowa § 2 ust. 8. Zamawiający zapisał w tych punktach iż wymaga terminu ważności na oferowane wyroby minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. Ponieważ nie wszystkie elementy systemu zamkniętego posiadają 12 m-czny termin ważności, a wynika to ze specyfiki odczynnika znajdującego się w probówko – strzykawce (dot. poz.12, 23, 31 w Zadaniu nr 92). Dlatego prosimy o możliwość dopuszczenia probówko-strzykawek, których termin ważności będzie wynosił minimum 6 miesięcy. Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych. Swoją argumentację pragniemy wzmocnić również faktem, że Zamawiający będzie zaspokajał swoje potrzeby na bieżąco (realizacja zamówień cząstkowych w terminie do 3 dni) bez zbędnego składowania produktów. W związku z tym prosimy o dopuszczenie strzykawko-probówek w Zadaniu nr 92 poz. 12, 23, 31 z 6-cio miesięcznym terminem ważności od daty dostarczenia do Zamawiającego.*

- **Komisja Przetargowa informuje, że zmieniono zapisy przedmiotowe zapisy na następujące: „Minimalny termin przydatności do użycia wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy od daty dostawy poza Zadaniem nr 92 poz. 12, 23, 31 dla których termin przydatności wynosi min. 6 miesięcy.”**

290. *Formularz ofertowy pkt 11. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu w pkt 11 Formularza ofertowego i dopuszczenie przesłania umowy przetargowej drogą pocztową lub elektroniczną (e-mail) na wskazany przez wybranego Wykonawcę adres. Prośbę swą pragniemy uzasadnić problemami logistycznymi, w przypadku Wykonawców oddalonych od miejscowości Zamawiającego.*

- **Komisja Przetargowa informuje, że usunięto z Formularza ofertowego treść pkt 11. Zgodnie z zapisami Rozdziału XIV ust. 2 SIWZ, umowa zostanie przesłana Wykonawcy listem poleconym.**

291. *Dot. Umowa § 7. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.*

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

292. *Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?*

- **Komisja Przetargowa informuje, że zgodnie z zapisami §1 ust. 5 terminy podane w umowie odnoszące się do dni roboczych, oznaczają każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.**

293. *Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza taką możliwość zgodnie z zapisami §4 ust. 5 Wzoru umowy.**
294. *Czy Zamawiający dopuści realizowanie dostaw do godz. 15.00 (par. 2 ust. 2 i 3)?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
295. *Czy Zamawiający zgadza się, aby przed rozwiązaniem umowy na mocy §9 Zamawiający uprzednio wezwał Wykonawcę do należytej realizacji umowy?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ. W przypadku wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym a tym samym skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy Pzp bezcelowym jest wzywianie Wykonawcy do należytej realizacji umowy.**
296. *Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Kupującego do należytego wykonywania umowy.”?*
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ. W przypadku wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym a tym samym skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy Pzp bezcelowym jest wzywianie Wykonawcy do należytej realizacji umowy.**
297. *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 8 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że zmieniono treść §3 ust. 8 na następujący: „W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od nieuregulowanych należności wyłącznie po upływie zaoferowanego terminu płatności przewidzianego umową.”**
298. *W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od otrzymania zawiadomienia na piśmie wraz z reklamowanym towarem” na „...od daty uznania reklamacji”.*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
299. *Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty jako połączenie dokumentów w jeden plik PDF podpisany podpisem elektronicznym?*
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza złożenie oferty jako połączenie dokumentów w jeden plik PDF podpisany podpisem elektronicznym.**
300. *Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. Wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwością zakupu jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).*
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie przypominamy, że podanie ceny w przypadku bardzo małej wartości jednostkowej opisuje ust. 4 Rozdziału XII SIWZ.**

301. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie przypominamy, że podanie ceny w przypadku bardzo małej wartości jednostkowej opisuje ust. 4 Rozdziału XII SIWZ.
302. Dotyczy § 2 Wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?
- Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
303. Dot. Umowa § 2 ust. 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie w § 2 ust. 3: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”. Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
304. Dotyczy § 2 ust. 8. Wzoru umowy. W związku z tym, iż zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy nie zasadne byłoby skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru do np. 9 m-cy?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
305. Dotyczy § 3 ust. 2 Wzoru umowy. Czy Zamawiający skróci termin płatności do 30 dni od daty wystawienia faktury?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
306. Dotyczy § 4 ust. 3 Wzoru umowy. Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.
- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze od chwili jej otrzymania,
 - dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru?
- Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 5 dni jest trudne do wykonania.
- W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.
- Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na ww. zapisy. Tym samym zmieniono treść zapisów §4 ust 3.
307. Dotyczy § 6 Wzoru umowy. Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:
- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
 - Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
 - Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

308. *Dotyczy § 8 ust. 2 pkt. 1a Wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania „Uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu”.*

- **Komisja Przetargowa informuje, że zmieniono zapisy §8 ust. 2 pkt 1a na następujące: zmiany ustawowej stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy; ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian, zmianie ulegnie cena brutto w zakresie wynikającym ze zmiany stawki VAT. Uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu,**

309. - *Dotyczy § 7 ust.1. Wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do „wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia” z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?*

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w placeniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 7300% wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

–*Dotyczy § 7 ust.2 Wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?*

–*Dotyczy § 7 ust.1 Wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej wartości zamówienia z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?*

–*Dot. § 7 ust 1 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. ustępu w następujący sposób:*

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- 1) *za zwłokę w wykonaniu zamówienia – opóźnienia dostawy – w wysokości 1% wartości netto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu określonego w §2 ust. 4, nie więcej jednak niż wartość dostawy;*
- 2) *za odmowę dostarczenia zamówionego asortymentu w wysokości 1% wartości netto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy i dodatkowego obciążenia Wykonawcy kosztami poniesionymi w związku z takim zakupem, w tym ceną produktu;*
- 3) *z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%*

–*Dotyczy §7 ust. 1 pkt 1 Wzoru umowy. Prosimy o modyfikację w/w ustępu na następujący: „za zwłokę w wykonaniu zamówienia – opóźnienia dostawy – w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu określonego w §2 ust. 4, nie więcej jednak niż wartość dostawy.”*

Obecnie zapisy określające wysokość kar umownych są niewspółmiernie wysokie i nie są w żadnym wypadku proporcjonalne do stopnia zawinienia strony. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego.

– § 7 Wzoru umowy. Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- 1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia – opóźnienia dostawy – w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu określonego w §2 ust. 4, nie więcej jednak niż wartość dostawy;
- 2) za odmowę dostarczenia zamówionego asortymentu w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy i dodatkowego obciążenia Wykonawcy kosztami poniesionymi w związku z takim zakupem, w tym ceną produktu;
- 3) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto zamówienia.

– Projekt umowy par. 7 ust. 1 pkt. 1. Prosimy o zmianę kary umownej na 2% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia [...]. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 7 ust. 1 pkt. 1) Projektu umowy stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

– Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna określona w par. 7 ust. 1 pkt 2) wynosiła 5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia ?

– Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. 1), 2):

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- 1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia – opóźnienia dostawy – w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu określonego w §2 ust. 4, nie więcej jednak niż wartość dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia;
- 2) za odmowę dostarczenia zamówionego asortymentu w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy i dodatkowego obciążenia Wykonawcy kosztami poniesionymi w związku z takim zakupem, w tym ceną produktu.

– Ad par. 7 ust. 1.1. wzoru umowy. Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,5% wartości nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki w dostawie, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

– Wzór umowy – Załącznik nr 3. § 7 ust. 1, pkt. 1 i 2 – wnosimy o obniżenie zapisanych w umowie kar umownych. Wykonawca nie kwestionuje prawa zastrzeżenia przez zamawiającego kary umownej, jednakże jej wysokość musi pozostawać w prawidłowej proporcji do wysokości potencjalnej szkody jaką może on ponieść. Wobec powyższego wnosimy o zmianę zapisów umowy § 7 ust. 1 pkt. 1 i 2 na następujące:

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- 1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia – opóźnienia dostawy – w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu określonego w §2 ust. 4;
- 2) za odmowę dostarczenia zamówionego asortymentu w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do

dokonania zakupu u innego dostawcy i dodatkowego obciążenia Wykonawcy kosztami poniesionymi w związku z takim zakupem, w tym ceną produktu;

– Projekt umowy par. 7 ust. 1 pkt. 2. Prosimy o zmianę kary umownej na 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia oraz o zmianę zapisu dot. obciążenia Wykonawcy kosztami zakupu u innego dostawcy na obciążenie Wykonawcy kwotą stanowiącą różnicę między ceną jaką zapłaciłby u Wykonawcy a ceną jaką zapłacił u innego dostawcy. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 7 ust. 1 pkt. 2) Projektu umowy oraz całkowitymi kosztami zakupu u innego dostawcy stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) „Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surrogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

- Komisja Przetargowa informuje, że zmieniono treść §7 Wzoru umowy na następujący:

§ 7

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- 1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia – w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu określonego w §2 ust. 4, nie więcej jednak niż wartość dostawy;
 - 2) za odmowę dostarczenia zamówionego asortymentu w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy i dodatkowego obciążenia Wykonawcy kosztami poniesionymi w związku z takim zakupem, w tym ceną produktu;
 - 3) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody.

Pozostałe zapisy bez zmian.

310. - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

– SIWZ – rozdział V pkt. 1 – grupa kapitałowa. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku

postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”.

- Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?
- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?
- Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza złożenie Oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych: „Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Zadanie nr 42

311. Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane elektrody, kaniule do EtCO₂, czujniki SpO₂ oraz papier były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodne z CE defibrylatora, instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obsługi defibrylatora. Używanie nieoryginalnego papieru może powodować szybsze zużywanie się elementów termoczułych drukarek defibrylatorów LIFEPAK.
- Komisja Przetargowa informuje, że Zamawiający wymaga by zaoferowane elektrody, kaniule do EtCO₂, czujniki SpO₂ oraz papier były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodne z CE defibrylatora, instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta

Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian w SIWZ oraz Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4 do SIWZ.

Z poważaniem

Sekretarz Komisji Przetargowej

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych

Leszek Kaiser