

**KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY**
ul. Seminaryjna 1,
85-326 Bydgoszcz

Bydgoszcz, 07.06.2024 r.
Postępowanie nr **21 Z TP 24**

E.ZP.261.16.2024

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę szpitalnych wyrobów papierowych i flizelinowych.**

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Pakiet 2 Lp. 1.

Czy Zamawiający dopuści podkłady 60 x 60 cm o wymiarach wkładu chłonnego 52x52 cm, czyli o polu powierzchni większej niż wymagana?

Pozostałe wymogi spełnione.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania podkładu o proponowanym opisie.

Pytanie 2

Pakiet 2 Lp. 2.

Czy Zamawiający dopuści podkłady 60 x 90 cm o wymiarach wkładu chłonnego 83x52 cm, czyli o polu powierzchni większej niż wymagana?

Pozostałe wymogi spełnione.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania podkładu o proponowanym opisie.

Pytanie 3

Pakiet 2 Lp. 1. Czy Zamawiający dopuści podkłady 60 x 90 cm o wymiarach wkładu chłonnego 83x52 cm, czyli o polu powierzchni większej niż wymagana?

Pozostałe wymogi spełnione.


Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania podkładu o proponowanym opisie.

Pytanie 4

dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu równoważnego, z oddzielnie dostarczanymi kieszeniami:

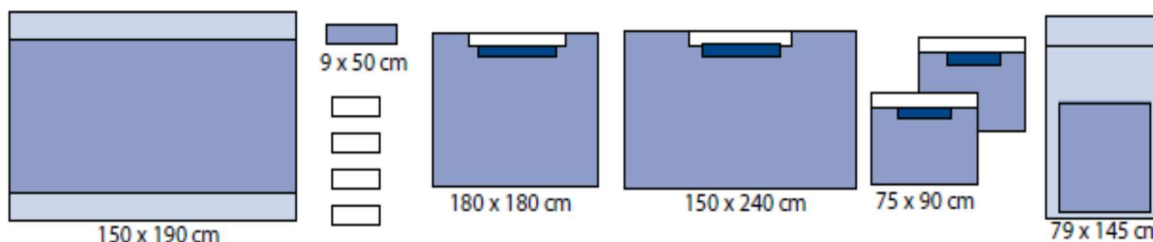

- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
 - 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66 x 85 cm, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki
 - 4 ręczniki celulozowe do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
 - 2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów
 - 1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów
 - 1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów
 - 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- jałowy zestaw serwet uniwersalnych jednorazowego użytku
- serwety główne na całej powierzchni wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE + PP (nieprzemakalna folia polietylenowa 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m² z dodatkowym padem chłonnym 55g/m² (łącznie gramatura 110g/m²)
- osłona na stolik Mayo wykonana z nieprzemakalnej, piaskowanej folii PE o grubości 60µm z dodatkowym wzmocnieniem z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 55g/m² (łącznie gramatura 115g/m²)
- serweta na stół do instrumentarium wykonana z nieprzemakalnej folii PE o grubości 50µm z dodatkowym wzmocnieniem włókninowym o łącznej gramaturze 80g/m²
- opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z 4 etykietami zawierającymi numer REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod QR; opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem, zewnętrzny karton transportowy
- wyrób medyczny klasy I sterylnej zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania opisanego produktu.

Pytanie 5

dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczników 30,5x34cm pakowanych a'1szt z przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu o podanym opisie.

Pytanie 6

Pakiet 2, poz. 1

Czy w miejsce opisanego podkładu Zamawiający dopuści podkład o poniższym opisie?

Podkład chłonny w rozmiarze 60 x 60 cm z wkładem chłonny 49 cm x 56 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 4,7 g, dwóch warstw celulozy 9,04 g, pulpy celulozowej 31,3 g, niebieskiej folii PE 8 g. Opakowanie 25 szt. Chłonność: 995 ml. Zdjęcie poglądowe poniżej.



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania podkładu o proponowanym opisie.

Pytanie 7

Pakiet 2, poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania podkładów w opakowaniu max 60 szt.

Pytanie 8

Pakiet 2, poz. 2

Czy w miejsce opisanego podkładu Zamawiający dopuści podkład o poniższym opisie?

Podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonny 55 cm x 78 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g. Opakowanie 25 szt. Chłonność: 1326 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania podkładu o proponowanym opisie.

Pytanie 9

Pakiet 4

Czy w miejsce opisanego podkładu Zamawiający dopuści podkład o poniższym opisie?

Podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm $\pm 2,5$ cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ± 5 g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania podkładu o proponowanym opisie.

Pytanie 10

Pakiet 6, poz. 2

Czy w miejsce opisanego podkładu Zamawiający dopuści podkład o poniższym opisie?

Podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g. Opakowanie 25 szt. Chłonność: 1326 ml

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Pakiet 6 ma 1 pozycję. Zamawiający w odpowiedzi odnosi się do Pakietu 6 poz. 1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania podkładu o proponowanym opisie.

Pytanie 11

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm, paskiem samoprzylepnym 5cm x 95cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190

+ 2 kieszenie 1-komorowe 30x40cm pakowane osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania opisanego produktu.

Pytanie 12

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylizowany radiacyjnie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania zestawu sterylizowanego radiacyjnie. Zamawiający wymaga sterylizacji tlenkiem etylenu.

Pytanie 13

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 136 g/m² ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaferowania produktu o powyższych parametrach.

Pytanie 14

Pakiet 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaferowania serwety w rozmiarze 90x120cm.

Pytanie 15

Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści jałowy ręcznik wykonany z włókniny typu spunlance 40x40cm, pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie produktu o podanym opisie.

Pytanie 16

Dotyczy pakiet 4

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty:

Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego 3 warstwowego laminatu. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/- 2 cm) x 228 cm (+/- 2 cm). Warstwa chłonna o wymiarach - długość 190 cm (+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm). Wchłanianość co najmniej 5600 g/m² potwierdzona badaniami laboratorium.

Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzone nazwą produktu lub wytwórcy).

Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485 potwierdzone certyfikatem. Opakowanie 42 szt.

Okres przydatności do użycia: 5 lat Wyrób medyczny kl.I. Producent ECOLAB.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania podkładu o proponowanym opisie.

Pytanie 17

Pakiet 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie:

Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, niepylna, nieuczulająca, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Wszystkie krawędzie uszczelnione.

Parametry:

- chłonność min 10L (potwierdzona badaniami wykonanymi w niezależnym laboratorium),
- gramatura podstawowa: 115 g/m² (+/- 10%),
- wymiary: 101 x 225cm (+/-5cm), rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu
- podkład przebadany wg normy ISO 9073-6

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania podkładu o proponowanym opisie.

Pytanie 18

Pakiet 7

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw obłożeń o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 cm x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 cm x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 cm x 240 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 cm x 175 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 cm x 33 cm

Zestaw obłożeń chirurgicznych, z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa).

Gramatura laminatu podstawowego min. 49 g/m². Materiał obłożenia zgodny z z normą wysokiej PN EN 13795 .

Zestaw powinien posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr kat, LOT, datę ważności i dane producenta.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki, taśma mocująca w serwetach o szerokości min 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego. Na opakowaniu zestawu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

Serwety z oznaczeniem kierunku rozkładania (w postaci piktogramów). Zestaw jałowy, jednorazowego użytku (sterylizacja tlenkiem etylenu), pakowany do transportu w karton.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaferowania opisanego produktu.

Pytanie 19

Pakiet 8

Pozycje 1-3 – czy_Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety operacyjnej o gramaturze włókniny łącznie z folią min. 49 g/m² – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaferowania serwety operacyjnej o gramaturze włókniny łącznie z folią min. 49 g/m².

Pytanie 20

Pakiet nr 10

Pozycja 1 – czy_Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestaw do zamykania małych ran o składzie:

1 x serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy 75 x 75 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta dwuwarstwowa 60 x 50 cm, otwór przylepny \varnothing 7 cm centralnie

1 x Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm

1 x Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm

1 x Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm

1 x skalpel jednorazowy Nr 10

5 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 17 nitek

1 x kleszyczki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 14 cm, niebieskie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie zestawu o opisanym składzie, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 21

Pakiet nr 10

Pozycja 1 – Czy Zamawiający oczekuje asortymentu spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga spełnienia wymagań dotyczących wyrobu zgodnie z wymogami zawartymi m.in. pkt. 4 w SWZ.

Pytanie 22

pakiet 3, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 23

pakiet 3, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 24

pakiet 3, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 25

pakiet 3, poz. 1

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza innych długości rolek, niż wskazana w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-3 do SWZ). W konsekwencji Zamawiający nie dopuszcza możliwości przeliczenia ceny za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 26

pakiet 3, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-3 do SWZ), wymaga zaferowania podkładów medycznych w rolce 60 cm x 80 m (+/- 5%), perforacja co 30 cm do max 50 cm. W związku z tym rolka 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm spełnia wymóg Zamawiającego.

Pytanie 27

pakiet 3, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 28

pakiet 3, poz. 2

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza innych długości rolek niż wskazana w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-3 do SWZ). W konsekwencji Zamawiający nie dopuszcza możliwości przeliczenia ceny za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 29

Pakiet 3, poz. 1-2

czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. = 1 rolkę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że 1 szt. = 1 rolka.

Pytanie 30

Pakiet 3, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści rolki bez etykiety na opakowaniu indywidualnym, natomiast dopuści etykiety na opakowaniu zbiorczym, w formie kartonu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie. Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-3 do SWZ) wymaga aby każda rolka była pakowana indywidualnie z naklejoną etykietą.

Pytanie 31

Pakiet 5 – Serwety wielorazowe:

Czy Zamawiający dopuści serwety z Pakietu 5 do stosowania w strefach niekrytycznych, posiadające właściwości barierowe przez 100 cykli prania z dopuszczeniem procesu impregnacji w przypadku utraty barierowości przed upływem 100 cykli użycia? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Tkaniny bawełniano-poliestrowe aby były nieprzemakalne potrzebują impregnacji. W przypadku utraty barierowości należy dodać środków impregnujących w procesie prania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania serwet o właściwościach opisanych w pytaniu.

Pytanie 32

Pakiet 5 – Serwety wielorazowe:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację Formularza cenowego dla Pakietu 5 tak, aby nie zawierał kolumn: „Wielkość opakowania (...)”, „Zaoferowana ilość opakowań” oraz „Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak.”.

Przedmiotem zamówienia w Pakiecie 5 jest 100 sztuk serwet wielorazowych. Zapisy o opakowaniach dotyczą asortymentu jednorazowego. Serwety wielorazowe nie są sprzedawane na opakowania i nie są w ten sposób wyceniane

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy znajdujące się w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (zał. 1-5 do SWZ) oraz SWZ. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że jeżeli serwety pakowane są pojedynczo to 1 opakowanie = 1 szt.

Pytanie 33

Pakiet 5 – Serwety wielorazowe:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację oceny jakościowej dla Pakietu 5 w ten sposób, by najwyżej oceniany termin dostawy wynosił 12 dni roboczych, a najniżej 8 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie 34

Pakiet 5 – Serwety wielorazowe:

Czy Zamawiający, mając na uwadze możliwość zweryfikowania zaoferowanego asortymentu, wymaga załączenia wraz z ofertą do Pakietu nr 5 karty technicznej tkaniny wystawionej przez jej producenta oraz raportu z badań, potwierdzającego zgodność z wymaganą normą PN-EN 13795?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga załączenia wraz z ofertą do Pakietu nr 5 karty technicznej wskazanej w pytaniu. Zamawiający zwraca uwagę, że wymagane przedmiotowe środki dowodowe zostały wskazane w pkt. 10 SWZ.

Pytanie 35

Pakiet 1

Prosimy o dopuszczenie złożenia oferty bez pozycji numer 4.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty bez pozycji numer 4.

Pytanie 36

Pakiet 7

Prosimy o dopuszczenie :

Gramatura laminatu podstawowego min. 56 g/m².

- 1 taśmę samoprzylepną 10 cm x 50 cm,

- 1 serwetę na stolik Mayo 80 cm x 1 50

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania opisanego powyżej przedmiotu zamówienia.

Pytanie 37

Zadanie 7 - Zestaw obłożeń chirurgicznych:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego zestawu uniwersalnego, o poniższej charakterystyce?:

Zestaw uniwersalny wzmocniony:

1 x serweta na stolik instrumentarium, wymiary 190 x 150 cm, chłonne wzmocnienie na całej długości o szerokości 66 cm, masa powierzchniowa min. 84 g/m² (+/- 10%), chłonność min. 400%

1 x pokrowiec na stolik Mayo 145 x 80 cm, warstwa chłonna o gramaturze min. 82 g/m² (+/- 2 g/m²), wymiary 85 x 76 cm (+ / - 2 cm)

1 x samoprzylepna serweta operacyjna 150x 240cm (wzmocnienie 37,5 x 70 cm)

1 x samoprzylepna serweta operacyjna 200x 170cm (wzmocnienie 37,5 x 70 cm)

2 x samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90cm (wzmocnienie 37,5 x 70 cm)

1 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

2 x ręczniki z włókniny kompresowej min. 40 g/m², chłonności min. 800% - 20 x 40 cm

Obłożenie wykonane z laminatu włókniny i folii o gramaturze 62 g/m², w obszarze krytycznym wzmocnione włókninowymi łętami chłonnymi o gramaturze 60 g/m². Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 125 g/m² (łącznie z warstwą kleju zespalającego łętę chłonną z laminatem podstawowym). Barrierowość dla wody min. 150 cm H₂O w obszarze krytycznym, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 170 kPa w obszarze krytycznym, nasiąkliwość metodą run off w obszarze krytycznym min. 66 % (wg PN - EN ISO 9073-11). Laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia (wg PN - EN ISO 10993 - 10) i nie jest cytotoksyczny (wg PN - EN ISO 10993 - 5).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania opisanego produktu.

Pytanie 38

Dot. treści proj. umowy:

W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złagodzenie kar umownych w § 8 ust. 1 na proponowane:

„W przypadku zwłoki w terminach dostaw podanych w umowie z winy Wykonawcy i niezgodnionych z Zamawiającym lub ich zaprzestania z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny brutto każdej części opóźnionej lub niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki, za wyjątkiem sytuacji, w której Zamawiający skorzysta z uprawnień określonych w § 4 ust. 15 umowy. Kary będą naliczane do czasu realizacji prawidłowej dostawy lub wymiany towaru lub do czasu nabycia zastępczego.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w projekcie umowy.

Pytanie 39

Pakiet 7

Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm

z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm

Obłożenie o gramaturze laminatu podstawowego min. 57, 4 g/m² oraz całkowitej gramaturze laminatu podstawowego i łąty chłonnej min. 109 g/m². Serwety posiadają pasek samoprzylepny pokryty klejem zapewniającym pewne i bezpieczne mocowanie serwety podczas zabiegu zakładając właściwą aplikację serwety. Dwie kieszenie o wymiarach 38 cm x 40 cm pakowane osobno.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaferowania opisanego produktu.

Pytanie 40

Pakiet 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 110 cm x 90 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety o wymiarach 110cm x 90cm, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

Pytanie 41

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści Prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa.

Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej. Wymiary 101 x 225 cm +/- 2 cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 42

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści Prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna gładka o jednorodnej powierzchni niepowodujący uszkodzeń skóry pacjenta, absorpcyjna warstwa środkowa.

Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej. Wymiary 101 x 225 cm +/- 2 cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 43

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści karton 20 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (zał. 1-4 do SWZ), czyli opakowania zawierającego max. 10 sztuk.

Pytanie 44

Pakiet 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 100 x 120 cm z taśmą przylepną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety w rozmiarze 100cmx120cm z taśmą przylepną, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

Pytanie 45

dot. części 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wzmocnionego wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² (łączna gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m²), odporność na przeniknięcie cieczy (zg. z EN 20811) – min. 240 cm H₂O . Zestaw zgodny z normą EN 13795-1:2019

Skład :

- 1 serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 140x190cm - owinięcie zestawu
- 1 czerwona osłona na stół Mayo wzmocniona 80x145cm
- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm wzmocniona na powierzchni 50x75cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 175x200cm wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm wzmocnione na powierzchni min. 45x60cm
- 1 taśma samoprzylepna 9x50cm, wykonana z włókniny typu spunlace
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

Taśma mocująca w serwetach pokryta klejem nie repositionalnym, szerokość min 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zewnętrzne opakowanie oznakowane znakiem CE, zawierające rysunek produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania opisanego produktu.

Pytanie 46

dot. części 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wzmocnionego wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² (łączna gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m²), odporność na przeniknięcie cieczy (zg. z EN 20811) – min. 240 cm H₂O . Zestaw zgodny z normą EN 13795-1:2019

Skład :

- 1 serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 140x190cm – owinięcie zestawu,
- 1 x czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, wzmocniona
- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm wzmocniona na powierzchni 50x75cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 175x200cm wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm wzmocnione na powierzchni min. 45x60cm
- 1 taśma samoprzylepna 9x50cm, wykonana z włókniny typu spunlace
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
- 1 x kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,

Taśma mocująca w serwetach pokryta klejem nie repozycjonowalnym, szerokość min 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zewnętrzne opakowanie oznakowane znakiem CE, zawierające rysunek produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaferowania opisanego produktu.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.