



# Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna dn. 20.05.2019

Do wszystkich  
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **poniżej 221.000 euro** którego przedmiotem jest **Dostawa aparatury medycznej**. Numer ogłoszenia w 545830-N-2019; data zamieszczenia: **10.05.2019 r. Znak sprawy – PN 25/2019**

Do Działu Handlowego wpłynęły złożone przez uczestników (Wykonawców) w/w postępowania n/w pytania z prośbą o wyjaśnienie, zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:

### **Pytanie nr 1 - Pytanie do postępowania - dot. Pakiet 1 wózek do transportu chorych.**

1. Czy zamawiający dopuści do zaferowania wózek do transportu chorych o wymiarach zewnętrznych 2100mm x 850mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

2. Czy zamawiający dopuści do zaferowania wózek do transportu chorych i wymiarach 1900mm x 630mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

3. Czy zamawiający dopuści do zaferowania wózek do transportu chorych z możliwością regulacji wysokości w zakresie 620mm-925mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

4. Czy zamawiający dopuści do zaferowania leże 4 segmentowe?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

5. Czy zamawiający dopuści do zaferowania barierek boczne składające się z 5 szczebli pionowych?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

6. Czy zamawiający dopuści do zaferowania wózek bez zdejmowanych barierok bocznych?

W załączniku przesyłam zdjęcie wózka.tarczenia

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

### **Pytanie 2 - Dotyczy: Pakiet 1 – Wózek do transportu chorych – 4 szt.**

1.Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary zewnętrzne 2100 x 810 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

2.Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający leże o wymiarach 1960 x 655 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

3.Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający regulację segmentu pleców wspomaganą sprężyną gazową w zakresie 0° - 75°?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

4.Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materac nie posiadający „wysuwanych obustronnie wkładek transportowych, wysuwanych z materaca, niwelujących przestrzeń pomiędzy wózkiem, a np. łóżkiem w czasie przekładania pacjenta”?

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

5.Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierek boczne metalowe zabezpieczające pacjenta na ok. 80% długości leża, składane wzdłuż ramy leża, barierek składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi elementami?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

6.Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony od strony szczytu głowy w składane uchwyty służące do transportu wózka, a od strony szczytu nóg w chromowany uchwyt w kształcie pałaka ułatwiający prowadzenie wózka?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

**Pytanie 3 - Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet 1 Wózek do transportu chorych - 4 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości wózki transportowe o wymiarach zewnętrznych 2130 mm x 830 mm i wymiarach leża: 1910 x 650 mm, oraz regulacji wysokości 560 mm – 880 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości wózki transportowe o regulacji segmentu pleców do 90°, co jest parametrem lepszym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości wózki transportowe z możliwością wykorzystania jako łóżko pobytowe do 24 godzin ze standardowym materacem o grubości 8 cm bez wkładek transportowych?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości wózki transportowe z barierkami bocznymi metalowymi w pełni zabezpieczającymi pacjenta, składanymi wzdłuż ramy leża, składającymi się z trzech poziomych szczebli bez tworzywowych nakładek? Poniżej znajduje się fotografia oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**



5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości wózki transportowe z uchwytami transportowymi od strony głowy i nóg, które nie są wysuwane spod leża jak na zdjęciu powyżej? Jest to rozwiązanie również korzystne dla operatorów wózków,

funkcjonalne i ergonomiczne, z doświadczenia Wykonawcy wynika, że docenianie przez użytkowników wózków. Dopuszczenie innego rozwiązania niż opisane w SIWZ pozwoli na udział w postępowaniu większej grupie Wykonawców.

**Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4 do pakietu nr 1 zał. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o wymiarach

• zewnętrznych: 800x2120 mm

• wewnętrznych: 750x1950 mm

dla lepszego komfortu pacjenta, nasz wózek jest dodatkowo wyposażony w regulację podudzia zakres 0-40° ?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu piątego koła, ponieważ nasza technologia ma

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża. Barierki składające się z pięciu pionowych szczebli?

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony od strony głowy i nóg uchwyty, służące do transportu wózka?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5 - Pakiet nr 1. Wózek do przewożenia chorych – 4 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o wymiarach zewnętrznych

2130 x 800 mm, co bardzo nieznacznie odbiega od wymogów z opisu przedmiotu zamówienia – zał. Nr 1 do SIWZ (zwany dalej: OPZ)?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z nożną, hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie od 565 mm? Dolny zakres jest parametrem korzystniejszym niż wymagany w OPZ – jest bardziej zbliżony do standardowej wysokości łóżek szpitalnych.

**Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją Trendelenburga 17° i anty-Trendelenburga 16°?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-90°, co jest parametrem szerszym, korzystniejszym niż wymagany w OPZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający zechce odstąpić od wymogu materaca z wysuwanymi obustronnie wkładami transportowymi, na rzecz materaca wzmocnionego z uchwytami stałymi do przenoszenia pacjenta? Rozwiązanie wydaje się równoważne.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z centralną i kierunkową blokadą kół realizowaną dwiema dźwigniami umieszczonymi przy podwoziu od strony głowy i nóg pacjenta?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z barierkami bocznymi metalowymi, składanymi wzdłuż ramy leża, zabezpieczającymi pacjenta na długości 64% leża, składające się z pięciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w szczyty w postaci:

- od strony nóg pacjenta – uchwyty stałe do przetaczania wózka;

- od strony głowy pacjenta - uchwyty do przetaczania wózka składane pod ramę leża?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6 - Pakiet nr 5 Dwuczaszowa sufitowa lampa operacyjna – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną dwuczaszową z panelami sterowania na kopułach funkcjami min.:

Endo / Natężenie Światła / Temperatura Barwowa / Włączanie (bez funkcji regulacji wielkości oświetlonego pola)? Natomiast

regulacja wielkości oświetlanego pola odbywa się za pomocą uchwyty sterylne w centralnej części kopuły.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną dwuczaszową z możliwością elektronicznej 12-stopniowej regulacji natężenia światła obu czasz w zakresie 25% do 100% ?

**Odpowiedź: Tak**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną dwuczaszową bez funkcji dotykowego sterowania natężeniem światła za pomocą centralnego uchwyty sterylne (poprzez przesunięcie kciuka) niezależnie od regulacji średnicy pola operacyjnego? Natomiast zmiana średnicy pola odbywa się poprzez przyciśnięcie kciukiem na przycisk uchwyty sterylne i przekręcenie uchwyty.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną dwuczaszową z kopułami o budowie wielosegmentowej, ukształtowanej aerodynamicznie, minimalizującej zakłócenia w przepływie laminarnym?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną dwuczaszową o grubości czasz ok. 11 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza..**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną dwuczaszową, z możliwością zamontowania kamer w każdej z czasz centralnie w centralnym uchwycie sterylnym lampy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z obudową kopuły wykonanej ze stopów aluminium i tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7 - Pakiet nr 6 Stół operacyjny - 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z napędem mieszanym, tj. elektro-hydraulicznym, elektro-mechanicznym i mechanicznym w zależności od wybranej regulacji?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny o długości całkowitej 2142 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny o długości całkowitej 2190 mm?

**Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie od 600 do 1060 mm (plus materac)? Pragniemy zauważyć, że dolny oferowany zakres regulacji jest znacznie korzystniejszy niż wymagany w OPZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie od 575 do 1075 mm (plus materac)? Pragniemy zauważyć, że dolny oferowany zakres regulacji jest znacznie korzystniejszy niż wymagany w OPZ.

**Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z regulacją podglówka w zakresie  $-53^{\circ}$  /  $53^{\circ}$ ?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z przechyłami bocznymi w zakresie  $\pm 27^{\circ}$ ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z przechyłami bocznymi w zakresie  $\pm 25^{\circ}$ ?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z przechyłami wzdłużnymi w zakresie  $\pm 35^{\circ}$ ?

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z przechyłami wzdłużnymi w zakresie  $\pm 30^{\circ}$ ?

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z elektro-mechaniczną regulacją kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej do  $+90^{\circ}$ , co jest parametrem znacznie lepszym niż wymagany w OPZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją kąta podnóżków w płaszczyźnie pionowej do  $+50^{\circ}$ , co jest parametrem znacznie lepszym niż wymagany w OPZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym 350 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym zamiast klasycznego wypiętrzenia klatki piersiowej zastosowano system dzielenia segmentu pleców na płytę dolną i górną, przemienności blatów i możliwość takiego ustawiania ich kątów i konfiguracji, aby uzyskać wymagane wypiętrzenie klatki piersiowej lub łędźwi? Rozwiązanie wydaje się być równoważne do wymaganego w OPZ.

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem bezprzewodowym?

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści pilot bez funkcji regulacji dwustopniowej?

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z pilotem bez wyświetlacza LCD?

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym pilot przyłączany jest do gniazda w kolumnie wyłącznie od strony głowy pacjenta i panelu sterującego?

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie stołu z podstawą inną niż kształt litery „T”?

Wymóg zaoferowania podstawy w kształcie litery „T” nie ma uzasadnienie praktycznego ani ergonomicznego, jest tylko jednym z rozwiązań oferowanych przez producentów. Funkcjonalność i ergonomia podstawy polegają na jej stabilności i możliwości podejścia chirurga możliwie blisko kolumny / blatu stołu. Producenci oferują różne rozwiązania w tym zakresie (np. kształt litery X, H czy Y albo prostokąt), dlatego prosimy o możliwość zaoferowania innego rozwiązania niż opisany w SIWZ, przy zachowaniu pozostałych wymogów, tj. dobry dostęp chirurga do blatu stołu i wysoka stabilność.

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny mobilny z elektro-mechanicznym systemem blokowania podstawy do podłoża, co jest rozwiązaniem bardzo pewnym i skutecznym.

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z manualną regulacją podgłówką opartą o wygodny i bezpieczny mechanizm zapadkowy?

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o modułowej konstrukcji blatu, w którym płyta plecowa dzielona jest w proporcji ok. 1:1, w którym zamiast klasycznego wypiętrzenia klatki piersiowej zastosowano system dzielenia segmentu pleców na płytę dolną i górną, przemienności blatów i możliwość takiego ustawiania ich kątów i konfiguracji, aby uzyskać wymagane wypiętrzenie klatki piersiowej lub łędźwi?

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**


**Wyposażenie stołu:**

- czy Zamawiający oczekuje oparcia bocznego takiego lub podobnego jak na fotografii? Jeśli nie, to z uwagi na mnogość rozwiązań prosimy Zamawiającego o zaprezentowanie rysunku pogładowego lub zdjęcia pogładowego oczekiwanego wyposażenia.



**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

- czy Zamawiający oczekuje oparcia bocznego takiego lub podobnego jak na fotografii? Jeśli nie, to z uwagi na mnogość rozwiązań prosimy Zamawiającego o zaprezentowanie rysunku pogładowego lub zdjęcia pogładowego oczekiwanego wyposażenia.

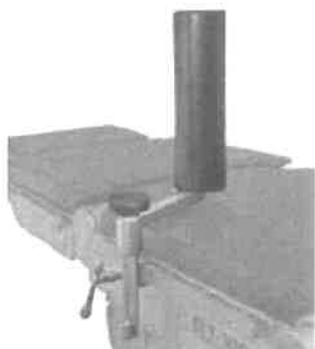

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

- Z uwagi na mnogość rozwiązań prosimy Zamawiającego o zaprezentowanie rysunku poglądowego lub zdjęcia poglądowego oczekiwanego pozycjonera głowy i szyi.

**Pytanie 8 - Pakiet 4 – Kardiomonitor 2 szt. Pkt. 2**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z ciągłym zapisem wybranej krzywej oraz wszystkich parametrów cyfrowych przez okres 48 godzin z możliwością przeniesienia danych cyfrowych na Pendrive oraz odczytu na PC użytkownika? Ponadto pragniemy zauważyć, iż przegląd tak obszernego pliku danych 72 godzin wszystkich krzywych na ekranie kardiomonitora przy pomocy dotyku będzie zadaniem bardzo czasochłonnym co z pewnością nie będzie miało przychylności personelu medycznego. Do tego celu służą stanowiska centralnego monitorowania obsługiwane przy pomocy klawiatury i myszki komputerowej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 9 Pakiet nr 5 – dwuczaszowa sufitowa lampa operacyjna (załącznik nr 1 - opis parametrów):**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie lampy z możliwością dotykowego natężenia sterowania światła za pomocą centralnego uchwyty sterylnego (poprzez ruch uchwytem w lewo lub w prawo)? – dotyczy l.p. 15

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie lampy o średnicy pola roboczego regulowanego w zakresie 220-340mm? – dotyczy l.p. 16, 17

**Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie lampy z możliwością zamontowania kamery w uchwycie sterylnym (wystaje poza obrys kamery). Jest to rozwiązanie bardzo często spotykane w lampach operacyjnych oferowanych na rynku. – dotyczy l.p. 24

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie i zamontowanie lampy w terminie do 42 dni, jak w przypadku kilku innych pakietów opisanych w SIWZ? Oferowany termin pozwoli na udział w niniejszym postępowaniu większej liczbie podmiotów, co jest korzystne dla Zamawiającego.

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 10 - Pakiet nr 6 – stół operacyjny (załącznik nr 1 – opis parametrów):**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w listwy bez ograniczników zabezpieczających korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem? Wyposażenie dedykowane do oferowanego stołu operacyjnego nie jest wsuwane na listwę, może być założone i zdjęte w dowolnym miejscu na listwie w związku z tym ograniczniki zabezpieczające są niepotrzebne – dotyczy l.p. 2

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie stołu bez systemu antykolizyjnego? Konstrukcja oferowanego stołu pozwala na bezpieczne użytkowanie stołu bez konieczności posiadania tego typu rozwiązania – dotyczy l.p. 2

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie stołu o długości 2100mm? Proponowany parametr różni się minimalnie od wymaganego, co nie ma wpływu na walory kliniczne stołu – dotyczy l.p. 4

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie stołu z regulacją oparcia pleców w zakresie -35/+75 stopni? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego, co pozostaje bez wpływu na użytkowanie stołu i jego funkcjonalność – dotyczy l.p. 7

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją nachylenia podglówka w zakresie +45/-45 stopni? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego, co pozostaje bez wpływu na użytkowanie stołu i jego funkcjonalność – dotyczy l.p. 8

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją nachylenia segmentu nóg w zakresie +20/-90stopni? Proponowany parametr różni się minimalnie od wymaganego, co nie ma wpływu na walory kliniczne stołu – dotyczy l.p. 12

**Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza**

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z przesuwem wzdłużnym 420 mm, regulowanym elektrohydraulicznie? – dotyczy l.p. 13

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie pilota bez podświetlenia i wyświetlacza LCD, wyposażonego w czytelne piktogramy przedstawiające poszczególne funkcje stołu. Po włączeniu pilota – diody sygnalizują stan naładowania. Poza wyżej wymienionymi alternatywnymi i równie funkcjonalnymi rozwiązaniami, pilot spełnia wszystkie pozostałe zapisy punktu 15.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z obciążeniem statycznym 320 kg? Oferowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego w SIWZ, co pozostaje bez wpływu na walory kliniczne stołu. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że praktyczny obszar zastosowań pojedynczego stołu operacyjnego - nawet w przypadku zastosowania poszerzeń bariatrycznych - kończy się na poziomie około 300 kg. Przy masie większej, problemem staje się objętość pacjenta wykluczająca możliwość bezpiecznego prowadzenia zabiegów na powierzchni pojedynczego stołu operacyjnego – w takim wypadku stosuje się dwa stoły ustawione jeden obok drugiego. Dodatkowo zwracamy uwagę, że w oferowanym stole obciążenie dynamiczne jest na poziomie 275 kg, co jest parametrem korzystniejszym niż minimalny zakres dopuszczony w SIWZ – dotyczy l.p. 25

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 11 - Dot. zał. nr 1 do SIWZ, pakiet 6 stół operacyjny**

Do pkt. 2 opisu

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z oparciem pleców z wydzielonym w oparciu wypiętrzeniem pozwalającym uzyskać wypiętrzenie lędźwiowe oraz klatki piersiowej w zależności od ułożenia pacjenta?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Do pkt. 2 opisu

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w korpusy mocujące z blokadami zabezpieczającymi przed ich wypadnięciem z listw akcesoryjnych?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Do pkt. 4 opisu

Czy Zamawiający dopuści stół o długości blatu o 12 mm większym od dopuszczonego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Do pkt. 6 opisu

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości, który w dolnym położeniu jest o 20 mm niżej od położenia wymaganego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Do pkt. 8 opisu

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podglówka -90° do + 90°?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Do pkt. 9 opisu

Czy zamawiający dopuści stół z regulacją przechyłów bocznych po 20° na stronę?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Do pkt. 10 opisu

Czy zamawiający dopuści stół z przechylem Trendelenburga 30°?

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Do pkt. 11 opisu

Czy zamawiający dopuści stół z przechylem anty-Trendelenburga 30°?

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Do pkt. 13 i 22 opisu

Czy Zamawiający dopuści stół z przesuwem wzdłużnym 310 mm, zapewniający uzyskanie przestrzeni pomiędzy krawędzią blatu

stołu a kolumną 1377 mm?

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**


Do pkt. 14 i 22 opisu

Czy Zamawiający dopuści stół z wypiętrzeniem regulowanym dźwignią ręczną? Takie rozwiązanie zapewnia wycucie nacisku na pacjenta, zabezpiecza przed przypadkowym spowodowaniem obrażeń. Regulacja wypiętrzenia za pomocą pilota może skutkować przekroczeniem progu elastyczności pacjenta.

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Do pkt. 15 opisu

Czy Zamawiający dopuści stół z pilotem z podświetlanymi klawiszami, nie wyposażonym w wyświetlacz lcd, skonfigurowany jak na poniższym zdjęciu?



**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Do pkt. 18 opisu

Czy zamawiający dopuści stół z najstabilniejszą podstawą w kształcie graniastosłupa prostokątnego o wys. 12 cm i konstrukcji zapewniającej swobodny dostęp operatora do pola operacyjnego?

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Do pkt. 20 opisu

Czy Zamawiający dopuści stół z podgłówkiem oraz segmentami nóg blokowanymi w każdej pozycji dzięki mechanizmu zapadkowego bez sprężyn gazowych?

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Do pkt. 23 opisu

Czy Zamawiający dopuści stół z materacami wykonanymi z pianki termoaktywnej zapewniającej rzeczywiste właściwości przeciwdrobnoustrojowe, a dzięki tzw. pamięci kształtu zapewniający stabilne ułożenie pacjenta bez możliwości przesunięcia lub zsunięcia się pacjenta z materaca?

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 12 SIWZ**

1. Rozdział IV. – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia dla pakietu 1 do max. 56 dni (8 tygodni) od daty podpisania umowy z Zamawiającym.

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

2. Rozdział IV. – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia dla pakietu 6 do max. 56 dni (8 tygodni) od daty podpisania umowy z Zamawiającym.

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 13 - Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy**

1. §2 pkt 1 – W związku z tym, że przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu medycznego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o skorygowanie stawki VAT wskazanej w ww. punkcie wzoru umowy, tj. nie 23% a stawka VAT obowiązująca dla sprzętu medycznego wynosząca 8%.

**Odpowiedź; Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 3 do SIWZ tj. wzoru umowy (SIWZ po modyfikacji dostępna na stronie [https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings.](https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings))**

2. §2 pkt 4 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu obligującego nas jako Wykonawcę do wystawienia i przesłania faktury w formie elektronicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający ma obowiązek udostępnić taką możliwość Wykonawcy, natomiast Wykonawca nie jest zobligowany do wystawiania faktury w formie elektronicznej. Prosimy o



akceptację tradycyjnej formy wystawienia faktury VAT z tytułu wykonania Umowy.

**Odpowiedź:** Zgoda, zmienia się § 2 pkt 4 umowy i nadaje się brzmienie:

4. Z tytułu wykonania Umowy, Wykonawca może wystawiać i przysyłać faktury w formie elektronicznej.

**Pytanie 14 -Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie**

1. Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie zapisów oświadczenia - zgodnie ze wskazaniem dot. podstaw do wykluczenia zawartymi w rozdziale IX punkty 4-6 Wykonawca ma potwierdzić niepodleganie wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, prosimy więc, aby wszystkie te punkty zawarte zostały w oświadczeniu będącym załącznikiem nr 4 do SIWZ (tj. nowy zapis powinien otrzymać brzmienie: „*oraz nie podlegamy wykluczeniu z w/w postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4*”).

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 4 do SIWZ (SIWZ po modyfikacji dostępny na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>)

**Pytanie 15 - Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet 1 Wózek do transportu chorych – 4 szt.**

1. Pkt 1 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych o wymiarach zewnętrznych 2100 x 800 mm? Wymiary te nieznacznie różnią się od wymogu Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Pkt 2 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych o wymiarach leża 1925 x 725 mm? Wymiary te nieznacznie różnią się od wymogu Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ.

3. Pkt 3 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z regulacją wysokości nożną hydrauliczną w zakresie 560 – 890 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

4. Pkt 4 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z regulacją przechyłów wzdłużnych nożną hydrauliczną w zakresie +/- 15°? Jest to zakres lepszy od wymaganego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

5. Pkt 11 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych bez listew odbojowych na bokach wózka? Zarówno wózek jak i ściany chronione są przed zniszczeniem w wystarczającym stopniu przez krążki odbojowe zlokalizowane w czterech narożnikach leża.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ.

6. Pkt 12 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z tworzywową obudową podstawy z wyprofilowanym miejscem na butlę z tlenem oraz z metalowym koszem pod leżem wózka od strony nóg na osobiste rzeczy pacjenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

7. Pkt 13 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z materacem nie posiadającym funkcji wysuwanych obustronnie wkładek transportowych?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ.

8. Pkt 14 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z barierkami bocznymi metalowymi zabezpieczającymi leże na ¾ długości, składanymi wzdłuż ramy leża, składającymi się z trzech poziomych kształtowników o przekroju koła połączonych pionowymi elementami z obu końców?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ.

9. Pkt 15 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych wyposażony od strony głowy i nóg w metalowe szczyty zamontowane na stałe w gniazdach leża, służące jednocześnie do transportu wózka? Montaż szczytów na stałe w leżu gwarantuje ich stabilność i trwałość, szczególnie podczas używania ich jako uchwyty do przetaczania wózka. Jeśli Zamawiający dopuści, prosimy o usunięcie wymogu z wykazu wyposażenia wózka w punkcie 16.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 16 - Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet 6 Stół operacyjny – 1 szt.**

1. Pkt 26 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wyposażenie w postaci pozycjonera głowy i szyi rozmiar L o wymiarach 273 mm x 230 mm x 126 mm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

2. Pkt 30 – Prosimy Zamawiającego o skorygowanie w naszej opinii oczywistej omyłki w minimalnym wymaganym okresie gwarancji dla przedmiotu dostawy, tj. wg zapisów SIWZ Rozdział XI punkt ad. 2 minimalnym okresem jaki musi zaoferować Wykonawca są 24 miesiące, a nie 36 jak Zamawiający wymaga w punkcie 30 tabeli Załącznika nr 1.

**Odpowiedź:** Minimalny okres rękojmi wynosi 24 miesiące.

**Pytanie 17 - Pakiet 6 Stół operacyjny 1 szt**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny o długości całkowitej 2000 mm

z możliwością wydłużenia o 60 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny bez systemu antykolizyjnego opisanego w pkt. 3 parametrów wymaganych (zał. 1 do SIWZ)?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z listwami bez ograniczników na ich końcach, zabezpieczających korpusy mocujące przed ich wypadnięciem?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie od 530 do 1010 mm (plus materac 6 cm)? Pragniemy zauważyć, że dolny oferowany zakres regulacji jest znacznie korzystniejszy niż wymagany w opisie parametrów wymaganych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od -30° do 80°?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z regulacją podglówka w zakresie -90° / 60°?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z przechyłami bocznymi w zakresie +/- 24°?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym 360 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z wypiętrzeniem klatki piersiowej realizowanym mechanicznie, za pomocą korby?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością podłączenia pilota z jednej tylko strony stołu – na kolumnie z boku stołu

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z dopuszczalnym obciążeniem statycznym i dynamicznym 273 kg?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem bez wyświetlacza LCD, z klawiszami membranowymi podświetlanymi (z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji), sterującym min. następującymi funkcjami:

dioda LED informująca o zasilaniu z sieci	Przesuw w stronę nóg
diody LED obrazujące poziom naładowania baterii	Przesuw w stronę głowy
Anty-Trendelenburg	Flex
Trendelenburg	Reflex
Prawy przechył boczny	Uruchomienie centralnej blokady
Lewy przechył boczny	podstawy stołu
Unoszenie segmentu pleców	Odblokowywanie centralnej blokady
Opuszczanie segmentu pleców	Poziomowanie blatu „0”
Unoszenie blatu	Włącznik on/off (włącz/wyłącz)
Opuszczanie blatu	Zmiana orientacji blatu

Oferowany pilot nie posiada funkcji dwustopniowego zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji, a następnie wybór kierunku regulacji).

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

#### **Pytanie 18**

##### **1. Dot. projektu umowy par. 2 ust. 1**

Czy w przypadku gdy przedmiotem przetargu jest wyrób medyczny (pakiet 2 i 3) Zamawiający dokona zmiany w umowie stawki VAT na 8% (zgodnie z ofertą wykonawcy)?

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy (SIWZ po modyfikacji dostępny na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>)**

**2. Dot. projektu umowy par. 5 ust. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu na:

Trzykrotna naprawa gwarancyjna tego samego elementu lub podzespołu w przedmiocie umowy powoduje konieczność jego wymiany na nowy.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy (SIWZ po modyfikacji dostępny na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>)**

**Pytanie 19 - Dotyczy : zapisów SIWZ**

Czy z uwagi na fakt, że oryginalne katalogi lub foldery producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia dystrybutora, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i trudno oczekiwać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 20 -Dot. załącznik nr1 – Pakiet nr 4 Kardiomonitor – 2 szt.**

1. Czy spełni wymagania Zamawiającego monitor bez pomiaru rzutu minutowego serca metodą nieinwazyjną?

**Odpowiedź; Zgodnie z zapisami SIWZ.**

2. Czy spełni wymagania Zamawiającego bez zapamiętywania wszystkich krzywych dynamicznych z 72 godzin?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza pamięć wszystkich krzywych dynamicznych z 48 godzin.**

3. Czy zostanie dopuszczony fabrycznie nowy monitor wyprodukowany w 2017 roku?

**Odpowiedź: Rok produkcji min. 2018**

**Pytanie 21- Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet 5 Dwuczaszowa sufitowa lampa operacyjna - 1 szt.**

Ad. pkt 27

W związku dwuznacznym wymogiem dotyczącym minimalnego okresu rękojmi (pkt 27 pakietu 5 oraz zapisy SIWZ) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby oferent zaoferował minimum 24 miesiące rękojmi czy 36 miesięcy?

**Odpowiedź; Minimalny okres rękojmi 24 miesiące.**

**Pytanie 22 - Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy**

§ 2 WYNAGRODZENIE

„Na dzień zawarcia umowy stawka podatku VAT wynosi 23 %, to jest wynagrodzenie brutto wynosi zł ..... (słownie: .....)”

Ze względu na oferowany asortyment objęty 8% stawką podatku VAT zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisu umowy na:

„Na dzień zawarcia umowy stawka podatku VAT wynosi .....%, to jest wynagrodzenie brutto wynosi zł ..... (słownie: .....)”

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy (SIWZ po modyfikacji dostępny na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>)**

**Pytanie 23 - Dot. pakietu nr 3 KOLONOSKOP**

pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści głębię ostrości min. 3-100 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści min. 4 programowalne przyciski w tym 3 na głowicy endoskopu oraz 1 na panelu przednim procesora?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższym przyciski muszą być dowolnie programowalne.**

pkt.10

Czy Zamawiający dopuści aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających zabezpieczających aparat przed korozją?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści 1 złącze elektryczne i jeden konektor?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że będzie jednogniazdowy.**

pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie własnego procesora obrazu HDTV kompatybilnego z kolonoskopem z pakietu 3 oraz z

gastroskopem z pakietu 2?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

**Pytanie 24 - PAKIET 2 - Gastroskop**

pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści głębię ostrości min. 3-100 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści min. 4 programowalne przyciski w tym 3 na głowicy endoskopu oraz 1 na panelu przednim procesora?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

pkt.12

Czy Zamawiający dopuści aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających zabezpieczających aparat przed korozją?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści 1 złącze elektryczne i jeden konektor?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zabezpieczeniem przed przypadkowym zalaniem.**

pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści gastroskop z możliwością splukiwania pola obserwacji?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zastosowania kanału irygacyjnego.**

  
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI  
MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI  
„STOCER” Sp. z o.o.  
Piotr Papaj

Otrzymują:

-adresat

-a/a.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Wróblewska

Tel. (22) 711 90 48

Fax (22) 711 90 37,

e-mail: [inwestycje@stocer.pl](mailto:inwestycje@stocer.pl)