

Milicz, dnia 02.06.2020 r.

Numer postępowania: **MCM/WSM/ZP8/2020**

WYKONAWCY
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI UDZIELONYCH ODPOWIEDZI NA PYTANIA
WYKONAWCÓW.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Zamawiający zawiadamia, że zmienia odpowiedź na pytanie Nr 32,33,34,65,134,187 z dnia 28.05.2020 r., o treści:

PYTANIE NR 32: Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1-11:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki Foley mają być wyposażone w plastikową zastawkę, która lepiej dopasowuje się i przylega do końca strzykawki oraz lepiej zabezpiecza przed przypadkowym opróżnieniem balonu?

Treść odpowiedzi zamawiającego:

jest: *Tak, Zamawiający wyraża zgodę.*

Winno być:

Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

PYTANIE NR 33: Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1-11:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na zakończeniu kanału ze sztywną zastawką w Cewniku Foley ma się znajdować logo marki, informacja o materiale z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika oraz pojemność balonu?

Treść odpowiedzi zamawiającego:

jest: *Tak, Zamawiający wyraża zgodę.*

Winno być:

Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

PYTANIE NR 34: Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1-11:


Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki foley mają być pakowane w opakowanie jednostkowe papier folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego opakowania, i dwa pionowo przy obu końcach opakowania?

Treść odpowiedzi zamawiającego:

jest: *Tak, Zamawiający wyraża zgodę.*

Winno być:

Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

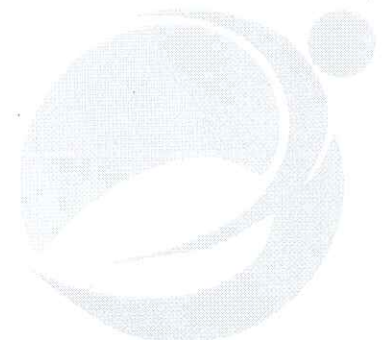

PYTANIE NR 65: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 23-26:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki urologiczne Pezzer - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać minimum 4 otwory przelewowe w odcinku dystalnym, które zapewniają skuteczny drenaż na poziomie zakładanym przez producenta.

Treść odpowiedzi zamawiającego:

jest: *Tak, Zamawiający potwierdza.*

Winno być:

Tak, Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

PYTANIE NR 134: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 14:

Pakiet 1 poz.14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu do przetoczeń krwi z drenem 150cm.

Treść odpowiedzi zamawiającego:

jest: *Tak, Zamawiający dopuści.*

Winno być:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 187: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 17:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu, powinny analogicznie do przyrządów do przetoczeń płynów z poz. 16 posiadać cyt. „logo lub nazwę producenta” oraz nazwę własną na przyrządzie.

Treść odpowiedzi zamawiającego:

jest: *Tak, Zamawiający potwierdza.*

Winno być:

Tak, Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 10.06.2020r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.

PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Andrzej Oćwieja

