

DZ.271.114. 1052 .2019

Kraków, dnia 07 .11.2019 r.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, iż wpłynęły pytania do postępowania nr **DZ.271.114.2019 dostawa wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych i naczyniowych.**

**Pytanie 1**

**Dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §4 ust. 1 do 0,5% wartości zamówionej części dostawy, której zwłoka dotyczy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 2**

**Dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §4 ust. 2 do 0,5% wartości wadliwego towaru?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 3**

**Dotyczy pakietu nr 19 pozycja 4**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pakietu 19 pozycji 4 (Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą), w celu złożenia atrakcyjnej oferty cenowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 4**

**Dotyczy pakietu nr 19 pozycja 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powszechnie stosowanego, wysokiej jakości, przetwornika do krwawego pomiaru ciśnienia, o długości 152 cm, linie ciśnieniowe grubościennne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, (linie kodowane kolorystycznie w celu łatwej identyfikacji). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 5**

**Dotyczy pakietu nr 19 pozycja 4**

Czy Zamawiający wymaga, żeby przetwornik wyposażony był w dodatkowe koreczki w kolorze kontrastowo żółtym, dla zapobiegania przypadkowej kontaminacji w wyniku pomyłki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 6**

**Dotyczy pakietu nr 19 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 19 pozycji numer 1 tj. inflator. W chwili obecnej zamawiający stworzył bardzo duży pakiet, z akcesoriami które w stanie są dostarczyć nieliczne firmy. Spowodować to może znaczący wzrost ceny za poszczególne produkty. Zamawiający z pozycji numer 1 planuje zamówić 6000 sztuk inflatorów co jest bardzo dużą ilością, a wydzielenie tej pozycji pozwoli na uzyskanie optymalnej ceny. Pozostawienie pakietu w obecnej formie narazi szpital na niepotrzebne wydatki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 7**

**Dotyczy pakietu nr 31 pozycja 3**

Czy w Pakiecie nr 31 poz. 3 Zamawiający dopuści stentgraft z możliwością zamiany (w razie potrzeby) na stentgraft obwodowy montowany na balonie o średnicach 5-16 mm i długościach 15-79 mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8**

**Dotyczy pakietu nr 31 pozycja 4**

Czy w Pakiecie Nr 31 poz. 4 Zamawiający dopuści stentgrafty bez dostępnych proksymalnych i dystalnych złączających się elementów (pozostałe parametry bez zmian) ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9**

**Dotyczy pakietu nr 31 pozycja 4**

Czy w Pakiecie Nr 31 poz. 4 Zamawiający dopuści stentgrafty o dostępnych średnicach od 21 do 45 mm (pozostałe parametry bez zmian) ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10**

**Dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 Pakiet 2 elektrody do czasowej stymulacji serca o średnicy 5F i 6F spełniające wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11**

**Dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 Pakiet 2 elektrody do czasowej stymulacji serca z balonikiem o średnicy 5F spełniające wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 12**

**Dotyczy pakietu nr 44**

Czy w pakiecie nr 44 w pkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia „Prowadnik do PTA 0,014" - 0,018" z końcówką hydrofilną" (Załącznik nr 4) Zamawiający dopuści produkt posiadający wyłącznie średnicę 0,018"?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 13**

**Dotyczy pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 1 cewnika kalibrującego ze znacznikami o długości 100 cm?

Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania umożliwi nam wzięcie udziału w w/w postępowaniu i zaoferowanie Zamawiającemu sprzętu najnowszej generacji i o najwyższej jakości z powodzeniem stosowanego w wielu wiodących ośrodkach na terenie Europy

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 14**

**Dotyczy pakietu nr 40**

Czy Zamawiający dopuści stenty rozprężane na balonie kompatybilne z koszulkami 6F dla wszystkich możliwych średnic, o długości stentu min. 18-58 mm przy dostępnych długościach szafu min. 80 i 140 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 15**

**Dotyczy wzoru umowy**

Prosimy o doprecyzowanie załącznika nr 3 do SIWZ, wzór umowy nr 2 poprzez dodanie § 3 ust. 2a o następującej treści: „Wyrób medyczny, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z miejsca przechowania przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w miejscu przechowania więcej niż jeden wyrób medyczny danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności produkt z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 16**

**Dotyczy wzoru umowy**

Prosimy o doprecyzowanie załącznika nr 3 do SIWZ, wzór umowy nr 2 poprzez dodanie § 3 ust. 2b o następującej treści: „Zamawiający zobowiązany jest dokonać cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli terminu ważności wyrobów medycznych pozostających u Zamawiającego w przechowaniu.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 17**

**Dotyczy pakietu nr 44**

Czy w pakiecie 44 w pkt 5 Zamawiający dopuści przewodnik o średnicy 0,014” z końcówkami o długościach 8 i 11 cm i spełniający wymagania we wszystkich pozostałych punktach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 18**

**Dotyczy pakietu nr 2**

Czy w punkcie 2 - Elektroda do czasowej stymulacji serca z balonikiem - zamawiający dopuszcza zaferowanie elektrod o średnicy 5F?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 19**

**Dotyczy wzoru umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2, 3:

1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. W razie sprzedaży wadliwego wyrobu medycznego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji. W razie niezrealizowania przez Wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, w ramach którego sprzedano wadliwy wyrób medyczny, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwy wyrób medyczny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w razie realizacji poszczególnych zamówień nieterminowo, dostarczania wyrobu medycznego po upływie terminu jego

ważności lub powtarzających się reklamacji ilościowo-jakościowych, i naliczenia tytułem odszkodowania kary w wysokości 10% ceny brutto niezrealizowanej części umowy, określonej w § 2 ust. 3.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 20**

**Dotyczy pakietu nr 19 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 19 inflatora (strzykawkę ciśnieniową z manometrem) do osobnego pakietu bądź możliwość złożenia ofert na poszczególne pozycje osobno. Wyodrębnienie ww. asortymentu pozwoli Zamawiającemu na pozyskanie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert, niż w przypadku zablokowania całego zamówienia dla Wykonawcy, który w swojej ofercie ma całość asortymentu i może tym samym dyktować wyższe ceny.


**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 21**

**Dotyczy pakietu nr 19 pozycja 1**

Czy Zamawiający w pakiecie 19 dopuści inflator (strzykawkę wysokociśnieniową) o poniższych parametrach: - objętość 20 ml, - zakres generowanego ciśnienia do 30 atm, - podwójny system pomiaru ciśnienia (atm, psi), - fluorescencyjna tarcza manometru zawierająca informację o ciśnieniu ujemnym, - ergonomiczny kształt (wg rys. poniżej) przystosowany do obsługi jednoręcznej - polikarbonatowa obudowa umożliwiająca kilkukrotne wykonanie precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji, - wysokociśnieniowy dren zbrojony zakończony „męskim” adapterem rotacyjnym, - w zestawie trójdrożny kranik wysokociśnieniowy, w którym dłuższe ramię obrotowej zastawki wskazuje pozycję „ON”?

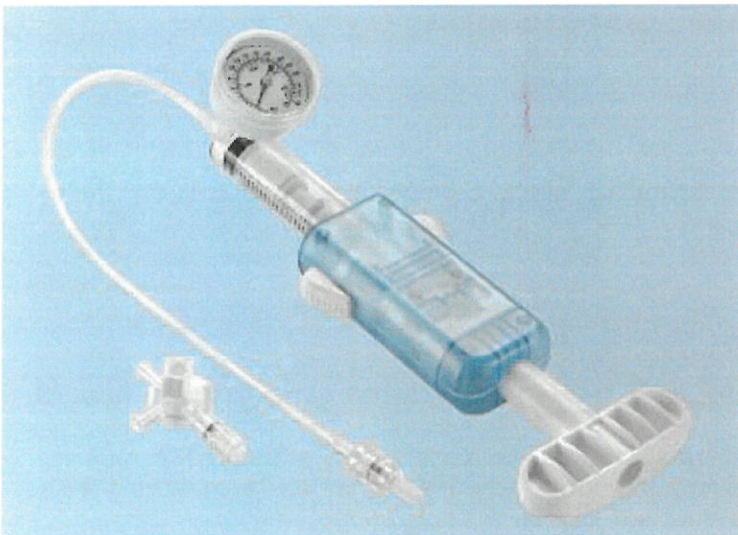

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 22**

**Dotyczy pakietu nr 19 pozycja 1**

Czy Zamawiający w pakiecie 19 (inflator) zredukuje ilość wymaganych próbek do 2 szt. wyrobu po jednej dla każdego ocenianego parametru?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Z-ca KIEROWNIKA**  
Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej  
z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

*Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zmudka*  
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog  
8197366      tek. 12 614 35 06

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II  
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków  
Centrala: tel. 12 614 20 00, faks 12 614 22 66  
www.szpitaljp2.krakow.pl  
e-mail: sekreatriat@szpitaljp2.krakow.pl

Z poważaniem

*Dr hab. n. med. Dorota Sobowótka*  
Krakowski Szpital Specjalistyczny  
im. Jana Pawła II  
INSTYTUCJA DYPLOMATY  
ul. Lecznictwa



Szpital posiada:  
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001;  
Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem wg normy ISO 14001;  
Certyfikat spełnienia standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego nr 2016/30.