

Kraków, 16.11.2023 r.

**DZ.271.96.1123.2023**

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 34 84

e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

**dotyczy: postępowania DZ.271.96.2023 – Zakup i dostawa części serwisowych do aparatury urządzeń medycznych**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

**PYTANIE 1:**

poz. 9, 10, 11, 12 pkt. 7 prosimy o odstąpienie od wymogu podawania wymiarów wtyczki, w przypadku zapewnienia kompatybilności z kardiomonitorem oraz pomiędzy kablem głównym a odprowadzeniami.

**ODPOWIEDŹ:**

**Nie, Zamawiający poz. 9, 10, 11, 12 pkt 7 pozostawia bez zmian.**

**PYTANIE 2:**

poz. 9, 10, 11, 12 pkt. 6 prosimy o odstąpienie od wymogu podawania średnicy kabla, w przypadku zapewnienia kompatybilności z kardiomonitorem oraz ekranowania

**ODPOWIEDŹ:**

**Nie, Zamawiający poz. 9, 10, 11, 12 pkt 6 pozostawia bez zmian.**

**PYTANIE 3:**

poz. 12 pkt. 5 i 6 prosimy o dopuszczenie odprowadzeń o długości 1m

**ODPOWIEDŹ:**

**Nie, Zamawiający poz. 12 pkt 5, 6 pozostawia bez zmian.**

**PYTANIE 4:**

poz. 19 pkt 5. prosimy o dopuszczenie mankietów dedykowanych dla obwodu kończyny 25-35 cm, w przypadku spełniania pozostałych parametrów

**ODPOWIEDŹ:**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

PYTANIE 5:

poz. 20 pkt. 5 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m.

**ODPOWIEDŹ:**

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

PYTANIE 6:

poz. 33 prosimy o wydzielenie poz. 33 "Moduł pomiarowy SpO2 w technologii Masimo do kardiomonitora Philips IntelliVue" do oddzielnego zadania - informujemy, że produkt ten jest oferowany tylko przez jednego wykonawcę.

**ODPOWIEDŹ:**

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

PYTANIE 7:

Prosimy Zamawiającego z uwagi na niejednorodny charakter produktów o dopuszczenie składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w pakiecie.

**ODPOWIEDŹ:**

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

PYTANIE 8:

Prosimy o wydzielenie z pakietu pozycji 6, 8, 22, 23, 31 do osobnego pakietu. Umożliwi to nam i innym dostawcom złożenie oferty w atrakcyjnej cenie.

**ODPOWIEDŹ:**

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

PYTANIE 9:

Dotyczy załącznika nr 3, pakiet 6, pkt. 6

Czy zamawiający dopuści pas piersiowy dla dzieci o wymiarach 32 x 1500 mm?

**ODPOWIEDŹ:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

PYTANIE 9:

Dotyczy załącznika nr 3, pakiet 14, pkt. 5

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny dla dorosłych o wymiarach 25-35 cm (obwód ramienia)?

**ODPOWIEDŹ:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE 10:**

Dotyczy załącznika nr 3, pakiet 15, pkt. 5

Czy zamawiający dopuści kabel długości 2,5 m, pozostałe parametry bez zmian?

**ODPOWIEDŹ:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 11:**

Dotyczy załącznika nr 3, pakiet 17, pkt. 5

Czy zamawiający dopuści kabel długości 2,5 m, pozostałe parametry bez zmian?

**ODPOWIEDŹ:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 12:**

Dotyczy załącznika nr 3, pakiet 19, pkt. 5

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny dla dorosłych o wymiarach 25-35 cm (obwód ramienia)?

**ODPOWIEDŹ:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE 13:**

Dotyczy załącznika nr 3, pakiet 22, pkt. 5

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny dla dorosłych o wymiarach 25-35 cm (obwód ramienia)?

**ODPOWIEDŹ:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE 13:**


Dotyczy załącznika nr 3, pakiet 23, pkt. 5

Czy zamawiający ma na myśli kabel zespolony (jednoczęściowy od monitora do pacjenta)?


Czy kabel ma wtyk po stronie monitora 10 czy 12 pinowy (zdjęcia poniżej)?

## **Wtyczka 10 pin**

### **STRONA MONITORA**

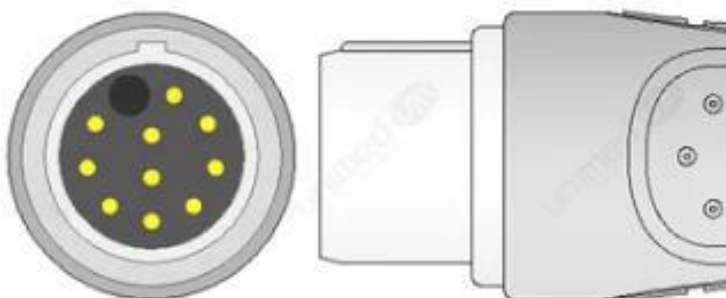


# STRONA PACJENTA

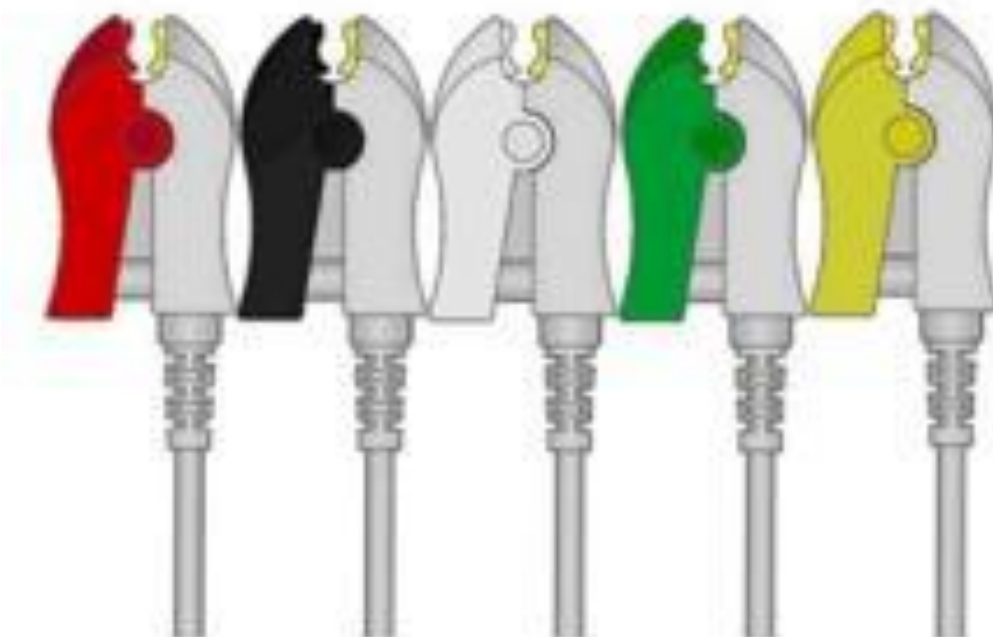


Wtyczka 12 pin

## STRONA MONITORA



## STRONA PACJENTA



### **ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający dopuszcza jednoczęściowy i zespolony kabel z wtyczką 12 pin.**

### **PYTANIE 14:**

Dotyczy załącznika nr 3, pakiet 31, pkt. 5

Czy zamawiający może podać indeks / numer katalogowy dotychczas stosowanego produktu?

### **ODPOWIEDŹ:**

**Masimo rainbow bundle: SpHb+SpOC+SpCO+SpMet+PVIMasimo rainbow Rra.  
(R12 i R21) – 867191.**