



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



LL-C  
Certification  
Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 06.10.2022 r.

**Znak sprawy Nr RPoZP 25/2022**

**Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie**

**Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 26**

1. **Zadanie 1, poz. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski tkannej o rozciągliwości min. 95% o składzie: bawełna (55%), przędza poliamidowa (43%) i spandex (2%)?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**
2. **Zadanie 1, poz. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski tkannej wykonanej z wiskozy (41%) i poliamidu (59%) o elastyczności 80%?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**
3. **Zadanie 1, poz. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski dzianej, nieelastycznej, wykonanej w 100% z wiskozy?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**
4. **Zadanie 1, poz. 5-6** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej o rozciągliwości min. 150%?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
5. **Zadanie 1, poz. 5-6** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej o zawartości bawełny min. 55%?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
6. **Zadanie 1, poz. 5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej o gramaturze 33g?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
7. **Zadanie 1, poz. 6** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej o gramaturze 41g?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
8. **Zadanie 1, poz. 7-11** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów opatrunkowych siatkowych zawierających poliamid (70-80%) i elastomer (20-30%)?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**
9. **Zadanie 1, poz. 7-11** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów opatrunkowych siatkowych o długości 10m w stanie swobodnym i 25m w stanie rozciągniętym?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
10. **Zadanie 1, poz. 7-11** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów opatrunkowych siatkowych o poniższych przeznaczeniach i numerach:
  - nr 2 – dłoń, palec
  - nr 3 – dłoń, stopa
  - nr 4 – podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć
  - nr 6 – głowa, ramię, podudzie, kolano
  - nr 8 – udo, głowa biodro?**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960  
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02  
www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

11. **Zadanie 1, poz. 12** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek podgipsowych w opakowaniach zbiorczych a'12 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę?  
Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.
12. **Zadanie 1, poz. 13** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek podgipsowych w opakowaniach zbiorczych a'6 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę?  
Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.
13. **Zadanie 1, poz. 14-16** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania 3 minuty?  
Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.
14. **Zadanie 1, poz. 14-16** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych nawiniętych na plastikowy trzpień typu krzyżak?  
Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.
15. **Zadanie 2, poz. 1-4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków z siatki bawełnianej nasączonych parafiną?  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww rozwiązania.
16. **Zadanie 2, poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków w rozmiarze 10x10cm?  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.
17. **Zadanie 2, poz. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków w rozmiarze 15x20cm?  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.
18. **Zadanie 2, poz. 5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków w rozmiarze 10x12cm?  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.
19. **Zadanie 2, poz. 6** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków w rozmiarze 6x12cm?  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.
20. **Zadanie 2, poz. 6** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków o średnicy 6,5cm?  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.
21. **Zadanie 2, poz. 7** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków w rozmiarze 12x12cm?  
Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortymentu.
22. **Zadanie 3, poz. 1** – Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1m<sup>2</sup>?  
Odp. Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1m<sup>2</sup>
23. **Zadanie 3, poz. 2** – Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1/2m<sup>2</sup>?  
Odp. Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1/2m<sup>2</sup>
24. **Zadanie 3, poz. 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?  
Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.
25. **Zadanie 3, poz. 16-17** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww rozwiązania.
26. **Zadanie 3, poz. 16** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 8-warstwowych?  
Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.
27. **Zadanie 3, poz. 18, 24** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów włókninowych 4-warstwowych?  
Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960  
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02  
www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

28. **Zadanie 3, poz. 18, 24** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności postępowania?

Odp. Zamawiający nie wydziela ww pozycji do osobnego pakietu.

29. **Zadanie 3, poz. 25-26** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet operacyjnych gazowych, jałowych, nie poddanych procesowi prania wstępnego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortyment.

30. **Zadanie 3, poz. 26** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet operacyjnych gazowych pakowanych a'5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww rozwiązania.

31. **Zadanie 3, poz. 27-29** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w kształcie fasolki wykonanych z gazy 17-nitkowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.

32. **Zadanie 3, poz. 27-28** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w rozmiarze 9,5x9,5cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.

33. **Zadanie 3, poz. 29** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w rozmiarze 15x15cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.

34. **Zadanie 3, poz. 29** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w kształcie różka, pakowanych a'5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.

35. **Zadanie 3, poz. 30-32** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w kształcie kuli wykonanych z gazy 17-nitkowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.

36. **Zadanie 3, poz. 31** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w rozmiarze 30x30cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.

37. **Zadanie 3, poz. 31** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w rozmiarze 20x20cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.

38. **Zadanie 3, poz. 32** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w rozmiarze 30x30cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.

39. **Zadanie 5, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:


• 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm

• 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm

• 4 x ręcznik chłonny z włókniny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100 cm x 150 cm.

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%?




75x200cm  
1szt./pc.



30x30cm  
4szt./pcs



70x120cm  
2szt./pcs



100x150cm  
1szt./pc.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy

numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960


tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl

Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.

**40. Zadanie 5, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:**

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.
  - 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
  - 4 x ręcznik chłonny z włókniny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm
  - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
  - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
- Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%?

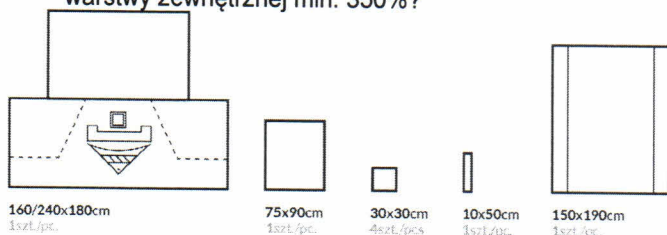


Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.

**41. Zadanie 5, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:**

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65 x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm z
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny standard, L
- 2 x fartuch chirurgiczny standard, XL

Fartuchy zapinane w okolicy karku na standardowy rzep, rękawy zakończone elastycznym mankietem z dzianiny. Zestaw Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%. Zestawy do transportu pakowane w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

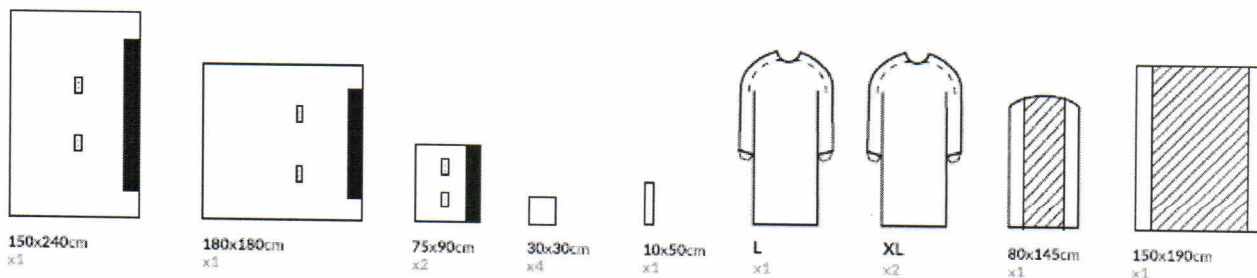

Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.

**42. Zadanie 5, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni w rozmiarze 40 x 30 cm?**  
 Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

43. **Zadanie 6, poz. 1, 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze materiału podstawowego 35g/m<sup>2</sup>?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
44. **Zadanie 6, poz. 1, 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z zapięciem na standardowy rzep w okolicy karku?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
45. **Zadanie 6, poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z elastycznym mankietem z dzianiny?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
46. **Zadanie 6, poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o odporności na przenikanie cieczy >100 cm H<sub>2</sub>O w strefie wzmocnionej?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
47. **Zadanie 6, poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o odporności na przenikanie cieczy 65 cm H<sub>2</sub>O w strefie wzmocnionej, IB=3.2?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**
48. **Zadanie 6, poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów zawiniętych w serwetę włókninową razem z 2 szt ręczników chłonnych?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
49. **Zadanie 6, poz. 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowych wykonany z włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup>, rozmiar XXL?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
50. **Zadanie 6, poz. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze XXXL (dł. 170 cm, obwód 165 cm)?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
51. **Zadanie 6, poz. 4** – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu odporności na alkohol?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
52. **Zadanie 6, poz. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze XXL (dł. 157 cm, obwód 160 cm)?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**
53. **Zadanie 6, poz. 5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu chirurgicznego z włókniny SMS 35g/m<sup>2</sup>, spełniającego wymogi aktualnej normy EN 13795-2?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**
54. **Zadanie 6, poz. 5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu chirurgicznego z bluzą posiadającą dekolt w kształcie litery „V” obszyty lamówką w kolorze ubrania?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
55. **Zadanie 9, poz. 1-5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww rozwiązania.**
56. **Zadanie 9, poz. 1-2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej o grubości 0,03mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

57. **Zadanie 9, poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej w rozmiarze części lepszej 45 x 49?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
58. **Zadanie 9, poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej w rozmiarze części lepszej 55 x 51?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**
59. **Zadanie 9, poz. 3-5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej z 2% roztworem jodyny, pakowanej w opakowanie indywidualne papier- folia z nadrukowanym opisem zawierającym rozmiar, nr serii, datę ważności oraz nr katalogowy oraz dodatkowe wewnętrzne zabezpieczenie folii w papier silikonowany?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**
60. **Zadanie 9, poz. 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej w rozmiarze części lepszej 36 x 42?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
61. **Zadanie 9, poz. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej w rozmiarze części lepszej 46 x 60?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
62. **Zadanie 9, poz. 5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej w rozmiarze części lepszej 60 x 46?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
63. **Zadanie 9, poz. 6** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do izolacji o wymiarach 200cm x 300cm +/- 10cm, wykonany z folii przezroczystej polietylenowej o gramaturze 80 g/m2. Serweta wyposażona w otwór wypełniony folią operacyjną o wymiarach 25cm x 80cm +/- 5cm, dwie dwukomorowe kieszenie na narzędzia po dwóch stronach otworu o wymiarach 26cm x 25cm oraz w dużą torbę do zbiórki płynów z filtrem i portem do podłączenia drenów. Dodatkowo serweta posiada dwa organizery przewodów typu rzep. Sterylna, pakowania w opakowanie folia-papier z naklejkami typu TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
64. **Zadanie 11, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, kolor chabrowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/- 0,01mm, na dłoni 0,07 +/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06 +/- 0,01 mm, AQL 1.0, siła zrywu min 6N wg EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1, przebadany na min. 2 alkohole, w tym odporny na min. 1 o stężeniu co najmniej 90% na min. 1 poziomie, min. 4 kwasy (organiczne i nieorganiczne), 3 aldehydy, jodopowidon i chlorheksydyna – poziom 6, 10% fenol na min. 1 poziomie oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
65. **Zadanie 11, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne, nitylowe, o właściwościach bakteriobójczych, bezpudrowe, niesterylne, kolor chabrowy, teksturowane na palcach, powierzchnia zewnętrzna z zawartością tlenu singletowego, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, grubość na palcu 0,08mm +/- 0,02mm, na dłoni 0,06mm +/- 0,01mm, długość min 240mm. AQL 1.0, średnia siła zrywu przed starzeniem min 7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami EN 455, EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii,

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960  
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02  
www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTM F 1671 (potwierdzone raportem z jednostki niezależnej). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III, typ B. Rękawice przebadane na przenikanie min. 11 substancji chemicznych, w tym min. 5 substancji na poziomie 6. Odporne na min. 10 cytotatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Udokumentowana skuteczność bakteriobójcza zgodnie z ASTM D 7907 na min. 4 bakterie: Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD – potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**

**66. Zadanie 11, poz. 2 –** Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimerowane od wewnątrz, polimerowane od zewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytotatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100/200 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**67. Zadanie 11, poz. 3 –** Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor różowy/malinowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, mankicie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1,5, siła zrywu przed starzeniem min 7N wg EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671 oraz przebadane na min. 12 cytotatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**

**68. Zadanie 11, poz. 3 –** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**

**69. Zadanie 11, poz. 4–** Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,09 ±0,02mm, na mankiecie 0,08±0,02mm, długość min 290 mm, siła zrywu (mediana) min. 9,0N -potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie oraz min 3 środki dezynfekcyjne na min 2 poziomie- potwierdzone badaniami wg EN 374-3 ? z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 sztuk?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**70. Zadanie 11, poz. 5–** Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna bezpudrowa, pokrywana poliuretanem, długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,10 mm, bez protein lateksu, posiadające AQL 1,5, rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Rękawice zgodne z EN 455, EN 374-2,4, EN 420, EN ISO 374-1,5, rękawice wolne od ftalanów DEHP, DBP, BBP, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością oraz posiadające

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

badanie migracji globalnej. Oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, ikoną potwierdzającą brak ftalanów, opakowanie papierowe a'100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**

71. **Zadanie 13, pozycja 1-9** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odp. Zamawiający nie wydziela ww pozycji do osobnego pakietu.**

72. **Zadanie 17, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**

73. **Zadanie 17, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**

74. **Zadanie 20, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2ml z rozszerzeniem do 2,2ml?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**

75. **Zadanie 20, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5ml z rozszerzeniem do 5,5ml?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**

76. **Zadanie 20, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 10ml z rozszerzeniem do 11ml?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**

77. **Zadanie 20, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml z rozszerzeniem do 22ml?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**

78. **Zadanie 20, pozycja 1-4** - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczym zabezpieczeniem w postaci kryzy ograniczającej?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**

79. **Zadanie 20, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem bakteryjnym 0,1µm?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**

80. **Zadanie 20, pozycja 8** - Czy Zamawiający dopuści rampy z kranikami wykonane z poliwęglanu?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**

81. **Zadanie 20, pozycja 9** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**

82. **Zadanie 20, pozycja 10** - Czy Zamawiający dopuści kraniki wykonane z poliwęglanu?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**





**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

**83. Zadanie 24, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**

**84. Zadanie 24, poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pieluchomajtek wyposażonych w cyfrowo literowy wskaźnik wilgotności barwy niebieskiej informujący o konieczności zmiany produktu poprzez blednięcie, rozpływanie się i zanikanie w miarę napełniania moczem?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww rozwiązania.**

**85. Zadanie 26, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu uniwersalnego trzywarstwowego.

Serwety samoprzylepne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup>, chłonność wzmocnienia min. 383%, odporność na penetrację płynów 180 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. Skład:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**

**86. Zadanie 26, poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu uniwersalnego dwuwarstwowego.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Skład:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cm x190 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x145 cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**

**87. Zadanie 26, poz. 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu urologiczno/ginekologicznego wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H<sub>2</sub>O. Skład:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończy, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Do zestawu dołączony osobno sterylny fartuch chirurgiczny standard w rozmiarze L.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 0000002667


NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02


www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl

**88. Zadanie 26, poz. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnej zestawy do tarczycy, wykonany z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Skład:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm?



150x200cm  
1szt./pc.



150x180cm  
1szt./pc.



75x90cm  
1szt./pc.




30x30cm  
4szt./pcs



10x50cm  
1szt./pc.



80x140cm  
1szt./pc.




150x190cm  
1szt./pc.


**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**

**89. Zadanie 26, poz. 5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnej zestawy do żyłaków, z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia < 1.3log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%. Skład:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm?




200x260cm  
1szt./pc.




160x180cm  
1szt./pc.



30x30cm  
4szt./pcs



80x140cm  
1szt./pc.




150x190cm  
1szt./pc.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**

**90. Zadanie 26, poz. 6** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnej zestawy do protezy biodra z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Skład:

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001


- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm?

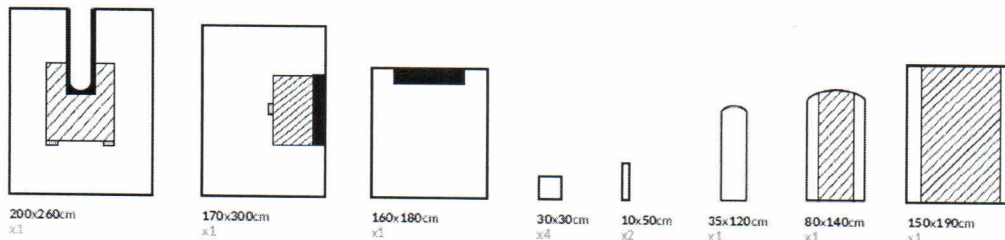

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**

**91. Zadanie 26, poz. 7** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety do artroskopii z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Skład:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm?

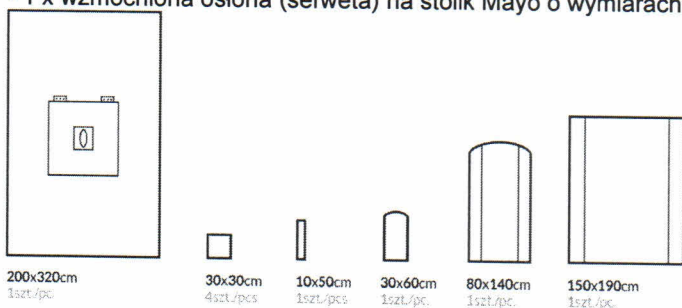

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**

**92. Zadanie 26, poz. 8** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo w rozmiarze 140 x 80 cm, folia niepiaskowana, spełniająca pozostałe wymagania?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**93. Zadanie 26, poz. 9** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 50 x 10 cm, pakowanej a'1 szt w opakowaniu papier-folia, do transportu w wewnętrznej torbie foliową oraz karton zewnętrzny. Wycena za 1 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

94. **Zadanie 26, poz. 10, 12** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z włókniny trójwarstwowej (włóknina polipropylenowa 28g/m<sup>2</sup> + folia PE 25g/m<sup>2</sup> + włóknina polipropylenowa 22g/m<sup>2</sup>) o łącznej gramaturze 75g/m<sup>2</sup>, chłonność 350%, odporność na przenikanie cieczy 102 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 100/99 kPa?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**
95. **Zadanie 26, poz. 11, 13, 14, 16, 17** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, chłonności 600%, wytrzymałości na rozdieranie wzdłużne/poprzeczne na sucho 69.7MD / 45.6CD; na mokro 75.3 MD / 49.4 CD, wytrzymałość na wypychanie na sucho / mokro 109/99.4 kPa, odporność na przenikanie cieczy 196 cm H<sub>2</sub>O?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**
96. **Zadanie 26, poz. 12, 13**– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozmiarze 150 x 240 cm?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**
97. **Zadanie 26, poz. 14** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 7 cm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
98. **Zadanie 26, poz. 15** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety do osuszania rąk z włókniny spunlace w rozmiarze 40 x 40 cm, pakowanej a'1 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
99. **Zadanie 26, poz. 18, 19, 20, 21** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów wykonanych z włókniny 2-warstwowej PP+PE o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, chłonność 600%, wytrzymałość na rozdieranie wzdłużne 69,7N, poprzeczne 45,6N, wytrzymałość na wypychanie na sucho 109kPa na mokro 99,4kPa, odporność na przenikanie cieczy 196cm H<sub>2</sub>O?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**
100. **Zadanie 26, poz. 18, 19, 21** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z kleszczykami o tolerancji wymiarów +/-1 cm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
101. **Zadanie 26, poz. 19** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 180 x 180 cm (zamiast 180 x 170 cm)?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
102. **Zadanie 26, poz. 19, 20, 21** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z serwetą na stolik Mayo 80 x 140 cm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
103. **Zadanie 26, poz. 19** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetkami do rąk 30 x 30 cm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
104. **Zadanie 26, poz. 22** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**
105. **Zadanie 26, poz. 23** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**
106. **Zadanie 26, poz. 24** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu pościeli zawierającego poszewkę w rozmiarze 70x80cm, poszwę w rozmiarze 160x210cm oraz prześcieradło 150x210cm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

**107. Zadanie 26, poz. 25** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie koszuli pacjenta zakładanej od przodu, umożliwiającej zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących, wykonanej z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**108. Zadanie 26, poz. 25-26** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**109. Zadanie 27, poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jałowej osłony w rozmiarze 90 x 100 cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**

**110. Zadanie 27, poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jałowej osłony w rozmiarze 70 x 80 cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**

**111. Zadanie 27, poz. 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jałowej osłony w rozmiarze 90 x 100 cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**

**112. Zadanie 28, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładu o długości 80m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortymentu.**

**113. Zadanie 28, poz. 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**

**114. Zadanie 28, poz. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha foliowego o grubości 0,02mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**

**115. Zadanie 28, poz. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha foliowego o grubości 0,03mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**116. Zadanie 28, poz. 5** – Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18 µm, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, o wymiarach 41 cm x 15cm, w kolorze niebieskim?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**

**117. Zadanie 28, poz. 5** – Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40 g/m<sup>2</sup> z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, o wymiarach 38cm x 17cm, w kolorze niebieskim?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**118. Zadanie 29, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie myjek pakowanych zbiorczo a'24 sztuki z podaniem ceny za 1 sztukę?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**

**119. Zadanie 30, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**

**120. Zadanie 30, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z niezintegrowaną igłą (0,4x13mm)?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww rozwiązania.**



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

- 121. Zadanie 30, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z czarną skalą co 0,02ml oraz pomarańczowym tłokiem?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
- 122. Zadanie 30, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z czarną skalą co 0,025ml oraz czerwonym tłokiem?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**
- 123. Zadanie 30, pozycja 3-4** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z uszczelnieniem w postaci podwójnego pierścienia?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
- 124. Zadanie 30, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z dopakowaną igłą (0,4x13mm)?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**
- 125. Zadanie 30, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą co 0,05ml?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**
- 126. Zadanie 30, pozycja 3-4** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**
- 127. Zadanie 30, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie**
- 128. Zadanie 30, pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 2,3ml?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**
- 129. Zadanie 32, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści papier EKG 104x40 z nadrukiem?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww asortymentu.**
- 130. Zadanie 32, pozycja 3,6** - Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych, które gwarantują najwyższą jakość wydruku?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania oryginalnych papierów.**
- 131. Zadanie 32, pozycja 12** - Czy Zamawiający dopuści papier do EKG Welch Allyn CP50 250 ark. pakowane pojedynczo oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**
- 132. Zadanie 32, pozycja 14** - Czy Zamawiający dopuści papier o wym. 57x30?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
- 133. Zadanie 33, pozycja 1-8** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.  
**Odp. Zamawiający nie wydziela ww pozycji do osobnego pakietu.**
- 134. Zadanie 33, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 26Gx120mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
- 135. Zadanie 33, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści igły z igłą prowadzącą 20G?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
- 136. Zadanie 33, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści igły typu Tuochy 18Gx90mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**
- 137. Zadanie 33, pozycja 8** - Czy Zamawiający dopuści zestaw z igłą typu Tuochy 18Gx90mm?

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960  
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02  
www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



LL-C  
Certification

Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**138. Zadanie 35, pozycja 1** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorcza, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**139. Zadanie 35, pozycja 1** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**140. Zadanie 35, pozycja 1** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**141. Zadanie 35, pozycja 1** - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**142. Zadanie 35, pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści przedłużacze o długości 150cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**143. Zadanie 36, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe 105cm z 3 znacznikami głębokości na 50,60 i 70cm od końca dystalnego, pakowane w opakowania papier-folia?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**144. Zadanie 36, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z czterema otworami bocznymi oraz lekko zaokrąglonym końcem dystalnym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**145. Zadanie 38, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2,5l?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**146. Zadanie 38, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**

**147. Zadanie 44, poz. 1- 2** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**

**148. Zadanie 44, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści golarkę z ostrzem ze stali nierdzewnej pokrytej chromem, rozmiar 6,5x 4,5cm oraz z uchwytem wykonanym z polietylenu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**149. Zadanie 44, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**

**150. Zadanie 44, poz. 6** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niejałowych gazików włókninowych nasączonych 70% alkoholem izopropylowym; każdy gazik zapakowany osobno w opakowanie folia aluminiowa-papier, w opakowaniu zbiorczym a'100 sztuk?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**151. Zadanie 44, poz. 6** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

---

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960  
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02  
www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732


ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**

**152. Zadanie 44, poz. 8** – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'300 szt. z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań – 9 opak?

**Odp. Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości z wyceną ilości umieszczonej w SWZ.**

**153. Zadanie 44, poz. 9** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie okularów ochronnych wykonanych z poliwęglanu, odpornych na uderzenia o niskiej energii, bez możliwości regulacji długości ramion, klasa optyczna I, spełniające wymagania normy EN 166:2001, EN 170:2002, zakwalifikowanych jako środek ochrony indywidualnej kategorii II o wymiarach 55mm x 156mm? Zdjęcie poglądowe poniżej.

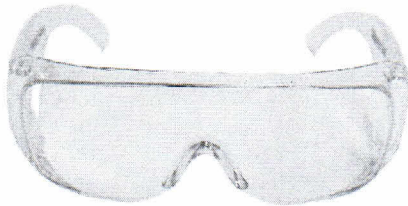

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**154. Zadanie 44, poz. 10** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**

**155. Zadanie 44, poz. 11** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'144 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**

**156. Zadanie 44, poz. 12** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości oraz zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odp. Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości z wyceną ilości umieszczonej w SWZ.**

**157. Zadanie 44, poz. 12** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**

**158. Zadanie 44, poz. 14** – Czy Zamawiający dopuści pojemniki bez etykiety do opisu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**159. Zadanie 44, poz. 16** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**

**160. Zadanie 44, poz. 17** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**

**161. Zadanie 44, poz. 20-21** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**

**162. Zadanie 44, poz. 21** – Czy Zamawiający dopuści szpatułki drewniane sterylne?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**163. Zadanie 44, poz. 23** – Czy Zamawiający dopuści worki bez zastawki?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

---

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl





**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

**164. Zadanie 44, poz. 23**– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**

**165. Zadanie 44, poz. 29-30** – Czy Zamawiający dopuści wzierniki pakowane po a'100 szt. w rękaw foliowy?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**166. Zadanie 44, poz. 29-30** – Czy Zamawiający dopuści wzierniki pakowane po a'34 szt. w rękaw foliowy?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**167. Zadanie 44, poz. 29** – Czy Zamawiający dopuści wzierniki w rozmiarze 4,25mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**168. Zadanie 44, poz. 30** – Czy Zamawiający dopuści wzierniki w rozmiarze 2,5mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**169. Zadanie 44, poz. 30** – Czy Zamawiający dopuści wzierniki w rozmiarze 2,75mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**170. Zadanie 44, poz. 29-30**– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.**

**171. Zadanie 44, poz. 29-30**– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'34 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości oraz zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odp. Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości z wyceną ilości umieszczonej w SWZ.**

**172. Zadanie 66, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne standardowe o długości 18,8 cm (średnica min / max): 5 mm / 7 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza ww asortyment.**

**KOMENDANT**

**płk mgr Krzysztof Jurkowski**

I.B 91/ 810 59 82

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,  
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960  
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02  
www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl