

Kraków, 13.12.2024

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 12/614-25-34  
e- mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

DZ.271.114. 1355 .2024

dotyczy: **DZ.271.114.2024 – Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów.**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

**Dotyczy Załącznika 4 do Pakietu 1, 8 i 9:**

**Pytanie 1.**


Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że kolumna „10 ” Wartość brutto [zł] (kol.6 x kol 7 x kol 8)” ma być liczona zgodnie z pkt 20.Sposób obliczenia ceny. 2 Ogólny wzór do obliczania ceny?

**Odp.: W punkcie 20 SWZ jest podany ogólny wzór obliczania wartości brutto oferty. Kolumna 10- „Wartość brutto”, ma być obliczona w sposób podany w załączniku 4 do SWZ.**

**Pytanie 2.**

Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu ?

Oferowane analizatory oraz systemy wymagają do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o odczynnikach, kontrolach, kalibratorach, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS. Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów).

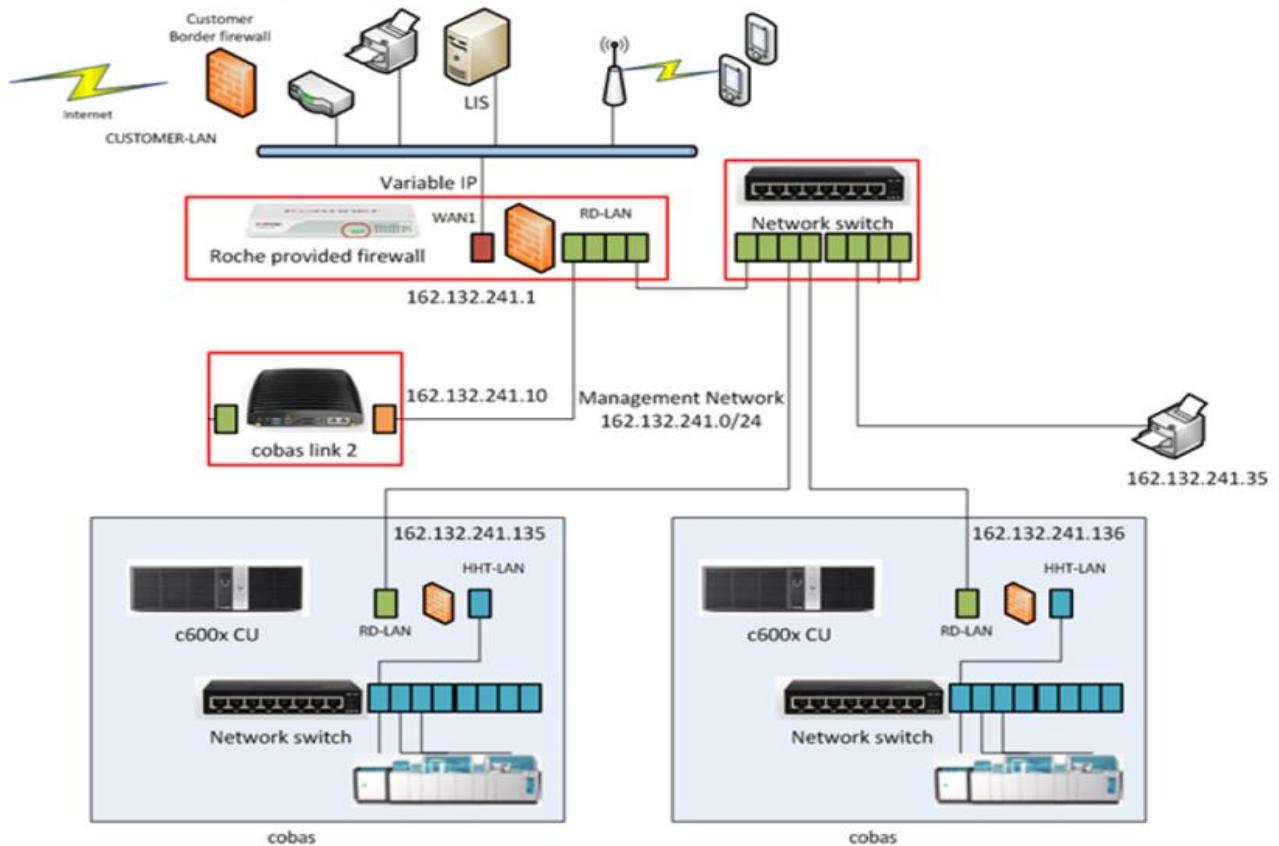

URL	IP	Port	Typ	Description
*.navify.com	193.58.155.0/24	443	CloudFlare	Main connections enabling Remote Service
*.navify.com	193.228.103.0/24	433 (514/541)	CloudFlare	Current/future setup using Cloudflare
remoteservice.roche.com	62.209.44.11	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas1.roche.com	62.209.44.21	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas2.roche.com	62.209.44.22	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas3.roche.com	209.202.167.19	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas4.roche.com	209.202.167.20	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas5.roche.com	120.136.45.231	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas6.roche.com	120.136.45.230	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas15.roche.com	35.76.193.4	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas16.roche.com	52.193.219.53	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
rln-cm-*.dia.roche.com	52.178.37.238	514 / 541	Direct	Dedicated connections enabling FortiGate management
teleservice.roche.com	196.3.50.39	443 / 80	HTTP	Dedicated connection to TSN
remoteservice-dr.roche.com	209.202.167.21	443	Direct	Axeda Disaster Recovery

**Odp.: TAK, Zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu.**

**Pytanie 3.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci Zamawiającego (LIS) oferowanych urządzeń do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

*Uzasadnienie: Z uwagi na długie terminy realizacji podłączeń urządzeń przez dostawcę Państwa systemu LIS, które nie są zależne od nas jako Wykonawcy.*

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 4.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

*Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.*

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 5.**

Czy Zamawiający zgodzi się by Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie instalacji, które wynikają ze zmian podjętych przez Zamawiającego już w czasie jej trwania, w szczególności dotyczy: zmiany konfiguracji lub umiejscowienia aparatów w pomieszczeniu laboratorium.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**PAKIET I - Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą zintegrowanych systemów analitycznych do badań z zakresu biochemii i immunochemii**

**Pytanie 6.**

Dotyczy pakietu nr 1 parametry graniczne pkt 5:

Na rynku nie są dostępne kontrole zewnątrzlaboratoryjne do wszystkich wymienionych parametrów m.in. do parametrów tj. antygen HBS -ilościowo, kwas mykofenolowy, sdLDL, NGAL, Elektrolity K w PMR, HCV Ag. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zapewnienie kontroli zewnątrzlaboratoryjnych do tych parametrów, do których są one dostępne na rynku w dostępnych częstotliwościach.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 7.**

Dotyczy Pakietu 1, pkt. 13 opisu przedmiotu zamówienia dla Zintegrowanego systemu analitycznego do badań z zakresu biochemii i immunochemii - 2 szt.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla pojedynczych wyrobów ich okres ważności przy dostawie wynosił 3-6 miesięcy? Wynika to sporadycznie z cyklu produkcyjnego Wytwórcy, na który Oferent nie ma wpływu?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 8.**

Dotyczy: Pakiet 1, formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby dla różnego typu próbki (mocz, PMR, surowica krwi), oznaczenia wykonywane przy pomocy tego samego odczynnika wyspecyfikowane były w jednej pozycji: (poz.1+2; poz. 19+20, poz. 51+52, poz. 61+62)?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 9.**

parametry: , pkt 12:

“Czas reakcji serwisu z podjęciem naprawy nie dłuższy niż 48 h od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by wspomniany czas reakcji dotyczył dni roboczych?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**PAKIET II - Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania oznaczeń z zakresu hematologii**

**Pytanie 10.**

Dotyczy SWZ, Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 3 do SWZ, Pakiet 2 pkt 8:

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy?

Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: .....”.

**Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy.**

**Pytanie 11.**

Dotyczy SWZ, Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 3 do SWZ, Pakiet 2 pkt 64:

Czy Zamawiający dopuści przesłanie Deklaracji Zgodności w ślad za podpisaną umową?

Wykonawca motywuje swoją prośbę względami organizacyjnymi

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**PAKIET VI - Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do diagnostyki mikrobiologicznej**

**Pytanie 12.**

Dotyczy Załącznika parametry pakiet 6 pkt 5, 13-15, 17-18, 41- Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia z pierwszą dostawą wskazanych dokumentów i wyrazi zgodę na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy gdzie będą całodobowo dostępne dokumenty do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego? Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 13.**

Dotyczy Pakietu nr 6 informacja pod formularzem cenowym oraz Załącznik Parametry pkt 10- Czy Zamawiający wyrazi

zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem ważności dla podłoży na płytach z krwią – min. 4 – 5 tygodnie, dla podłoży na płytach bez krwi oraz podłoży chromogennych – min. 4 - 8 tygodni oraz dla pozostałych produktów 4-6 miesięcy od daty pojedynczej dostawy? Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonawca będzie starała się dostarczać jak najdłuższe dostępne terminy ważności.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 14.**

Dot. tabela asortymentowa pakiet nr 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę przez Oferenta w tabeli asortymentowej niezbędnych ilości innych odczynników materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania badań metodą automatyczną w oparciu o podane ilości testów?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

### **PAKIET VII - Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do inkubacji próbek mikrobiologicznych**

#### **Pytanie 15.**

Dotyczy Załącznika parametry pakiet 7 Analizator nr 1 pkt 4, 16, 17, 18, 25, 36, oraz Analizator nr 2 pkt 4, 32, 33- Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia z pierwszą dostawą wskazanych dokumentów i wyrazi zgodę na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy gdzie będą całodobowo dostępne dokumenty do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego? Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 16.**

Pakiet nr 7 (Dot. Wymogi ogólne pkt. 6) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia klimatyzacji pomieszczenia jeżeli w danym pomieszczeniu jest zamontowana klimatyzacja w dobrym stanie technicznym, która zapewnia właściwą temperaturę niezbędną dla prawidłowej pracy aparatu ?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 17.**

Pakiet r 7 (Dot. Wymogi ogólne Pkt. 10, Analizator do inkubacji próbek mikrobiologicznych (jałowości) - 1 sztuka ) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentów kwalifikacji operacyjnej, instalacyjnej i końcowej dla zaoferowanego analizatora w języku angielskim ?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 18.**

Pakiet nr 7 (Dot. Wymogi ogólne Pkt. 11) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie poniższych szczepów w formie Bioball: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, Clostridium sporogenes zgodne z wymaganiami Farmakopei Europejskiej do kwalifikacji procesowej ?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 19.**



Pakiet nr 7 (Dot. Wymogi ogólne Pkt. 12) Czy Zamawiający usunie z parametru jego część tj.: „z modułem do detekcji prątką gruźlicy z krwi” - z uwagi na to, że podłoża do hodowli prątką nie przedmiotem zamówienia (nie są ujęte w zapotrzebowaniu tabeli asortymentowej)?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 20.**

Pakiet nr 7 (Dot. Wymogi ogólne Pkt. 10) Analizator do inkubacji próbek mikrobiologicznych) Czy Zamawiający dopuści wyłącznie dokument kwalifikacji operacyjnej oraz instalacyjnej, w języku angielskim, który będzie dołączony przy dostawie ?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 21.**

Pakiet nr 7 (Dot. tabela asortymentowa, pozycja 3) Czy Zamawiający dopuści podłoża pediatryczne zwalidowane tylko do posiewów krwi ? Zamawiający ma możliwość posiewu innych jałowych płynów ustrojowych zarówno od dzieci jak i dorosłych na podłożach tlenowych i beztlenowych z pozycji 1 i 2, które są do tego zwalidowane.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 22.**

Pakiet nr 7 Dot. tabela asortymentowa, materiały zużywalne niezbędne do wykonywania badań, pozycja 1 – Zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowej ilości podłoży wymagających dodania substancję wzbogacającą posiew płynów ustrojowych oraz małych objętości krwi 0,5 lub mniej

**Odp.: Zamawiający informuje, że szacunkowa ilość podłoży wymagających dodania substancję wzbogacającą posiew płynów ustrojowych oraz małych objętości krwi 0,5 lub mniej to ok 40.**

**Pytanie 23.**

Pakiet nr 7 - Dot. tabela asortymentowa, materiały zużywalne niezbędne do wykonywania badań, pozycja 2 – Zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowej ilości do wyceny nasadek do przesiewania butelek dodatnich

**Odp.: Zamawiający informuje, szacunkowa ilość nasadek do przesiewania butelek dodatnich to ok 3000.**

**[PAKIET VIII - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do diagnostyki molekularnej wirusów](#)**

**Pytanie 24.**

Pakiet nr 8, parametry graniczne, pkt. 12:

Czy Zamawiający miał na myśli stwierdzenie, iż maksymalna liczba oznaczeń w przebiegu wynosi 24 wliczając kontrole?

**Odp.: TAK, Zamawiający miał na myśli stwierdzenie, iż maksymalna liczba oznaczeń w przebiegu wynosi 24 wliczając kontrole.**

**Pytanie 25.**

Pakiet 8, pkt. 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu, w którym zastosowany jest system ochrony przed kontaminacją: końcówki pipetujące z filtrem i ochrona enzymatyczna, lecz bez lampy UV?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

## PAKIET IX - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do oznaczeń PCR

### **Pytanie 26.**

Pakiet nr 9: tabela parametry graniczne, tytuł tabeli oraz formularz asortymentowo cenowy dot. dzierżawy :  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by nazwa oferowanego instrumentu brzmiała “analyzer PCR w czasie rzeczywistym do diagnostyki in vitro (IVD)” zamiast “Automatyczny system do diagnostyki molekularnej”?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Wzór umowy**

### **Pytanie 27.**

Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?  **Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie 28.**

Dotyczy SWZ, Wzór umowy – zał. nr 2 do SWZ, §1 ust. 2:

Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

*„z wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.*

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

### **Pytanie 29.**

Dotyczy SWZ, Wzór umowy – zał. nr 2 do SWZ, §3 ust. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie elektronicznej faktury VAT na wskazany adres poczty elektronicznej? Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez dodanie zapisu „Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych na następujący adres poczty elektronicznej.....”.

Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w Załączniku nr 2 do SWZ, Wzór umowy dzierżawy, §6 ust. 3.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

### **Pytanie 30.**

Dotyczy SWZ, Wzór umowy dzierżawy – zał. nr 2 do SWZ, §1 ust. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego zapisu, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wdzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis:

*„Obowiązek ubezpieczenia wdzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wdzierżawiającego (Wykonawcy).”*

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

### **Pytanie 31.**

Dotyczy SWZ, Wzór umowy dzierżawy – zał. nr 2 do SWZ, §4 ust. 1:

Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 32.**

Dotyczy SWZ, Wzór umowy dzierżawy – zał. nr 2 do SWZ, §4 ust. 3:

Czy Zamawiający dopuści przesłanie harmonogramu przeglądów w ślad za podpisaną umową? Wykonawca motywuje swoją prośbę względami organizacyjnymi

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 33.**

Dotyczy SWZ, Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – zał. nr 2 do SWZ, §2 ust. 12:

W celu realizacji obowiązku wskazanego §2 ust. 12 uprzejmie prosimy o wskazanie danych kontaktowych do osoby odpowiedzialnej za realizację umowy z ramienia Zlecającego

**Odp.: Zamawiający informuje, że ww. dane zostaną podane Wykonawcy po podpisaniu umowy.**

**Pytanie 34.**

Dotyczy projektu umowy par 5 pkt 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby tylko te odczynniki posiadały świadectwo dopuszczenia do obrotu wg ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych oraz Dyrektywy Unii Europejskiej 98/79/EC., które muszą podlegać ww. ustawie ze względu na swoją klasyfikację? Uzasadnienie: Nie wszystkie oferowane wyroby są wyrobami medycznymi. O klasyfikacji wyrobów/odczynników wg dyrektywy nr 98/79/WE lub 93/42/EWG decyduje wytwórca danego wyrobu, a wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych i nie podlegają obowiązkowi posiadania dopuszczenia do obrotu.

**Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 35.**

§ 4 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W razie sprzedaży wadliwego towaru, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji. W razie niezrealizowania przez Wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1,5% wartości wadliwego towaru, za każdy dzień zwłoki”?

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 36.**

§ 4 ust. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych, której mogą dochodzić strony do 30% sumy maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy?

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 37.**

§2 ust. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatorów do 6 tygodni?

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 38.**

zał. nr 2 projektowane postanowienia umowy - dostawa odczynników



par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna była liczona od „niezrealizowanej wartości umowy brutto”? Specyfika realizacji przedmiotu Umowy, polegającego na świadczeniu ciągłym, przez okres ustalony w kontrakcie, czyni nieuzasadnionym naliczanie kar, w stosunku do wartości globalnej umowy, w sytuacji, gdy Zamawiający nie ma uwag do umowy w części wykonanej do daty wypowiedzenia. W przeciwnym razie kara umowna powinna zostać uznana za wygórowaną zgodnie z art. 484 k.c.

Ponadto, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu:

„po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

### **Pytanie 39.**

zał. nr 2 projektowane postanowienia umowy - dostawa odczynników

par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia, tak aby kara umowna wynosiła “100,00 zł” za każdy dzień zwłoki?

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

### **Pytanie 40.**

zał. nr 2 projektowane postanowienia umowy - dostawa odczynników

par. 4 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację limitu kar umownych do „20%”?

Zaproponowana przez Zamawiającego wartość odbiega od rynkowego pułapu maksymalnego, który zazwyczaj sięga 10-20%. Nadto, należy mieć na uwadze, że wszelkie ryzyka finansowe związane z realizacją umowy będą musiały zostać w kalkulowane do ceny ofertowej Wykonawców.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

### **Pytanie 41.**

zał. nr 2 projektowane postanowienia umowy - dostawa odczynników

par. 4 ust. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

### **Pytanie 42.**

zał. nr 2 projektowane postanowienia umowy - dostawa odczynników

par. 6 ust. 5 W projekcie umowy, zawarto postanowienia przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Zostały one jednak sformułowane w taki sposób, że w przypadku umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce niemożliwa z uwagi na to, że jej warunki wstępne nie mogą zaistnieć lub będzie miała pomijalną wartość. Takie sformułowanie postanowień powoduje, że mają one pozorny charakter, a zatem ich umieszczenie stanowi obejście normy wynikającej z art. 439 Prawa zamówień publicznych, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych.

Czy wobec powyższego Zamawiający wprowadziłby do wzoru umowy zaproponowaną poniżej treść postanowień waloryzacyjnych zgodnych z art. 439 PZP, które dzielą koszty wzrostu cen pomiędzy zamawiającego i wykonawcę?

1. *Strony zobowiązują się dokonywać zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostawy określonych w Umowie produktów (w szczególności odczynników, materiałów zużywalnych, części zamiennych)*

określonego w §2 Umowy oraz w załącznikach do niej („Waloryzacja”), w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia („Zmiana cen”).

2. Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do kwartału poprzedniego, publikowany co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („GUS”) na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych („Wskaźnik”).
3. Przyjmuje się, że Zmiana cen nastąpiła, jeżeli Wskaźnik osiągnął wartość większą lub równą 3%.
4. Przyjmuje się, że Zmiana cen wpływa na koszt wykonania Zamówienia odpowiednio do wysokości Wskaźnika, przy czym Waloryzacja następować będzie w wysokości wynoszącej połowę Wskaźnika.
5. Waloryzacja następować będzie co 3 miesiące, przy czym pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od zawarcia Umowy.
6. W dniu, w którym zgodnie z ust. 5 następuje Waloryzacja, zmienia się wynagrodzenie w zakresie wskazanym w ust. 1, biorąc pod uwagę wartość Wskaźnika ostatnio opublikowaną przez Prezesa GUS, o ile wartość ta będzie większa lub równa wartości wskazanej w ust. 3. Odpowiednio zmienione zostają ceny poszczególnych pozycji załącznika asortymentowo-cenowego.
7. W razie potrzeby, przy wyliczaniu Waloryzacji, ceny zaokrągla się w dół do pełnych groszy.
8. W przypadku drugiej i kolejnych Waloryzacji, cenami wyjściowymi, które będą waloryzowane, będą ceny powstałe w wyniku poprzedniej Waloryzacji, z uwzględnieniem ewentualnych zmian jakie od czasu poprzedniej Waloryzacji zostały dokonane w drodze aneksów do Umowy.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy.
10. Waloryzacja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do Umowy. Po Waloryzacji, w razie potrzeby, Wykonawca przekaze Zamawiającemu załącznik asortymentowo-cenowy zmieniony zgodnie z niniejszym paragrafem.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

#### **Pytanie 43.**

zał. nr 2 projektowane postanowienia umowy - dostawa odczynników

par. 6 ust. 11 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 44.**

zał. nr 2 Umowa dzierżawy

par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

#### **Pytanie 45.**

zał. nr 2 Umowa dzierżawy

par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego postanowienia? Konsekwencje finansowe nieprawidłowego wykonania umowy zostały już szczegółowo określone poprzez zastrzeżenie kar umownych, a także rozszerzenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych w przypadku poniesienia szkody wyższej niż te kary.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 46.**

zał. nr 2 Umowa dzierżawy

par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Ponadto, czy Zamawiający w przypadku przedłużającej się awarii dopuszcza możliwość wykonania badań w innym laboratorium na koszt Wykonawcy, a tym samym wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego i naliczenia kary umownej za czas niesprawności urządzenia?

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 47.**

zał. nr 2 Umowa dzierżawy

par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację limitu kar umownych do „20%”?

Zaproponowana przez Zamawiającego wartość odbiega od rynkowego pułapu maksymalnego, który zazwyczaj sięga 10-20%. Nadto, należy mieć na uwadze, że wszelkie ryzyka finansowe związane z realizacją umowy będą musiały zostać w kalkulowane do ceny ofertowej Wykonawców.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 48.**

zał. nr 2 Umowa dzierżawy

par. 3 ust. 8 W projekcie umowy, zawarto postanowienia przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Zostały one jednak sformułowane w taki sposób, że w przypadku umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce niemożliwa z uwagi na to, że jej warunki wstępne nie mogą zaistnieć lub będzie miała pomijalną wartość. Takie sformułowanie postanowień powoduje, że mają one pozorny charakter, a zatem ich umieszczenie stanowi obejście normy wynikającej z art. 439 Prawa zamówień publicznych, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych.

Czy wobec powyższego Zamawiający wprowadziłby do wzoru umowy zaproponowaną poniżej treść postanowień waloryzacyjnych zgodnych z art. 439 PZP, które dzielą koszty wzrostu cen pomiędzy zamawiającego i wykonawcę?

11. *Strony zobowiązują się dokonywać zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostawy określonych w Umowie produktów (w szczególności odczynników, materiałów zużywalnych, części zamiennych) określonego w §3 Umowy oraz w załącznikach do niej („Waloryzacja”), w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia („Zmiana cen”).*

12. *Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do kwartału poprzedniego, publikowany co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („GUS”) na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych („Wskaźnik”).*

13. *Przyjmuje się, że Zmiana cen nastąpiła, jeżeli Wskaźnik osiągnął wartość większą lub równą 3%.*

14. *Przyjmuje się, że Zmiana cen wpływa na koszt wykonania Zamówienia odpowiednio do wysokości Wskaźnika, przy czym Waloryzacja następować będzie w wysokości wynoszącej połowę Wskaźnika.*

15. *Waloryzacja następować będzie co 3 miesiące, przy czym pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od zawarcia Umowy.*

16. *W dniu, w którym zgodnie z ust. 5 następuje Waloryzacja, zmienia się wynagrodzenie w zakresie wskazanym w ust. 1, biorąc pod uwagę wartość Wskaźnika ostatnio opublikowaną przez Prezesa GUS, o ile wartość ta będzie*

większa lub równa wartości wskazanej w ust. 3. Odpowiednio zmienione zostają ceny poszczególnych pozycji załącznika asortymentowo-cenowego.

17. W razie potrzeby, przy wyliczaniu Waloryzacji, ceny zaokrągla się w dół do pełnych groszy.

18. W przypadku drugiej i kolejnych Waloryzacji, cenami wyjściowymi, które będą waloryzowane, będą ceny powstałe w wyniku poprzedniej Waloryzacji, z uwzględnieniem ewentualnych zmian jakie od czasu poprzedniej Waloryzacji zostały dokonane w drodze aneksów do Umowy.

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy.

20. Waloryzacja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do Umowy. Po Waloryzacji, w razie potrzeby, Wykonawca prześle Zamawiającemu załącznik asortymentowo-cenowy zmieniony zgodnie z niniejszym paragrafem.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

#### **Pytanie 49.**

zał. nr 2 Umowa dzierżawy

par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu obowiązywania przedłużonej umowy do 44 miesięcy?  
Uzasadnienie:

Dłuższy termin trwania umowy niż 44 miesiące narazi Zamawiającego na konieczność amortyzowania przedmiotu umowy, a tym samym zwiększy po jego stronie koszty kontraktu.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

#### **Pytanie 50.**

zał. nr 2 Umowa dzierżawy

par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu:

„po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”?  
Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

Ponadto, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawnionych przez Wykonawcę"?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Ponadto, Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna była liczona od „niezrealizowanej wartości umowy brutto”?  
Specyfika realizacji przedmiotu Umowy, polegającego na świadczeniu ciągłym, przez okres ustalony w kontrakcie, czyni nieuzasadnionym naliczanie kar, w stosunku do wartości globalnej umowy, w sytuacji, gdy Zamawiający nie ma uwag do umowy w części wykonanej do daty wypowiedzenia. W przeciwnym razie kara umowna powinna zostać uznana za wygórowaną zgodnie z art. 484 k.c.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

#### **Pytanie 51.**

zał. nr 2 Umowa dzierżawy

par. 7 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**



**Pytanie 52.**

zał. nr 2 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

par. 2 ust. 10 lit. c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin zgłoszenia naruszenia ochrony danych został wydłużony do 48h?

Uzasadnienie: W ocenie Wykonawcy, wskazany przez Zamawiającego termin jest zbyt krótki. Zgodnie z Rozporządzeniem, czas na zgłoszenie faktu naruszenia ochrony danych przez Administratora wynosi 72h od stwierdzenia naruszenia przez Administratora.

**Odp.: NIE, Zamawiający zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 53.**

par. 2 ust. 17 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Termin składania ofert: 20.12.2024 godz.: 09:00**

**Termin otwarcia ofert: 20.12.2024 godz.: 09:30**

Zatwierdził:

lek. Grzegorz Fitas – Dyrektor Szpitala