



Opole 19.06.2024 r.

Znak sprawy: N.ZP.2800.36.1.2024-PN.BK

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 Ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r., którego przedmiotem jest: **"Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą urządzeń i oprogramowania dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 36 miesięcy"** nr postępowania: N.ZP.2800.36.2024-PN.

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2022 poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załączników.

PYTANIE NR 1

1. W związku z postanowieniem §2 ust. 1 projektu umowy dostawy, zwracam się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia asortymentu w opakowaniach spełniających wymagania określone w SWZ, na których będzie umieszczone oznakowanie lub opis w języku angielskim, zawierający wymagane dane. Podkreślamy, że etykieta w języku angielskim zawiera wyraźnie oznaczone najważniejsze informacje (w tym piktogramy), których nie sposób źle zinterpretować.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Proszę o zmianę §2 ust. 10 projektu umowy dostawy (zadanie nr 3) poprzez nadanie mu brzmienia: „Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcom. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania”. Należy wskazać, iż w SWZ Zamawiający nie zastrzegł żadnej części zamówienia do osobistego wykonania przez Wykonawcę. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Nie jest w tym zakresie wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne.

Odpowiedź: Brak zgody, zgodnie z Projektem umowy.

3. Proszę o zmianę §5 ust 6 projektu umowy dostawy poprzez dodanie *in fine* zastrzeżenia: „jeżeli szkody są wynikiem zawinonego przez Wykonawcę działania lub zaniechania”. Wykonawca nie może brać na siebie odpowiedzialności za wszelkie szkody mogące powstać w związku z realizacją umowy, a tylko za te, do których powstania w sposób zawiniony się przyczynił.

Odpowiedź: Brak zgody. Odpowiedzialność na zasadach ogólnych KC.

4. Zwracamy się z prośbą o zmianę §5 ust. 7 projektu umowy dostawy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy posiadać polisę lub inne dokumenty ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z rozszerzeniem o odpowiedzialność za wadliwy produkt zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż 300.000 zł na **jeden i wszystkie wypadki**. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie powyższego ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego”.

Wskazujemy, że spełnienie wymogu Zamawiającego w postaci przedłożenia polisy OC zawierającej rozszerzenie odpowiedzialności za wadliwy produkt na kwotę nie mniejszą niż 300.000 zł na każde zdarzenie jest bardzo utrudnione, gdyż wymaga to zawarcia przez Wykonawcę dodatkowej umowy ubezpieczenia obejmującej nieograniczoną ilość zdarzeń, co z kolei doprowadziłoby do znacznego wzrostu ceny oferty, gdyż składka ubezpieczenia od tak szeroko określonego zakresu ubezpieczenia jest znacznie wyższa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. W związku z powyższym modyfikuje zapisy w §5 ust. 7 projektu umowy dostawy, który otrzymuje brzmienie:



„Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy posiadać polisę lub inne dokumenty ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z rozszerzeniem o odpowiedzialność za wadliwy produkt zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż 300.000 zł na **jedno i wszystkie zdarzenia**. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie powyższego ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego”.

5. Proszę o zmianę §6 ust. 5 projektu umowy dostawy oraz §5 ust. 10 projektu umowy dzierżawy poprzez zmniejszenie maksymalnego limitu kar umownych do 25% wynagrodzenia brutto. Określenie maksymalnej wysokości kar umownych na poziomie 45% jest nadmierne. Wskazujemy, że kara umowna stanowi pewne zabezpieczenie strony umowy, jednak nie może być rażąco wygórowana i nie może prowadzić do dodatkowego zarobku po stronie Zamawiającego. Przepisy nie określają odpowiedniego poziomu limitu, jednak w orzecznictwie KIO wskazuje się, że limit kar umownych na poziomie 20-30% całkowitego wynagrodzenia brutto jest odpowiedni.

Odpowiedź: Brak zgody, zgodnie z Projektem umowy.

6. Proszę o zmianę §9 ust. 12 projektu umowy poprzez wykreślenie z niego zdania drugiego. Zmiana formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy jest jego indywidualną sprawą, czego konsekwencją powinna być zmiana umowy w tym zakresie, bez uzyskiwania na tę czynność zgody Zamawiającego.

Odpowiedź: Brak zgody, zgodnie z Projektem umowy.

7. W związku z treścią §4 ust. 2 projektu umowy dostawy, zgodnie z którym cena oferty obejmuje także usuwanie wad i reklamacji, powołując się na art. 578 k.c., proszę o zmianę niniejszego postanowienia poprzez dodanie po fragmencie: „usuwanie wad i reklamacji”, następującego zastrzeżenia: „powstałych z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy”. Prosimy o doprecyzowanie powyższego, ponieważ Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za wady powstałe z przyczyn od niego niezależnych, np. za wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania asortymentu przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Brak zgody. Zasady usuwania wad i reklamacji zawarto w § 5. Projekt Umowy.

8. W związku z zapisem w rozdziale V pkt 1 lit. b. SWZ, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie złożenia wraz z ofertą kart/opisów technicznych lub katalogowych **dystrybutora** oferowanego wyrobu. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, dystrybutor także jest uprawniony do dostarczania lub udostępniania wyrobów medycznych na rynku. Wskazujemy, że dystrybutor, mimo że nie jest wytwórcą wyrobu medycznego, to dysponuje szczegółową wiedzą na temat produktu i jego zastosowań nie mniejszą od producenta. W związku z powyższym dopuszczenie przedłożenia wraz z ofertą dokumentów przedmiotowych opracowanych przez dystrybutora jest uzasadnione.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenia wraz z ofertą kart/opisów technicznych lub katalogowych dystrybutora oferowanego wyrobu. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji rozdziału V pkt 1 lit. b. SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„ b) w celu potwierdzenia spełnienia warunków technicznych bezwzględnych należy załączyć wypełnione Załączniki nr 1.1-1.4 2.1-2.3,3.1-3.2 oraz należy załączyć odpowiednie instrukcje techniczne, katalogi producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie tych warunków. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.”

9. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy wszystkie parametry oferowanego sprzętu nie będą wynikały z instrukcji technicznych czy katalogów producenta, Zamawiający dopuści złożenie przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego. Wskazujemy, że ulotki, instrukcje, katalogi to dokumenty producenta, które nie są przygotowywane do konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i mogą one nie odzwierciedlać wszystkich parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia załączonym do SWZ.

Odpowiedź: Jak wyżej.



10. Proszę o zmianę treści projektu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych poprzez dodanie do kategorii danych, następującego zapisu: „Dane przesyłane do aparatu powinny być ukryte w formie kodu”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie. Dane osobowe mają być przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych, informatycznych oraz organizacyjnych aby nie doszło do ich przypadkowego ujawnienia, a tym samym naruszeniu ochrony danych osobowych. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w pkt 3 ppkt. 3.1 Umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych, dopisując w „Danych szczególnych kategorii” - Dane przesyłane do aparatu powinny być ukryte w formie kodu – jeśli dotyczy.

Pytania dotyczące Parametrów wymaganych Załącznika 3.1

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie glukometrów posiadających pamięć 1000 wyników, pracujących z wykorzystaniem akumulatorów pozwalających na wykonanie do 40 oznaczeń po pełnym naładowaniu, w oparciu o testy o 3 miesięcznej stabilności po otwarciu oraz wykonujących pomiary z próbek krwi żyłnej, pełnej krwi tętnicznej, tętnicznej krwi od noworodków oraz z piętek noworodków? Z racji przeznaczenia glukometru krew żylna pobrana na EDTA-K2 nie jest typem rutynowo stosowanej próbki na oddziałach szpitalnych. Fiolka zawiera 50 testów, które przy zapotrzebowaniu Zamawiającego będzie zużyta z pewnością dużo szybciej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza akumulatory pozwalające na wykonanie 40 oznaczeń po pełnym naładowaniu oraz glukometry wykonujące pomiary z próbek krwi żyłnej i pełnej krwi tętnicznej.

2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający biorąc pod uwagę bezpieczeństwo personelu medycznego wymaga zaoferowania glukometrów wyposażonych w wyrzutnik pasków testowych? Ta funkcja jest dostępna nawet w najprostrzych glukometrach wykorzystywanych do samokontroli poziomu glikemii.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga glukometrów wyposażonych w wyrzutnik pasków testowych.

3. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oceni równocześnie z cechą: „Objętość próbki nie więcej niż 0,6 ul” system wykonujący pomiar w czasie 6 sekund?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ocenianego parametru.

4. W zakresie wymagania nr 12 dotyczącego Systemu nadzorującego badania POCT: „Wykonawca zobligowany jest dostarczyć licencje dostępne na urządzenia, odpowiednie dla dostarczonego systemu serwerowego w najnowszej występującej wersji jeżeli licencjonowanie systemu serwerowego tego wymaga. Ilość licencji dostępnych: 7”

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający w celu ograniczenia kosztów wyrazi zgodę na udostępnienie miejsca na serwerze szpitalnym potrzebnego do instalacji, uruchomienia i backupowania oferowanego systemu nadzorującego badania POCT? Oferowany system nadzoru ma niewielkie wymagania: 2,5 GHz, 8 GB pamięci, 80 GB miejsca na dysku oraz MS Server 2016 lub MS Server 2012, R2 64 BIT.

Odpowiedź: Do uruchomienia maszyny wirtualnej z Windows Server w naszym środowisku wirtualnym niezbędny jest zakup licencji. Wymagana ilość licencji to 6 x 12 czyli 72 licencje na rdzenie procesorów i licencja bazowa Windows Server. Nie dopuszczamy zastosowania Windows Server 2012 R2 w naszym środowisku serwerowym. Producent zakończył wsparcie tego oprogramowania 23 października 2023 r.

PYTANIE NR 2

Pytanie nr 1

Dotyczy: zał. nr 2.0 – tabela „Materiały zużywalne” poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę o objętości 0,5-1.0mL do pobierania krwi do badań gazometrycznych?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na strzykawki o objętości 0,5-1.0mL do pobierania krwi do badań gazometrycznych.

Pytanie nr 2

Dotyczy: zał. nr 2.0 – tabela „Materiały zużywalne” poz. nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kapilar o objętości 70ul do pobierania krwi z tętnicy?

Odpowiedź: Tak zamawiający wyraża zgodę na kapilary o objętości 70ul do pobierania krwi z tętnicy.

Pytanie nr 3

Dotyczy: zał. nr 2.1 – „Opis parametrów wymaganych” pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści analizator z codzienną automatyczną kalibracją tHb, w którym min. raz na 6 miesięcy wymagana jest jednorazowa kalibracja hemoglobiny (kalibracja widma) za pomocą kalibratora zewnętrznego? Kalibracja ta nie jest uciążliwa dla użytkownika, ponieważ całkowity proces kalibracji trwa nie dłużej niż 1 minutę i wykonywany jest przez autoryzowany serwis producenta podczas rutynowego przeglądu okresowego raz na 6 miesięcy, tym samym w żaden sposób nie obciąża Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści analizator z codzienną automatyczną kalibracją tHb, w którym min. raz na 6 miesięcy wymagana jest jednorazowa kalibracja hemoglobiny za pomocą kalibratora zewnętrznego. Kalibracja będzie wykonywana przez autoryzowany serwis producenta w czasie rutynowego przeglądu okresowego raz na 6 miesięcy.

PYTANIE NR 3

1. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 2 załącznika 1F. asortymentowo-cenowego:

W celu wyspecyfikowania niezbędnych materiałów prosimy o doprecyzowanie czy ww oznaczenie będzie wykonywane w moczu i PMR ?

Odpowiedź: Oznaczenia nie będą wykonywane w moczu ani w PMR.

2. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 40 załącznika 1F. asortymentowo-cenowego:

Czy Zamawiający wymaga aby metoda oznaczania prokalcytoniny była wystandaryzowana wobec metody referencyjnej BRAHMS PCT, co umożliwi wykorzystanie do interpretacji wyników punktów odcięcia do diagnostyki sepsy ustalonych dla wszystkich testów oznaczających prokalcytoninę w oparciu o licencję i standaryzację Brahms PCT?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby metoda oznaczania pro kalcytoniny była wystandaryzowana wobec metody referencyjnej BRAHMS PCT.

3. Dotyczy: Zadanie nr 1 F. asortymentowo-cenowego - tabela III - Akcesoria i materiały eksploatacyjne do laboratoryjnego systemu informatycznego

Prosimy do tabeli dotyczącej wyliczenia oferty cenowej dla karty zleceń dodanie kolumny z "Liczba opakowań na 36 m-cy".

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w związku z powyższym dokonuje modyfikacji w Załączniku nr 1.0 Zadanie nr 1 F. asortymentowo-cenowego - tabela III poprzez dodanie kolumny „Liczba opakowań na 36 m - cy” .

4. Dotyczy załącznika nr 1.4 pkt 3

Czy zamawiający uzna za spełniony warunek w sytuacji pozostawienia sprzętu ostatnio dostarczonego na podstawie mijającej umowy ?

Odpowiedź: Tak jeżeli sprzęt i oprogramowanie spełniają wszystkie wymagania specyfikacji. Przypominamy, że wsparcie systemu operacyjnego Windows 10 kończy się 14 października 2025.

5. Pytanie dot. zał 1.4 pkt 20

Czy zamawiający zgodzi się na korzystanie przez wykonawcę z rozwiązania tożsamego z dostarczanym analizatorem tj.



Oferowany system wymaga do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS. Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu ?

Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analyzerów).


URL	IP	Port	Typ	Description
*.navify.com	193.58.155.0/24	443	CloudFlare	Main connections enabling Remote Service
*.navify.com	193.228.103.0/24	433 (514/541)	CloudFlare	Current/future setup using Cloudflare
remoteservice.roche.com	62.209.44.11	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas1.roche.com	62.209.44.21	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas2.roche.com	62.209.44.22	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas3.roche.com	209.202.167.19	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas4.roche.com	209.202.167.20	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas5.roche.com	120.136.45.231	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas6.roche.com	120.136.45.230	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas15.roche.com	35.76.193.4	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas16.roche.com	52.193.219.53	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
rln-cm-*.dia.roche.com	52.178.37.238	514 / 541	Direct	Dedicated connections enabling FortiGate management
teleservice.roche.com	196.3.50.39	443 / 80	HTTP	Dedicated connection to TSN
remoteservice-dr.roche.com	209.202.167.21	443	Direct	Axeda Disaster Recovery

Odpowiedź: Tak jeżeli będzie realizowane przez tunel IPsec na urządzeniu Zamawiającego.

6. Dotyczy załącznik 1.1 pkt. 22.

Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS, serwisu zdalnego oraz dostępu do internetu ?

Oferowane analizatory oraz systemy wymagają do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o odczytnikach, kontrolach, kalibratorach, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS. Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analyzerów).

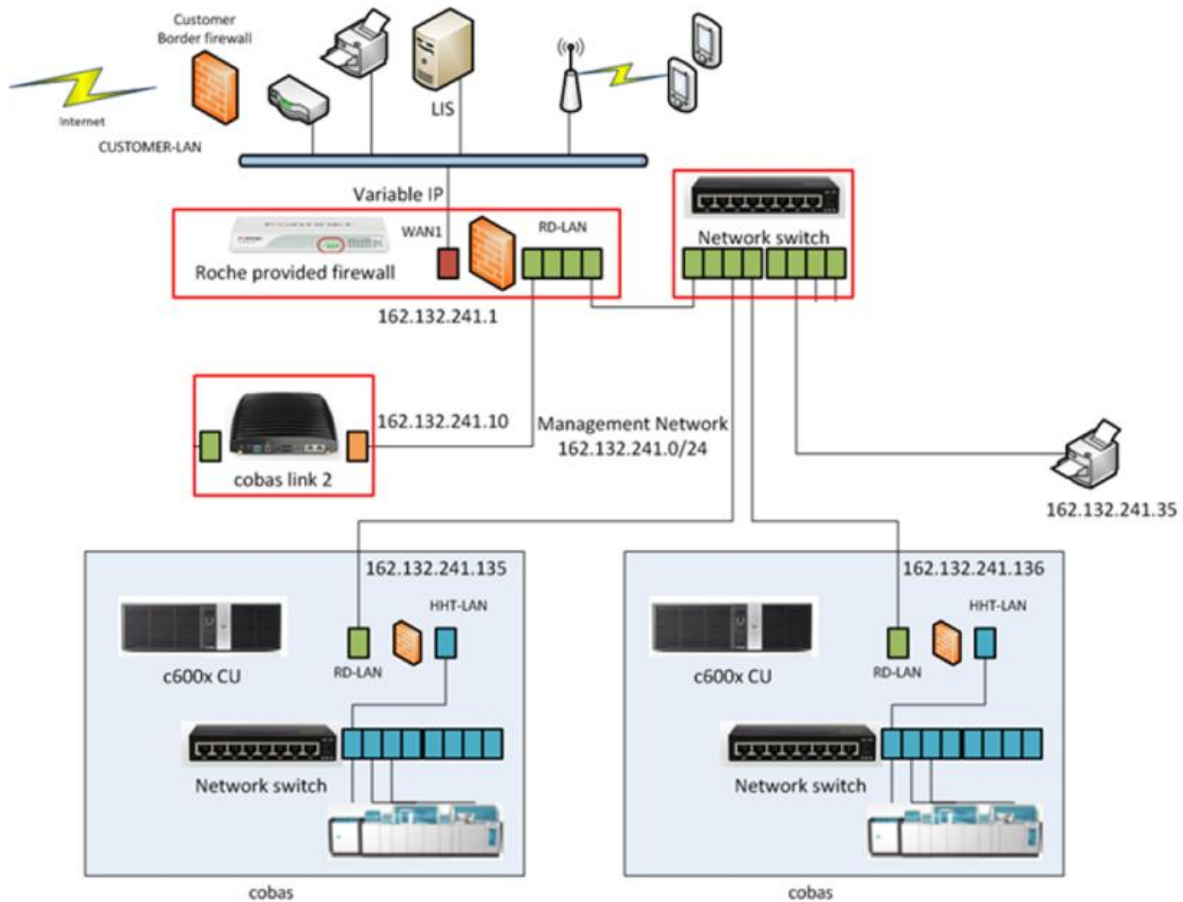

URL	IP	Port	Typ	Description
*.navify.com	193.58.155.0/24	443	CloudFlare	Main connections enabling Remote Service
*.navify.com	193.228.103.0/24	433 (514/541)	CloudFlare	Current/future setup using Cloudflare
remoteservice.roche.com	62.209.44.11	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas1.roche.com	62.209.44.21	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas2.roche.com	62.209.44.22	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas3.roche.com	209.202.167.19	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas4.roche.com	209.202.167.20	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas5.roche.com	120.136.45.231	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas6.roche.com	120.136.45.230	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas15.roche.com	35.76.193.4	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
remoteservice-gas16.roche.com	52.193.219.53	443	Direct	Dedicated connections enabling Remote Support
rln-cm-*.dia.roche.com	52.178.37.238	514 / 541	Direct	Dedicated connections enabling FortiGate management
teleservice.roche.com	196.3.50.39	443 / 80	HTTP	Dedicated connection to TSN
remoteservice-dr.roche.com	209.202.167.21	443	Direct	Axeda Disaster Recovery

Odpowiedź: Tak jeżeli będzie realizowane przez tunel IPsec na urządzeniu Zamawiającego.

Dotyczy wzoru umowy:

zał. nr 4.2 - projekt umowy - dostawa odczynników - zadanie 2

1. par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie sformułowania " posiadających informację w języku polskim" z niniejszego postanowienia?



Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych m.in. etykiety i instrukcje używania wyrobów medycznych przeznaczonych dla użytkowników innych niż laicy mogą być wyrażone w języku polskim lub języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w par. 2 ust. 1 Projektu umowy poprzez dodanie „lub w języku angielskim”.

2. par. 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)? Uzasadnienie: Składanie zamówień przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

Odpowiedź: Brak zgody, zgodnie z Projektem umowy.

3. par. 2 ust. 10 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź: Brak zgody, zgodnie z Projektem umowy.

4. par. 2 ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych? Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słów “dni kalendarzowych” na “dni robocze”?

Odpowiedź: Brak zgody, zgodnie z Projektem umowy.

5. par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze”?

Odpowiedź: : Brak zgody, zgodnie z Projektem umowy.

6. par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę usunięcie niniejszego postanowienia? Ewentualnie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie: “z przyczyn zwinionych przez Wykonawcę”?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za naprawienie szkody, która jest następstwem nienależytego wykonania umowy, jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź: Brak zgody, zgodnie z Projektem umowy. Odpowiedzialność na zasadach ogólnych KC.

7. par. 5 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dokumenty wskazane w niniejszym postępowaniu zostały dostarczone w formie elektronicznej i podać adres mailowy, na który można dokumenty wysłać?

Odpowiedź: Brak zgody, zgodnie z Projektem umowy.

8. par. 6 ust.1 lit. c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zwinionych przez Wykonawcę”?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Ponadto, Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna była liczona od „niezrealizowanej wartości umowy brutto”? Specyfika realizacji przedmiotu Umowy, polegającego na świadczeniu ciągłym, przez okres ustalony w kontrakcie, czyni nieuzasadnionym naliczanie kar, w stosunku do wartości globalnej umowy, w sytuacji, gdy Zamawiający nie ma uwag do umowy w części wykonanej do daty wypowiedzenia. W przeciwnym razie kara umowna powinna zostać uznana za wygórowaną zgodnie z art. 484 k.c.

Odpowiedź: Brak zgody, zgodnie z Projektem umowy.

9. par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź: Brak zgody, zgodnie z Projektem umowy.

10. par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze”?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w par.6 ust. 3 Projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:



„ 3. Kary umowne będą płatne na podstawie przesłanej przez Zamawiającego noty obciążeniowej w terminie 7 dni **kalendaryzowych** od dnia jej wystawienia.”

11. par. 6 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych wynosiła 10% wartości umowy?

Odpowiedź: Brak zgody, zgodnie z Projektem umowy.

12. par. 9 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia, tak aby wynagrodzenie, o którym mowa w §4 ust. 1, mogło się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy? Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sformułowania “i nie częściej niż raz w okresie trwania umowy” na “nie częściej niż co 3 miesiące”?

W projekcie umowy, zawarto postanowienia przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Zostały one jednak sformułowane w taki sposób, że w przypadku umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce niemożliwa z uwagi na to, że jej warunki wstępne nie mogą zaistnieć lub będzie miała pomijalną wartość. Takie sformułowanie postanowień powoduje, że mają one pozorny charakter, a zatem ich umieszczenie stanowi obejście normy wynikającej z art. 439 Prawa zamówień publicznych, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych.

Odpowiedź: Brak zgody, zgodnie z Projektem umowy.

par. 10 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami rozdziału XX pkt 2 SWZ Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

zał. nr 5.1 - projekt umowy dzierżawy - zadanie 1

1. par. 1 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dokumenty wskazane w niniejszym postępowaniu zostały dostarczone w formie elektronicznej i podać adres mailowy, na który można dokumenty wysłać?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w związku z powyższym modyfikuje zał. nr 5.1,5.2,5.3 - projekt umowy dzierżawy, który otrzymuje brzmienie:

„6. Wydzierżawiający gwarantuje, że urządzenia stanowiące przedmiot dzierżawy są wolne od wad i posiadają świadectwo rejestracji dopuszczające do obrotu na terenie RP, na dowód czego przedstawi stosowne dokumenty w formie papierowej lub elektronicznej na adres labolatorium@onkologia.opole.pl lub za pomocą platformy zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/928338>.”

2. par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy urządzeń do 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy bezpośrednio od producenta oraz mając na uwadze skomplikowane procedury celne z tym związane, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy w zaproponowany w sposób.

Odpowiedź: Brak zgody, zgodnie z Projektem umowy.

3. Ponadto, Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci Zamawiającego (LIS) oferowanych urządzeń do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Uzasadnienie: Z uwagi na długie terminy realizacji podłączeń urządzeń przez dostawcę Państwa systemu LIS, które nie są zależne od nas jako Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. par. 5 ust. 1 lit. d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5-dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź: Brak zgody, zgodnie z Projektem umowy.

5. par. 5 ust. 1 lit. e) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie:



Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odpowiedź: Brak zgody, zgodnie z Projektem umowy.

6. par. 5 ust. 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź: Brak zgody, zgodnie z Projektem umowy.

7. par. 5 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy w par. 5 ust. 8 Projektu umowy dzierżawy poprzez dodanie słowa „kalendarzowych**”.**

8. par. 5 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych wynosiła 10% wartości umowy?

Odpowiedź: Brak zgody, zgodnie z Projektem umowy.

9. par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia, tak aby wynagrodzenie, o którym mowa w §3 ust. 2, mogło się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy? Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sformułowania “i nie częściej niż raz w okresie trwania umowy” na “nie częściej niż co 3 miesiące”?

W projekcie umowy, zawarto postanowienia przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Zostały one jednak sformułowane w taki sposób, że w przypadku umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce niemożliwa z uwagi na to, że jej warunki wstępne nie mogą zaistnieć lub będzie miała pomijalną wartość. Takie sformułowanie postanowień powoduje, że mają one pozorny charakter, a zatem ich umieszczenie stanowi obejście normy wynikającej z art. 439 Prawa zamówień publicznych, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych.

Odpowiedź: Brak zgody, zgodnie z Projektem umowy.

10. par. 6 ust. 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami rozdziału XX pkt 2 SWZ Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

11. **brak regulacji w umowie:** Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź: W przypadku umów, w których SP ZOZ OCO w Opolu jest administratorem obowiązujący jest wzór Zamawiającego. W związku z tym nie wyrażamy zgody na zastosowanie wzoru umowy Wykonawcy.

Zamawiający modyfikuje terminy wskazane w SWZ poprzez:

- 1) zmianę w Załączniku nr 1.0 F..asortymentowo-cenowy – Zadanie nr 1
- 2) zmianę w Załączniku nr 4.1,4.2,4.3 Projekt umowy
- 3) zmianę w Załączniku nr 5.1,5.2,5.3 Projekt umowy dzierżawy
- 4) zmianę w SWZ

Zamawiający modyfikuje zapisy



Termin składania ofert: ~~27.06.2024r. godz. 12:00~~ na **02.07.2024r. godz. 12:00**
Termin otwarcia ofert: ~~27.06.2024r. godz. 12:05~~ na **02.07.2024r. godz. 12:05**
Termin związania ofertą upływa w dniu: ~~24.09.2024r.~~ na **29.09.2024 r.**

Opracowały:

A Pardej
A. Gratkowska
M. Grotkiewicz
K. Wojdyła
B. Kopec

Zatwierdził:

Dyrektor
SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
Marek Staszewski
/dokument podpisany elektronicznie/