

Wadowice, dnia 14.08.2019r

znak: ZP/PRZET/UE/1/34/2019

**Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  
przetargowym na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego  
dla ZZOZ w Wadowicach**

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla ZZOZ w Wadowicach, znak: ZP/PRZET/UE/1/2019, na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r, poz. 1986 ze zm.) informuję, że najkorzystniejszą ofertę w zakresie Pakietów nr 1, 3, 8 złożyła firma:

**Pakiet nr 1**

**MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen® Group, ul. Majowa 2, 71-374 Szczecin** Wartość oferty brutto: 74 412,00 zł, która wg kryterium: „cena 60%” uzyskała: 60 pkt, w kryterium parametry dodatkowe przedmiotu zamówienia 40% uzyskała: 100 pkt. Łączna liczba uzyskanych punktów: 100 pkt.

**Pakiet nr 3**

**RADIOMETER Sp.zo.o., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa** Wartość oferty brutto: 33 480,00 zł, która wg kryterium: „cena 60%” uzyskała: 60 pkt, w kryterium okres gwarancji 20% uzyskała: 20 pkt., w kryterium termin dostawy 20% uzyskała: 20 pkt Łączna liczba uzyskanych punktów: 100 pkt.

**Pakiet nr 8**

**Przedsiębiorstwo Zaopatrzenie Lecznictwa CEZAL Lublin Sp.zo.o., Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin** Wartość oferty brutto: 13 178,82 zł, która wg kryterium: „cena 60%” uzyskała: 60 pkt, w kryterium okres gwarancji 20% uzyskała: 20 pkt., w kryterium termin dostawy 20% uzyskała: 20 pkt Łączna liczba uzyskanych punktów: 100 pkt.

*Dziękujemy za złożenie ofert.*

Ponadto w postępowaniu zostały złożone oferty firm:

**Pakiet nr 1**

**1. Lubmedical Sp. z o. o. Sp. k. ul. Anny Walentynowicz 34, 20-328 Lublin**, Wartość oferty brutto: 88 200,29 zł, która wg kryterium: „cena 60%” uzyskała: 50,62 pkt, w kryterium „okres gwarancji 40%” uzyskała: 40,00 pkt. Łączna liczba uzyskanych punktów: 90,62 pkt.

**2. KLASTMED Grzegorz Żuchnik, ul. Pogodna 50Alok. 7,20-337 Lublin**, która podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp, ponieważ wadium nie zostało wniesione.

Uzasadnienie: Zgodnie z warunkami wskazanymi w Rozdziale XI SIWZ, Wykonawcy byli zobowiązani do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, który został ostatecznie wyznaczony na 17.04.2019r godzina 10:00. Jednocześnie Zamawiający zacytował, iż wadium wnoszone w pieniądzu, wykonawcy powinni wpłacać na rachunek bankowy Zamawiającego a wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Z analizy dokumentacji księgowej Zamawiającego wynika, że Wykonawca nie wniósł wadium. Zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7b ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeśli Zamawiający żądał wniesienia wadium. Wykonawca



ponosi zatem wszelkie ryzyko związane ze skutecznością dostarczenia Zamawiającemu wadium. W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b ustawy Pzp.

**3. Has-Med Sp.z o.o., ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała**, która podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie: Zamawiający w Formularzu ofertowym w poz 20 zamieścił Tabelę, w której Wykonawca winien wskazać oferowane parametry, nazwę, producenta, modelu/typ Wykonawca w złożonej ofercie nie uzupełnił w/w Tabeli. Nieuzupełnienie Tabeli powoduje, iż treść oferty jest niepełna i nie odpowiada treści SIWZ. Tabela ma zobowiązaniowy charakter, Wykonawca w sposób definitywny deklaruje w niej zaferowanie sprzętu i wyposażenia o podanych parametrach. W związku z tym dane podane w Tabeli nie mają jedynie informacyjnego charakteru, a stanowią element oświadczenia woli Wykonawcy niezbędnego do późniejszego zweryfikowania dostarczonego sprzętu i wyposażenia. Tabela zawarta w Formularzu ofertowym nie należy do kategorii oświadczeń i dokumentów podlegających uzupełnieniu w rozumieniu art. 26 ust 3 w związku z art. 25 ust 1 ustawy Pzp. Co do zasady nie jest również możliwe dokonywanie zmian w treści oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust 1a i 2 ustawy Pzp. Możliwość nowych treści oferty, uprzednio w niej niezawartych wyłącza również procedura wynikająca z art. 26 ust 4 ustawy Pzp (tak w wyroku KIO z 14.02.2013r KIO226/13, z 11.02.2013r. KIO 224/13, z 07.02.2013 KIO 140/13) Zdaniem Zamawiającego, należy mieć na uwadze fakt, że nie wolno uzupełniać na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp dokumentów, których treść stanowi treść oferty. Pod pojęciem treści oferty w ocenie Zamawiającego należy rozumieć deklarowane w ofercie spełnienie wymagań Zamawiającego przed wszystkim co do zakresu, jakości, warunków realizacji, parametrów i innych istotnych elementów dla wykonania zamówienia. W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp albowiem jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### **Pakiet nr 3**

**Werfen Polska Sp. z o.o., ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa**, która podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie: Zgodnie z pkt 12 załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający wymagał: „*Dwukierunkowa transmisja danych. Przyłączenie do sieci tak aby był przesył wyników pacjenta bezpośrednio do karty choroby oraz wyników codziennej kontroli jakości, celem monitorowania i weryfikowania ich przez Diagnostów w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej*”.

Niezgodność Państwa oferty z SIWZ przejawia się w zasadniczym aspekcie.

Opisy, które znajdują się na stronie numer 1 i 2 wyjaśnień Werfen Polska sp. z o.o. przesłanych w dniu 04.06.2019 roku w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień z dnia 31.05.2019 roku dotyczą analizatora GEM Premier 3500, zaferowanego w postępowaniu: „Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla ZZOZ w Wadowicach”, znak postępowania: ZP/PRZET/UE/1/2019. Natomiast wszystkie rysunki oraz zdjęcia zamieszczone we wskazanym dokumencie, na których można by zweryfikować opis zamieszczony w wyjaśnieniach, dotyczy urządzenia GEM Premier 3000, który nie jest przedmiotem oferty złożonej w tym postępowaniu. Z informacji zamieszczonej na oficjalnej stronie internetowej Werfen Polska sp. z o.o. (<http://pl.werfen.com>), do której podano odniesienie w treści oferty wynika, iż GEM Premier 3500 i GEM Premier 3000 to dwa zupełnie odrębne urządzenia.



Home Werfen Produkty Kontakt Szukaj na stronie

Werfen Polska Produkty Kontakt

▶ Koagulologia Laboratoryjny System Informatyczny  
 ▶ Parametry krytyczne  
 ▶ Chemia kliniczna  
 ▶ Choroby autoimmunizacyjne  
 ▶ Choroby zakaźne

Home > Produkty > Parametry krytyczne > Analizatory > GEM Premier 3500

▶ Analizatory  
 ▶ Systemy nadzoru informatycznego  
 ▶ Inteligentny System Zarządzania Jakością  
 ▶ GEM Premier 4000  
 ▶ **GEM Premier 3500**  
 ▶ GEM Premier 3000  
 ▶ GEM OPL

**GEM Premier 3500**  
z IQM

Opis Specyfikacje

GEM Premier 3500 skonstruowany na bazie bezobsługowego i niezawodnego analizatora GEM Premier 3000, oferuje nowe możliwości systemu oraz adaptacji do potrzeb szpitali i laboratoriów.

- Prosty – bezobsługowy, wyposażony w wieloletową kasety jednorazowego użytku, intuicyjne oprogramowanie oraz łatwy w obsłudze ekran dotykowy,
- Możliwość doboru wielkości kasety oraz menu oznaczeń oraz przenoszenia aparatu w różne lokalizacje,
- IQM - zastrzeżone rozwiązanie Instrumentation Laboratory, system automatycznej kontroli jakości w czasie rzeczywistym, dodatkowo wykrywający błędy oraz dokonujący czynności naprawczych,
- Oprogramowanie GEMweb – pozwalające na zdalne zarządzanie informacjami oraz komunikację z analizatorem w czasie rzeczywistym.

\* automatyczne oświetlenie pola aspiracji próbki



Home Werfen Produkty Kontakt Szukaj na stronie

Werfen Polska Produkty Kontakt

▶ Koagulologia Laboratoryjny System Informatyczny  
 ▶ Parametry krytyczne  
 ▶ Chemia kliniczna  
 ▶ Choroby autoimmunizacyjne  
 ▶ Choroby zakaźne

Home > Produkty > Parametry krytyczne > Analizatory > GEM Premier 3000

▶ Analizatory  
 ▶ Systemy nadzoru informatycznego  
 ▶ Inteligentny System Zarządzania Jakością  
 ▶ GEM Premier 4000  
 ▶ GEM Premier 3500  
 ▶ **GEM Premier 3000**  
 ▶ GEM OPL

**GEM Premier 3000**

Opis Specyfikacje

Standard w diagnostyce parametrów krytycznych

GEM Premier 3000 upraszcza diagnostykę parametrów krytycznych w każdym aspekcie zapewniając maksymalnie krótki czas oznaczenia oraz wiarygodne wyniki zarówno w laboratorium jak i przy łóżku chorego.


- Wieloletowa kaseta jednorazowego użytku zawiera wszystkie elementy zużywalne niezbędne do wykonania oznaczeń tj.: sensory, roztwory, pojemnik na ścieki oraz sondę aspirującą,
- Bezobsługowy - jedynie wymiana kasety raz na trzy tygodnie,
- IQM - zastrzeżone rozwiązanie Instrumentation Laboratory, automatyczna kontrola jakości w czasie rzeczywistym przeprowadzająca ciągły monitoring analizy próbki,
- GEMweb oprogramowanie zapewniające zdalny dostęp do wyników i wszelkich informacji dotyczących analizatora,




Poniżej przedstawiamy fragmenty Państwa pisma z dnia 4 czerwca 2019 roku z zaznaczonymi kolorem czerwonym nazwami urządzenia, które nie jest przedmiotem Państwa oferty.




Rys. 5.12: Ekran „wykres Delta Chart” (iQM Delta Chart)

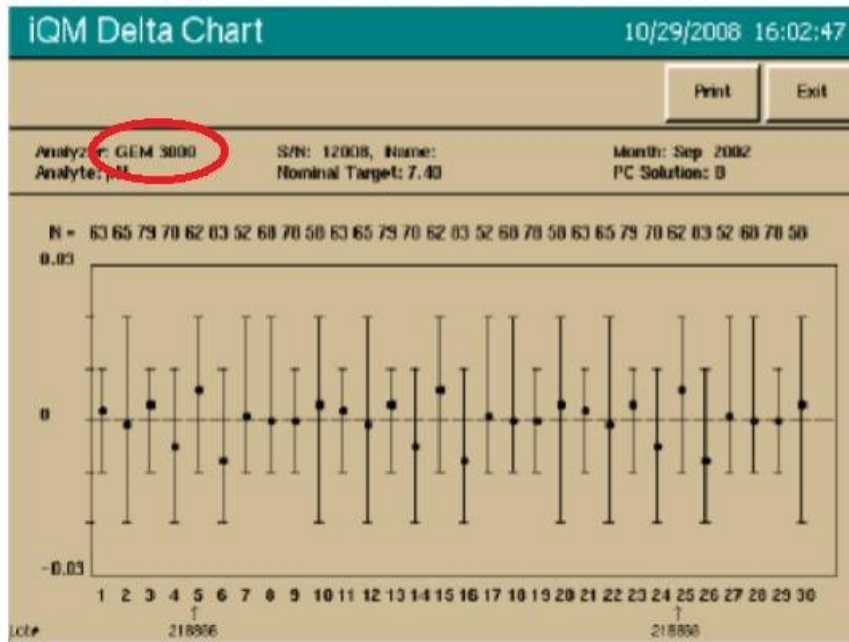


Rys. 5.13: „raport działań korygujących iQM” (corrective action report)

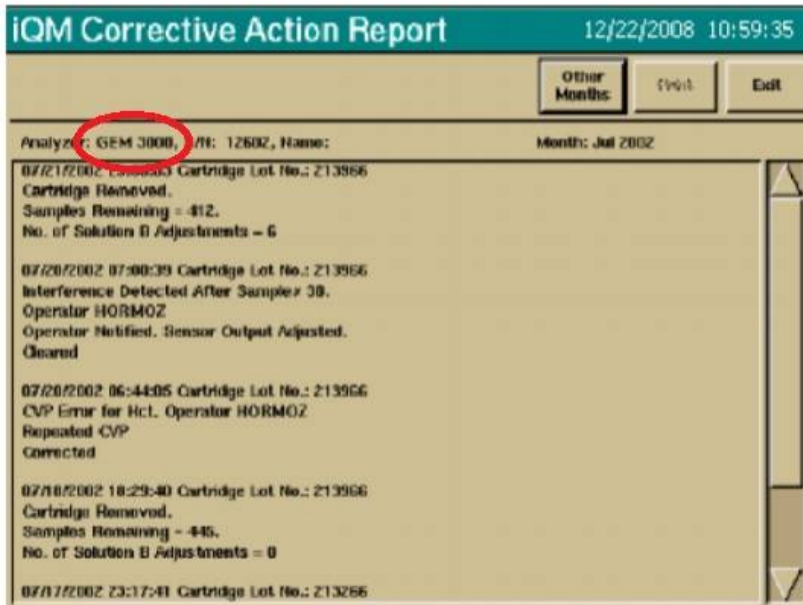

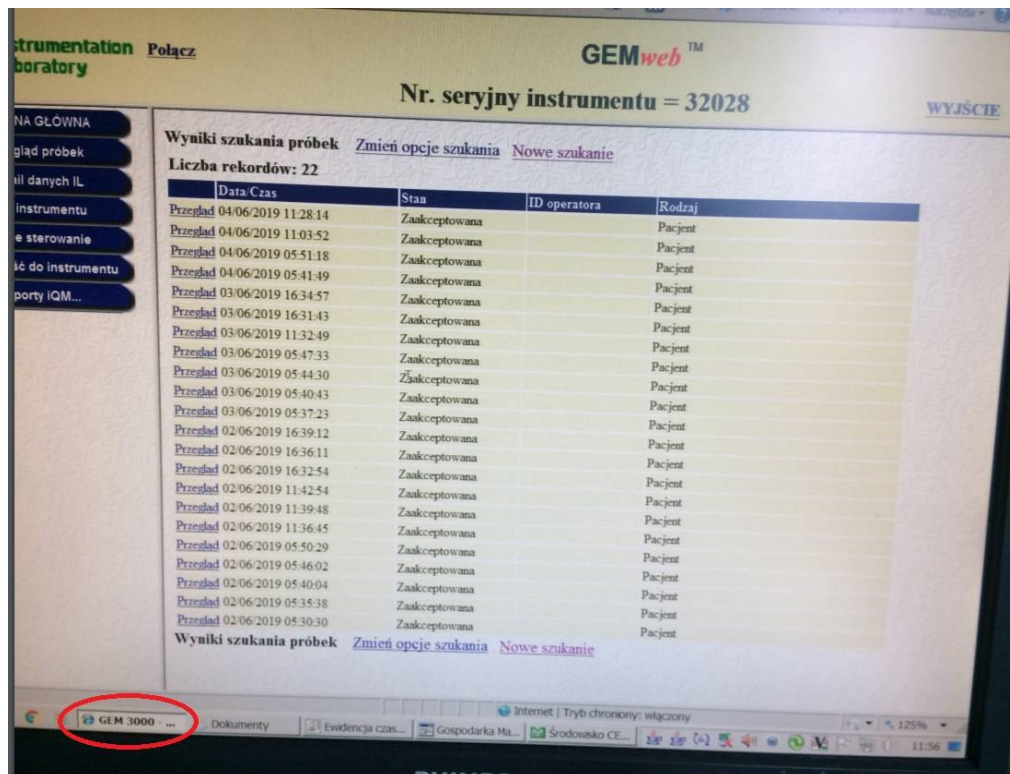

W związku z powyższym należy podkreślić, że Rys. 5.12: Ekran „wykres Delta Chart” (iQM Delta CHart) Rys. 5.13: „raport działań korygujących iQM”(corrective action report), oraz zdjęcia oprogramowania GEMWeb nie dotyczą analizatora GEM Premier 3500.

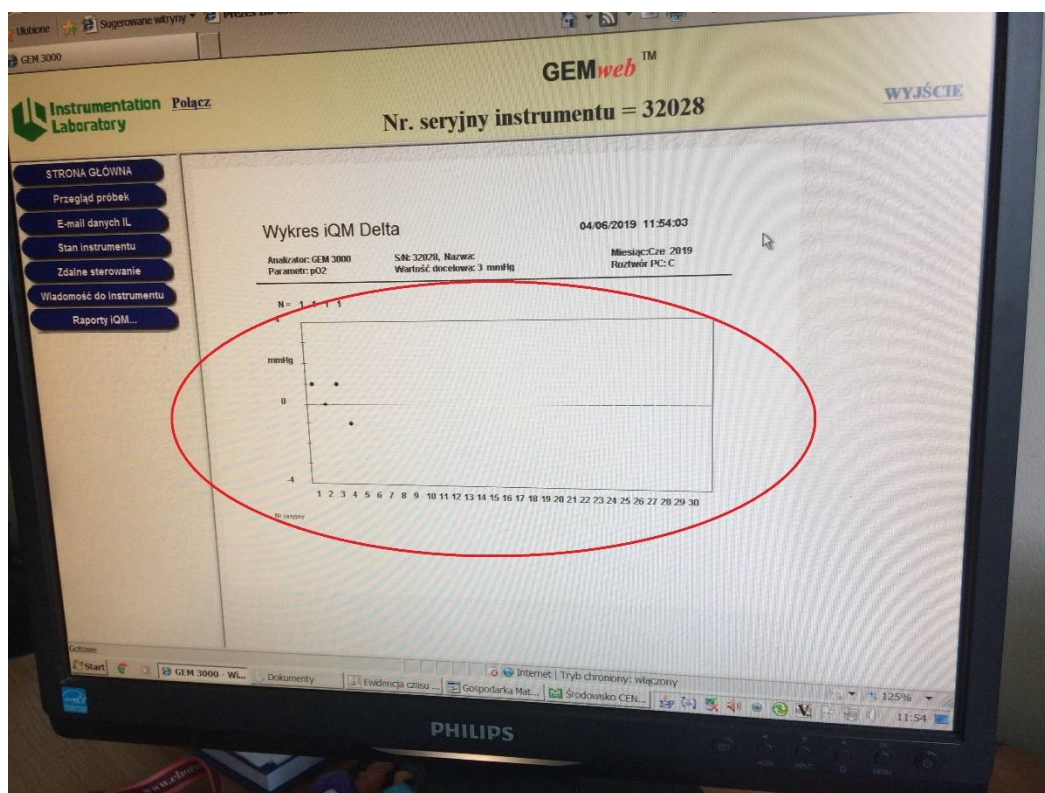

Dodatkowo, zdjęcie z oprogramowania GEMWeb „Wykres iQM Delta”, na którym pokazane są wyniki kontroli jakości z okresu od 1 do 4 czerwca 2019 roku, w żaden sposób nie przypominają schematycznego wykresu Delta Chart z Rys. 5.12: Ekran „wykres Delta Chart” (iQM Delta CHart). Na załączonym wykresie dla pierwszych czterech dni widoczne są jedynie cztery kropki. Zauważamy brak wszystkich



atrybutów wykresu iQM Delta Chart, tak skrupulatnie opisanych na stronie 29 Podręcznika użytkownika.

#### Składniki wykresu Delta Chart

Punkty danych wykreslane dla każdego dnia to:

- Minimalna różnica pomiędzy docelową wartością i rzeczywistą zmierzoną wartością roztworu kontroli dla wybranego analitu każdego dnia.
- Maksymalna różnica pomiędzy docelową wartością i rzeczywistą zmierzoną wartością roztworu kontroli dla wybranego analitu każdego dnia.
- Średnia różnica pomiędzy docelową wartością i rzeczywistą zmierzoną wartością roztworu kontroli dla wybranego analitu każdego dnia.




Uwaga: punkty różnic (delta) iQM dla 12 poprzednich miesięcy są przechowywane przez urządzenie i mogą być wykreslane w dowolnej chwili. Te dane są zbierane i przechowywane tylko gdy kasetka jest zainstalowana.

Wykreslane będą trzy punkty delta, jak pokazano na rys. 5.12:

- krótka pozioma linia wskazuje punkty minimum i maksimum
- pogrubiona kropka oznacza średnią różnicę
- pionowa linia łączy wszystkie trzy punkty.

Rys. 5.12: Ekran „wykres Delta Chart” (iQM Delta Chart)

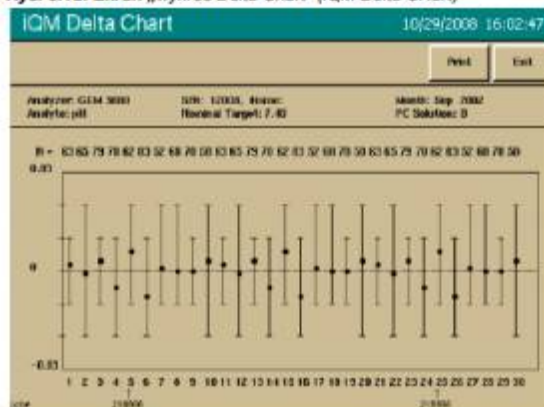

Punkty delta, które znajdują się na zewnątrz wyznaczonych granic dla danego parametru będą zawarte w „raporcie działań korygujących iQM”.

Liczby punktów delta dla danego dnia pokazano w górnej części wykresu (Rys. 5.12.) Jeśli liczba punktów przekracza 99, pokazane będzie 99.

Oś X wykresu pokazuje liczbę dni miesiąca.

Oś Y wykresu pokazuje granice różnic wykreslanego analitu, wyśrodkowane na zero.

Z załączonego zdjęcia z systemu GEMWeb należy wnosić, że nie ma możliwości uznania tego wyniku za wynik kontroli jakości, ponieważ nie posiada żadnych wartości średnich, ani granicznych. Na wykresie tym nie można doszukać się również żadnych zakresów skrajnych (min, max), do których można by odnieść uzyskane wyniki. Trudno zatem uznać, że wynik, który to można zobaczyć w oprogramowaniu GEMWeb spełnia jakiegokolwiek wymagania stawiane wynikom kontroli jakości.

Pomimo zapewnień złożonych w wyjaśnieniach, Werfen Polska sp. z o.o. nie przedstawił żadnych dowodów, a jednocześnie potwierdził Zamawiającemu, że nie spełnia parametru technicznego opisanego w pkt 12 załącznika nr 1 do SIWZ: „Dwukierunkowa transmisja danych. Przyłączenie do sieci tak aby był przesył wyników pacjenta bezpośrednio do karty choroby oraz wyników codziennej kontroli jakości, celem monitorowania i weryfikowania ich przez Diagnostów w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej”.

Dodatkowo Werfen Polska sp. z o.o. dnia 14.06.2019r został wezwany do wyjaśnień dotyczących szczegółowego opisu w jaki sposób będą wyglądały wyniki codziennej kontroli jakości przesłane przez analizator GEM Premier 3500 na podstawie dwukierunkowej transmisji danych LIS do Diagnostów w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej. W odpowiedzi z dnia 18.06.2019 roku Werfen Polska sp. z o.o. tłumaczy, że Zamawiający stawiając kropkę pomiędzy „Dwukierunkowa transmisja danych”,



a „Przyłączenie do sieci tak aby był przesył wyników pacjenta bezpośrednio do karty choroby oraz wyników codziennej kontroli jakości, celem monitorowania i weryfikowania ich przez Diagnostów w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej” podzielił parametr techniczny na dwie oddzielne sentencje. Zamawiający stawiając kropkę, nie wyznaczył tym samym kolejnego parametru technicznego jak tłumaczy Werfen Polska sp. z o.o.. Gdyby Zamawiający chciał wyodrębnić dwukierunkową transmisję danych, zamieściłby ten parametr techniczny oddzielnie, w kolejnym wierszu tabeli, w kolejnym podpunkcie. Przesył wyników kontroli jakości oraz przesył wyników pacjentów ma odbywać się w ramach dwukierunkowej transmisji danych co jest dokładnie sprecyzowane w podpunkcie 12. Oznacza to, iż podpunkt 12 stanowi spójną całość i jest to podpunkt krytyczny, którego niespełnienie powoduje odrzucenie oferty. Zamawiający dokładnie określił jak należy podłączyć analizator: „Przyłączenie do sieci tak aby był przesył wyników pacjenta bezpośrednio do karty choroby”. System GEMWeb nie umożliwia przesyłu wyników pacjenta bezpośrednio do karty choroby pacjenta, ponieważ jest to osobne oprogramowanie, nie jest ono kompatybilne z kartą choroby pacjenta.

Zamawiający precyzyjnie określił, że Wykonawca ma podłączyć analizator poprzez dwukierunkową transmisję danych, oraz, że wyniki mają trafiać do karty choroby pacjenta oraz wyniki kontroli jakości do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej. Zrealizować takie założenie można tylko w jeden sposób a to jest przez podłączenie analizatora do systemu LIS.

Z przedstawionych wyjaśnień również wynika, że Werfen Polska sp. z o.o. ma możliwość podłączenia analizatora do systemu LIS, ale jednocześnie wskazuje, że Zamawiający nie określił jaką sieć LIS posiada oraz nie określił jej właściwości. Otóż jeżeli Wykonawca miał jakiegokolwiek wątpliwości co do posiadanej sieci LIS przez Zamawiającego mógł zadać pytanie do przetargu, czego Werfen Polska sp. z o.o. nie uczynił. Werfen Polska sp. z o.o. składając ofertę potwierdził, że zapoznał się ze wszystkimi zapisami SIWZ i nie ma co do żadnego z zapisów wątpliwości.

Zamawiający nie precyzuje w jaki sposób wyniki kontroli zostaną wysłane przez analizator, ponieważ Zamawiający nie zna uwarunkowań technicznych poszczególnych producentów analizatorów. Natomiast ponad wszelką wątpliwość Zamawiający sprecyzował, że wyniki kontroli jakości uzyskiwane z analizatora w systemie LIS się pojawiają.

Dodatkowo, żadna sieć LIS nie jest w stanie przyjąć wyniku kontroli jakości w formie wykresu, jak Państwo proponują w wyjaśnieniach. W posiadanym przez Zamawiającego systemie Centrum firmy Marcel, przyjmowane są tylko wyniki kontroli jakości w postaci liczbowej. System Centrum nie przyjmuje żadnej innej formy kontroli jakości. Informacja o systemie LIS posiadanym przez Zamawiającego jest informacją jawną i w trakcie prowadzonego postępowanie system ten nie uległ zamianie na inny. W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp albowiem jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### **Pakietu nr 8**

**L.P.W. „Romar” Roman Marciniak, ul. Kilińskiego 12, 63-00 Środa Wielkopolska oraz Has-Med Sp.z o.o., ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała**, która podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie: Zamawiający w Formularzu ofertowym w poz 20 zamieścił Tabelę, w której Wykonawca winien wskazać oferowane parametry, nazwę, producenta, modelu/typ Wykonawca w złożonej ofercie nie uzupełnił w/w Tabeli. Nieuzupełnienie Tabeli powoduje, iż treść oferty jest niepełna i nie odpowiada treści SIWZ. Tabela ma zobowiązaniowy charakter, Wykonawca w sposób definitywny deklaruje w niej



zaoferowanie sprzętu i wyposażenia o podanych parametrach. W związku z tym dane podane w Tabeli nie mają jedynie informacyjnego charakteru, a stanowią element oświadczenia woli Wykonawcy niezbędnego do późniejszego zweryfikowania dostarczonego sprzętu i wyposażenia. Tabela zawarta w Formularzu ofertowym nie należy do kategorii oświadczeń i dokumentów podlegających uzupełnieniu w rozumieniu art. 26 ust 3 w związku z art. 25 ust 1 ustawy Pzp. Co do zasady nie jest również możliwe dokonywanie zmian w treści oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust 1a i 2 ustawy Pzp. Możliwość nowych treści oferty, uprzednio w niej niezawartych wyłącza również procedura wynikająca z art. 26 ust 4 ustawy Pzp (tak w wyroku KIO z 14.02.2013r KIO226/13, z 11.02.2013r. KIO 224/13, z 07.02.2013 KIO 140/13) Zdaniem Zamawiającego, należy mieć na uwadze fakt, że nie wolno uzupełniać na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp dokumentów, których treść stanowi treść oferty. Pod pojęciem treści oferty w ocenie Zamawiającego należy rozumieć deklarowane w ofercie spełnienie wymagań Zamawiającego przed wszystkim co do zakresu, jakości, warunków realizacji, parametrów i innych istotnych elementów dla wykonania zamówienia. W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp albowiem jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 informuję, że termin podpisania umowy określa się na dzień **27.08.2019r.** w siedzibie Zamawiającego.

*Z upoważnienia Dyrektor  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wadowicach*

*Renata Mikołajczyk  
Główny Księgowy  
Jacek Pławecki  
p.o Zastępca Dyrektor ds. Lecznictwa*