

znak: D25C/252/N/12-19rj/22

Wejherowo, dnia 10.06.2022 r.

D.25C/250/450/2022

wg rozdzielnika

I. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na: **ZAKUP WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHOROBY CYWILIZACYJNYCH POPRZEC ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE**, znak: D25C/252/N/12-19rj/22, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści ofertę na dostawę stojaków na kroplówki (zadanie nr 4) z pięcioramiennymi podstawami z obniżonym środkiem ciężkości na kółkach z bieżnikiem gumowym o średnicy 75 mm w obudowie ze stali kwasoodpornej OH18N9, 2 kółka z blokadą, (parametr lepszy od oczekiwanego) – dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 4 poz. 3 pkt 3 i poz. 4 pkt 3.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Zadania nr 6 – Wózki reanimacyjne, anestezjologiczne, wózki na leki, pozycji nr 1 Wózek reanimacyjny ze stali lakierowanej proszkowo – 1 sztuka, do osobnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w związku z nadchodzącym letnim okresem urlopowym, a co za tym idzie przerwami produkcyjnymi u producentów, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji na 6 tygodni, z możliwością wcześniejszej dostawy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 6 Pozycji nr 2 (Wózek reanimacyjny) Punkt 5 Szuflady formowane wtryskowo, plastikowe z zaokrąglonymi krawędziami. I wnętrzem oraz wbudowanymi uchwytami i mocowaniami na etykiety w kolorze czerwonym (taka jest sugestia producenta w tym modelu wózka).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 6 Pozycji nr 3 (Wózek anestezjologiczny) Punkt 5 Szuflady formowane wtryskowo, plastikowe z zaokrąglonymi krawędziami i wnętrzem oraz wbudowanymi uchwytami i mocowaniami na etykiety w kolorze niebieskim 3 uchwyty i w kolorze zielonym 1 uchwyt (taka jest sugestia producenta w tym modelu wózka).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 6 Pozycji nr 4 (Wózek anestezjologiczny podwójny) Punkt 5 Szuflady formowane wtryskowo, plastikowe z zaokrąglonymi krawędziami i wnętrzem oraz wbudowanymi uchwytami i mocowaniami na etykiety w kolorze niebieskim 6 uchwytów i w kolorze zielonym 2 uchwyty (taka jest sugestia producenta w tym modelu wózka).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu nr 6 Pozycji nr 5 (Wózek anestetyczny podwójny dla perfuzji) Punkt 5 Szuflady formowane wtryskowo, plastikowe z zaokrąglonymi krawędziami i wnętrzem oraz wbudowanymi uchwyty i mocowaniami na etykiety w kolorze niebieskim 6 uchwytów i w kolorze zielonym 2 uchwyty (taka jest sugestia producenta w tym modelu wózka).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w kółka fi 100mm? – dotyczy l.p. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1

Z uwagi na fakt, że stół roboczy nie jest wyrobem medycznym, gdyż w swojej funkcjonalności nie wypełnia definicji wyrobu medycznego zawartej w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych czy Zamawiający uzna za wystarczające przedłożenie zamiast:

- deklaracji CE – atest PZH wydanego przez niezależną jednostkę, potwierdzający przeznaczenie stołu do stosowania w jednostkach służby zdrowia?
- certyfikatu producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 – certyfikat PN EN ISO 9001? – dotyczy l.p. 5, 6, 7, 8

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z wymogu Deklaracji zgodności CE oraz Certyfikatu producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) dla produktów z Zadania 1 poz. 5, 6, 7, 8.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wykonanego w całości (podstawa, konstrukcja, uchwyt, kosze) ze stali nierdzewnej niemalowanej? – dotyczy l.p. 9

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w kółka fi 80 lub 100mm w obudowie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SWZ (ocynk już po krótkim okresie użytkowania, po zetknięciu z substancjami myjąco-dezynfekującymi rdzewieje)? – dotyczy l.p. 9, 10

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1

Z uwagi na fakt, że wózek koszowy nie jest wyrobem medycznym, gdyż w swojej funkcjonalności nie wypełnia definicji wyrobu medycznego zawartej w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych czy Zamawiający uzna za wystarczające przedłożenie zamiast:

- deklaracji CE – atest PZH wydanego przez niezależną jednostkę, potwierdzający przeznaczenie wyrobu do stosowania w jednostkach służby zdrowia?
- certyfikatu producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 – certyfikat PN EN ISO 9001? – dotyczy l.p. 9, 10

Odpowiedź Zamawiającego:

znak: D25C/252/N/12-19rj/22

Zamawiający rezygnuje z wymogu Deklaracji zgodności CE oraz Certyfikatu producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) dla produktów z Zadania 1 poz. 9, 10.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konstrukcji wykonanej z profili zamkniętych zamiast rurek? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego w SWZ. – **dotyczy l.p. 9, 10**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie innych równoważnych rozwiązań mocowania półek koszowych np. haczyki, kształtowniki? – **dotyczy l.p. 9, 10**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

15. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 3

Z uwagi na fakt, że stolik na korbę nie jest wyrobem medycznym, gdyż w swojej funkcjonalności nie wypełnia definicji wyrobu medycznego zawartej w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych czy Zamawiający uzna za wystarczające przedłożenie zamiast:

- deklaracji CE – atest PZH wydanego przez niezależną jednostkę, potwierdzający przeznaczenie stolika do stosowania w jednostkach służby zdrowia?

- certyfikatu producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 – certyfikat PN EN ISO 9001? – **dotyczy l.p. 2**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z wymogu Deklaracji zgodności CE oraz Certyfikatu producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) dla produktów z Zadania 3 poz. 2.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o wymiarach 1270x600x1000/1400mm? Długość z korbą 1400mm. – **dotyczy l.p. 2**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w kółka fi 80 w obudowie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SWZ (ocynk już po krótkim okresie użytkowania, po zetknięciu z substancjami myjąco-dezynfekującymi rdzewieje)? – **dotyczy l.p. 2**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika typu przyjaciel wykonanego ze stali nierdzewnej (stelaż, podstawa, blat), z frontem malowanym proszkowo w kolorze białym? – **dotyczy l.p. 3**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika bez regulacji wysokości? – **dotyczy l.p. 3**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Zapytanie Wykonawcy:

znak: D25C/252/N/12-19rj/22

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika wyposażonego w kółka fi 80 w obudowie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SWZ (ocynk już po krótkim okresie użytkowania, po zetknięciu z substancjami myjąco-dezynfekującymi rdzewieje)? – **dotyczy l.p. 3**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

21. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 3

Z uwagi na fakt, że stolik typu przyjaciel nie jest wyrobem medycznym, gdyż w swojej funkcjonalności nie wypełnia definicji wyrobu medycznego zawartej w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych czy Zamawiający uzna za wystarczające przedłożenie zamiast:

- deklaracji CE – atest PZH wydanego przez niezależną jednostkę, potwierdzający przeznaczenie stolika do stosowania w jednostkach służby zdrowia?

- certyfikatu producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 – certyfikat PN EN ISO 9001? – **dotyczy l.p. 3**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z wymogu Deklaracji zgodności CE oraz Certyfikatu producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) dla produktów z Zadania 3 poz. 3.

22. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka z zakresem regulacji 1200/2150mm? – **dotyczy l.p. 1, 2, 3, 4**


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

23. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka z podstawą fi 560 mm ze stali nierdzewnej w kształcie litery A, z możliwością dokowania (ustawienia jeden pod drugim), co ułatwia transport i magazynowanie. – **dotyczy l.p. 1, 2, 3, 4**

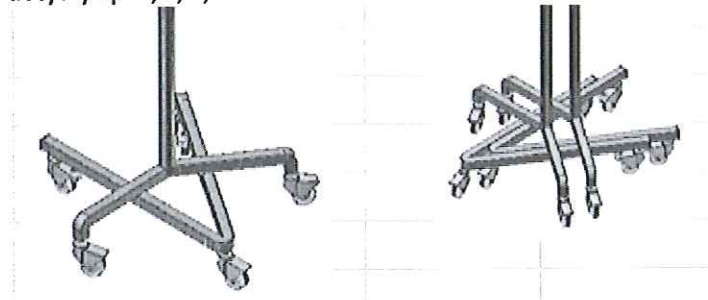

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka wyposażonego w rurę wysuwaną z kolumny (ale nie teleskopowo), z możliwością zablokowania na dowolnej wysokości? – **dotyczy l.p. 3, 4**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

25. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka wyposażonego w kółka fi 50 lub 80mm? – **dotyczy l.p. 3, 4**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

26. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podestu o konstrukcji wykonanej z profili zamkniętych (nóżki podestu) oraz blachy pokrytej paskami antypoślizgowymi (stopnie podestu)? – **dotyczy l.p. 1, 2, 3, 4**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

27. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 5

Z uwagi na fakt, że podest nie jest wyrobem medycznym, gdyż w swojej funkcjonalności nie wypełnia definicji wyrobu medycznego zawartej w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych czy Zamawiający uzna za wystarczające przedłożenie zamiast:

- deklaracji CE – atest PZH wydanego przez niezależną jednostkę, potwierdzający przeznaczenie podestu do stosowania w jednostkach służby zdrowia?
- certyfikatu producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 – certyfikat PN EN ISO 9001? – **dotyczy l.p. 1, 2, 3, 4**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z wymogu Deklaracji zgodności CE oraz Certyfikatu producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) dla produktów z Zadania 5 poz. 1, 2, 3, 4.

28. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 5

Z uwagi na fakt, że wieszak nie jest wyrobem medycznym, gdyż w swojej funkcjonalności nie wypełnia definicji wyrobu medycznego zawartej w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych czy Zamawiający uzna za wystarczające przedłożenie zamiast:

- deklaracji CE – atest PZH wydanego przez niezależną jednostkę, potwierdzający przeznaczenie podestu do stosowania w jednostkach służby zdrowia?
- certyfikatu producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 – certyfikat PN EN ISO 9001? – **dotyczy l.p. 5, 6**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z wymogu Deklaracji zgodności CE oraz Certyfikatu producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) dla produktów z Zadania 5 poz. 5, 6.

29. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy terminów realizacji pakietów 1, 3, 4, 5

Z uwagi na problemy z dostępnością surowców spowodowane aktualną ogólnoswiatową sytuacją (wojna na Ukrainie) i wydłużonymi terminami dostaw na podzespoły do mebli, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 49 dni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

30. Zapytanie Wykonawcy:

dot. SWZ, pkt XVI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY – dot. zadania 1-6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą potwierdzenie że zapis wskazanego punktu jest zapisem standardowym w SWZ Zamawiającego, natomiast szczegółowy zakres zamówienia określa umowa i w każdym przypadku gdy nie wymaga ona określonych czynności Zamawiający odstąpi od ich wymagania, tak na przykład od wymogu instalacji i montażu oraz szkolenia personelu Zamawiającego, z względu na fakt iż przedmiot zamówienia opisany we wskazanych zadaniach, dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego, a do zapoznania się wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

31. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ

znak: D25C/252/N/12-19rj/22

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że celem weryfikacji spełniania przez dany asortyment wymogów określonych w SWZ załącznik nr 6, będzie wymagał załączenia do oferty stosownego certyfikatu producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważnego).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza. Szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych do oferty zawiera rozdz. VIII SIWZ i tylko takie dokumenty Wykonawca załącza na etapie składania ofert. Pozostałe dokumenty, o których mowa w innych miejscach SIWZ Wykonawca będzie przedstawiał na etapie realizacji umowy.

32. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wózek stalowy malowany farbami proszkowymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

33. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami stalowymi, lakierowanymi proszkowo, z uchwytami typu C montowanymi na froncie szuflady?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

34. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 2

Czy Zamawiający wózek o wymiarach 770x570x1000mm wysokość z nadstawką 1700mm (szerokośćxgłębokośćxwysokość)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

35. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami o wysokości: 2szuflady 97mm, 1 szuflada 156mm, 2 szuflady 175mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

36. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wóze. 6 poz. 2 pkt 18k z uchwytem na butle bez możliwości regulacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

37. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wózek o wadze 70kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

38. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wózek stalowy malowany farbami proszkowymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

39. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami stalowymi, lakierowanymi proszkowo, z uchwytami typu C montowanymi na froncie szuflady?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

40. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 3

Czy Zamawiający wózek o wymiarach 670x570x1000mm (szerokośćxgłębokośćxwysokość)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

41. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami o wysokości : 3szuflady 140mm, 1 szuflada 234mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

42. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w uchwyt z miseczką okrągłą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

43. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojemnik na sprzęt dezynfekujący, bez wewnętrznego koszyka do odciekania, pojemnik w kolorze białym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

44. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wózek stalowy malowany farbami proszkowymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

45. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami stalowymi, lakierowanymi proszkowo, z uchwytami typu C montowanymi na froncie szuflady?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

46. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 4

Czy Zamawiający wózek o wymiarach 1270x570x1000mm (szerokośćxgłębokośćxwysokość)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

47. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wózek z podstawą stalowa, z osłona z tworzywa ABS, odpornego na uderzenia i zadrapania, łatwego w myciu i dezynfekcji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

48. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami o wysokości : 3 + 3 szuflady 140mm, 1 + 1 szuflada 234mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

49. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w uchwyt z miseczką okrągłą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

50. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojemnik na sprzęt dezynfekujący , bez wewnętrznego koszyka do odciekania, pojemnik w kolorze białym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

51. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wózek stalowy malowany farbami proszkowymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

52. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami stalowymi, lakierowanymi proszkowo, z uchwytami typu C montowanymi na froncie szuflady?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

53. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 5

Czy Zamawiający wózek o wymiarach 1270x570x1000mm (szerokośćxgłębokośćxwysokość

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

54. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 5

znak: D25C/252/N/12-19rj/22

Czy Zamawiający dopuści wózek z podstawą stalowa, z osłona z tworzywa ABS, odpornego na uderzenia i zadrapania, łatwego w myciu i dezynfekcji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

55. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami o wysokości : 3 + 3 szuflady 140mm, 1 + 1 szuflada 234mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

56. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści półki mocowane na w nadstawce bez przegrody?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza półki mocowane w nadstawce bez przegrody.

57. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści uchwyt na miskę okrągło zamiast uchwytu na nerkę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

58. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany ze stali malowanej proszkowo, z blatem z ABS, z uchwytami stalowymi, wymiary wózka 670x570x1000mm, wysokość bez kół 875 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

59. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem i uchwytem bocznym wykonanym ze stali?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

60. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści wózek z dwoma półkami wyposażonymi w tace na 40 kiliszków, bez wsówek na opis?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

61. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 660x430x890mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

62. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji stalowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

63. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści wózek bez wysuwanej kuwety na dole?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

64. Zapytanie Wykonawcy:

dot. załącznik nr 6 do SWZ- zadanie 6

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 570x550x900mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

65. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 1. Fartuch ochronny RTG jednostronny – rozmiar M – 2 szt.

Pkt.1

W związku z różnym ciężarem mieszanek bezołowiowych na rynku dochodzącym nawet do 5,9 kg/m² przy ekwiwalencie ołowiu 0,5mmPb prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał aby osłony radiologiczne były wykonane z ultralekkiego materiału bezołowiowego, którego ciężar nie przekracza 5,3kg/m² przy ekwiwalencie ołowiu 0,5mmPb.

Powyższy parametr gwarantuje otrzymanie przez Zamawiającego jednych z najłżejszych osłon na rynku oraz spełnienia wymogu fartuchów z materiału ultralekkiego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących ciężaru mieszanek bezołowiowych i dopuszcza każde rozwiązanie w powyższym zakresie.

66. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 1. Fartuch ochronny RTG jednostronny – rozmiar M – 2 szt.

Pkt.6

Prosimy o dopuszczenie materiału zewnętrznego z powłoką poliuretanową zapewniającą łatwą do czyszczenia powierzchnię, aby uniknąć plam i zapewnić wysokie standardy higieny – dostępne w 10 kolorach oraz materiał zewnętrzny z dodatkową powłoką, który tworzy łatwą do czyszczenia powierzchnię odporną na zabrudzenia – dostępna w 4 kolorach, materiał zewnętrzny do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

67. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 1. Fartuch ochronny RTG jednostronny – rozmiar M – 2 szt.

Pkt.7

Czy Zamawiający będzie wymagał aby osłony tarczycy były przypinane do kamizelek za pomocą paska z zatrzaskiem.

Powyższe rozwiązanie znacząco ułatwia przechowywanie osłon tarczycy przy czym nie krępuje ruchów w trakcie użytkowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie precyzuje wymagań i dopuszcza każde rozwiązanie w powyższym zakresie.

68. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 1. Fartuch ochronny RTG jednostronny – rozmiar M – 2 szt.

Pkt.7

Prosimy o dopuszczenie osłon tarczycy o długości 63cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

69. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 1. Fartuch ochronny RTG jednostronny – rozmiar M – 2 szt.

Pkt.12

Czy Zamawiający będzie wymagał aby gwarancja wynosiła 36 miesięcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis punktu 12, który otrzymuje brzmienie:

„Gwarancja minimum 12 miesięcy”.

70. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 2. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar S – 5 szt.

Pkt.1

W związku z różnym ciężarem mieszanek bezołowiowych na rynku dochodzącym nawet do 5,9 kg/m² przy ekwiwalencie ołowiu 0,5mmPb prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał aby osłony radiologiczne były wykonane z ultralekkiego materiału bezołowiowego, którego ciężar nie przekracza 5,3kg/m² przy ekwiwalencie ołowiu 0,5mmPb.

Powyższy parametr gwarantuje otrzymanie przez Zamawiającego jednych z najłżejszych osłon na rynku oraz spełnienia wymogu fartuchów z materiału ultralekkiego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących ciężaru mieszanek bezołowiowych i dopuszcza każde rozwiązanie w powyższym zakresie.

71. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 2. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar S – 5 szt.

Pkt.3

Prosimy o podanie jaką ochronność kamizelki oraz spódnicę mają mieć z tyłu. Stopień ochronności fartucha wpływa na jego cenę. Prosimy o dopuszczenie rozmiarów mierzonych po obwodzie klatki piersiowej, pasa oraz bioder użytkownika tj. dla rozmiaru S: rekomendowany obwód klatki piersiowej: 92-97cm, długość 55cm oraz spódnicy rekomendowany obwód pasa (talii) 68-72cm, bioder 93-97cm, długość 50cm. Możliwość personalizacji długości spódnicy od 50cm do 70cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż ochrona radiologiczna opisana w pkt. 3 dotyczy całego produktu (tzn. przód i tył). W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

72. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 2. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar S – 5 szt.

Pkt.6

Prosimy o dopuszczenie kamizelki zapewniającej odciążenie kręgosłupa za pomocą wbudowanych elastycznych pasów, dopasowanie kamizelki za pomocą nakładających się paneli tylnych, zapinanych elastycznymi pasami na rzepy z przodu, kamizelka posiadająca poduszki łagodzące nacisk na barki, równoważnik osłabienia promieniowania : przód 0,5mmPb, tył 0,25mmPb.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

73. Zapytanie Wykonawcy:



znak: D25C/252/N/12-19rj/22

ZADANIE 7

Poz. 2. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar S – 5 szt.

Pkt.7

Czy Zamawiający będzie wymagał aby spódnice były wyposażone we wszyty szeroki pas odciążający zapinany na rzep?

Powyższe rozwiązania ułatwia zakładanie spódnicy oraz odciąża użytkownika poprzez dokładne rozłożenie ciężaru spódnicy na szerokim pasie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

74. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 2. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar S – 5 szt.

Pkt.8

Prosimy o dopuszczenie zakładki w kamizelce na obwodzie spódnicy o szerokości min. 10 cm zapewniająca dodatkową ochronę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

75. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 2. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar S – 5 szt.

Pkt.9

Prosimy o dopuszczenie materiału zewnętrznego z powłoką poliuretanową zapewniającą łatwą do czyszczenia powierzchnię, aby uniknąć plam i zapewnić wysokie standardy higieny – dostępne w 10 kolorach oraz materiał zewnętrzny z dodatkową powłoką, który tworzy łatwą do czyszczenia powierzchnię odporną na zabrudzenia – dostępna w 4 kolorach, materiał wewnętrzny do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

76. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 2. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar S – 5 szt.

Pkt.10

Czy Zamawiający będzie wymagał aby osłony tarczycy były przypinane do kamizelek za pomocą paska z zatraskiem.

Powyższe rozwiązanie znacząco ułatwia przechowywanie osłon tarczycy przy czym nie krępuje ruchów w trakcie użytkowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie precyzuje wymagań i dopuszcza każde rozwiązanie w powyższym zakresie.

77. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 2. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar S – 5 szt.

Pkt.10

Prosimy o dopuszczenie osłon tarczycy o długości 63cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

78. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 2. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar S – 5 szt.

Pkt.12

Czy Zamawiający będzie wymagał aby gwarancja wynosiła 36 miesięcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis punktu 12, który otrzymuje brzmienie:



„Gwarancja minimum 12 miesięcy”.

79. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 3. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar M – 6 szt.

Pkt.1

W związku z różnym ciężarem mieszanek bezołowiowych na rynku dochodzącym nawet do 5,9 kg/m² przy ekwiwalencie ołowiu 0,5mmPb prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał aby osłony radiologiczne były wykonane z ultralekkiego materiału bezołowiowego, którego ciężar nie przekracza 5,3kg/m² przy ekwiwalencie ołowiu 0,5mmPb.

Powyższy parametr gwarantuje otrzymanie przez Zamawiającego jednych z najłżejszych osłon na rynku oraz spełnienia wymogu fartuchów z materiału ultralekkiego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących ciężaru mieszanek bezołowiowych i dopuszcza każde rozwiązanie w powyższym zakresie.

80. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 3. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar M – 6 szt.

Pkt.3

Prosimy o podanie jaką ochronność kamizelki oraz spódnicy mają mieć z tyłu. Stopień ochronności fartucha wpływa na jego cenę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż ochrona radiologiczna opisana w pkt. 3 dotyczy całego produktu (tzn. przód i tył).

81. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 3. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar M – 6 szt.

Pkt.4

Prosimy o dopuszczenie rozmiarów mierzonych po obwodzie klatki piersiowej, pasa oraz bioder użytkownika tj. dla rozmiaru M: rekomendowany obwód klatki piersiowej: 98-107cm, długość 60cm oraz spódnicy rekomendowany obwód pasa (talii) 73-78cm, bioder 98-103cm, długość 60cm. Możliwość personalizacji długości spódnicy od 50cm do 70cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

82. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 3. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar M – 6 szt.

Pkt.7

Prosimy o dopuszczenie kamizelki zapewniającej odciążenie kręgosłupa za pomocą wbudowanych elastycznych pasów, dopasowanie kamizelki za pomocą nakładających się paneli tylnych, zapinanych elastycznymi pasami na rzepy z przodu, kamizelka posiadająca poduszki łagodzące nacisk na barki, równoważnik osłabienia promieniowania : przód 0,5mmPb, tył 0,25mmPb.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

83. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7


Poz. 3. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar M – 6 szt.

Pkt.8

Czy Zamawiający będzie wymagał aby spódnice były wyposażone we wszyty szeroki pas odciążający zapinany na rzepy?

Powyższe rozwiązania ułatwia zakładanie spódnicy oraz odciąża użytkownika poprzez dokładne rozłożenie ciężaru spódnicy na szerokim pasie.

Odpowiedź Zamawiającego:





Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

84. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 3. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar M – 6 szt.

Pkt.9

Prosimy o dopuszczenie zakładki w kamizelce na obwodzie spódnicy o szerokości min. 10 cm zapewniająca dodatkową ochronę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

85. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 3. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar M – 6 szt.

Pkt.10

Prosimy o dopuszczenie materiału zewnętrznego z powłoką poliuretanową zapewniającą łatwą do czyszczenia powierzchnię, aby uniknąć plam i zapewnić wysokie standardy higieny – dostępne w 10 kolorach oraz materiał zewnętrzny z dodatkową powłoką, który tworzy łatwą do czyszczenia powierzchnię odporną na zabrudzenia – dostępna w 4 kolorach, materiał zewnętrzny do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

86. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 3. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar M – 6 szt.

Pkt.11

Czy Zamawiający będzie wymagał aby osłony tarczycy były przypinane do kamizelek za pomocą paska z zatrzaskiem.

Powyższe rozwiązanie znacząco ułatwia przechowywanie osłon tarczycy przy czym nie krępuje ruchów w trakcie użytkowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie precyzuje wymagań i dopuszcza każde rozwiązanie w powyższym zakresie.

87. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 3. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar M – 6 szt.

Pkt.11

Prosimy o dopuszczenie osłon tarczycy o długości 63cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

88. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 3. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar M – 6 szt.

Pkt.13

Czy Zamawiający będzie wymagał aby gwarancja wynosiła 36 miesięcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis punktu 13, który otrzymuje brzmienie:

„Gwarancja minimum 12 miesięcy”.

89. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 4. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar L – 6 szt.

Pkt.1

W związku z różnym ciężarem mieszanek bezołowiowych na rynku dochodzącym nawet do 5,9 kg/m² przy ekwiwalencie ołowiu 0,5mmPb prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał aby osłony

radiologiczne były wykonane z ultralekkiego materiału bezołowiowego, którego ciężar nie przekracza 5,3kg/m² przy ekwiwalencji ołowiu 0,5mmPb.

Powyższy parametr gwarantuje otrzymanie przez Zamawiającego jednych z najniższych osłon na rynku oraz spełnienia wymogu fartuchów z materiału ultralekkiego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących ciężaru mieszanek bezołowiowych i dopuszcza każde rozwiązanie w powyższym zakresie.

90. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 4. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar L – 6 szt.

Pkt.3

Prosimy o podanie jaką ochronność kamizelki oraz spódniczki mają mieć z tyłu. Stopień ochronności fartucha wpływa na jego cenę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż ochrona radiologiczna opisana w pkt. 3 dotyczy całego produktu (tzn. przód i tył).

91. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 4. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar L – 6 szt.

Pkt.4

Prosimy o dopuszczenie rozmiarów mierzonych po obwodzie klatki piersiowej, pasa oraz bioder użytkownika tj. dla rozmiaru L: rekomendowany obwód klatki piersiowej: 108-113cm, długość 65cm oraz spódniczki rekomendowany obwód pasa (talii) 79-84cm, bioder 104-109cm, długość 60cm. Możliwość personalizacji długości spódniczki od 50cm do 70cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

92. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 4. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar L – 6 szt.

Pkt.7

Prosimy o dopuszczenie kamizelki zapewniającej odciążenie kręgosłupa za pomocą wbudowanych elastycznych pasów, dopasowanie kamizelki za pomocą nakładających się paneli tylnych, zapinanych elastycznymi pasami na rzepy z przodu, kamizelka posiadająca poduszki łagodzące nacisk na barki, równoważnik osłabienia promieniowania : przód 0,5mmPb, tył 0,25mmPb.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

93. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 4. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar L – 6 szt.

Pkt.8

Czy Zamawiający będzie wymagał aby spódniczki były wyposażone we wszyty szeroki pas odciążający zapinany na rzepy?

Powyższe rozwiązania ułatwia zakładanie spódniczki oraz odciąża użytkownika poprzez dokładne rozłożenie ciężaru spódniczki na szerokim pasie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

94. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 4. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar L – 6 szt.

Pkt.9

Prosimy o dopuszczenie zakładki w kamizelce na obwodzie spódniczki o szerokości min. 10 cm zapewniająca dodatkową ochronę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

95. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 4. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar L – 6 szt.

Pkt.10

Prosimy o dopuszczenie materiału zewnętrznego z powłoką poliuretanową zapewniającą łatwą do czyszczenia powierzchnię, aby uniknąć plam i zapewnić wysokie standardy higieny – dostępne w 10 kolorach oraz materiał zewnętrzny z dodatkową powłoką, który tworzy łatwą do czyszczenia powierzchnię odporną na zabrudzenia – dostępna w 4 kolorach, materiał zewnętrzny do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

96. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 4. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar L – 6 szt.

Pkt.11

Czy Zamawiający będzie wymagał aby osłony tarczycy były przypinane do kamizelek za pomocą paska z zatrzaskiem.

Powyższe rozwiązanie znacząco ułatwia przechowywanie osłon tarczycy przy czym nie krępuje ruchów w trakcie użytkowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie precyzuje wymagań i dopuszcza każde rozwiązanie w powyższym zakresie.

97. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 4. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar L – 6 szt.

Pkt.11

Prosimy o dopuszczenie osłon tarczycy o długości 63cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

98. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 4. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar L – 6 szt.

Pkt.13

Czy Zamawiający będzie wymagał aby gwarancja wynosiła 36 miesięcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis punktu 13, który otrzymuje brzmienie:

„Gwarancja minimum 12 miesięcy”.

99. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 5. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar XL – 2 szt.

Pkt.1

W związku z różnym ciężarem mieszanek bezołowiowych na rynku dochodzącym nawet do 5,9 kg/m² przy ekwiwalencie ołowiu 0,5mmPb prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał aby osłony radiologiczne były wykonane z ultralekkiego materiału bezołowiowego, którego ciężar nie przekracza 5,3kg/m² przy ekwiwalencie ołowiu 0,5mmPb.

Powyższy parametr gwarantuje otrzymanie przez Zamawiającego jednych z najlżejszych osłon na rynku oraz spełnienia wymogu fartuchów z materiału ultralekkiego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących ciężaru mieszanek bezołowiowych i dopuszcza każde rozwiązanie w powyższym zakresie.

100. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 5. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar XL – 2 szt.

Pkt.3

Prosimy o podanie jaką ochronność kamizelki oraz spódnicę mają mieć z tyłu. Stopień ochronności fartucha wpływa na jego cenę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż ochrona radiologiczna opisana w pkt. 3 dotyczy całego produktu (tzn. przód i tył).

101. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 5. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar XL – 2 szt.

Pkt.4

Prosimy o dopuszczenie rozmiarów mierzonych po obwodzie klatki piersiowej, pasa oraz bioder użytkownika tj. dla rozmiaru XL: rekomendowany obwód klatki piersiowej: 114-120cm, długość 65cm oraz spódnicę rekomendowany obwód pasa (talii) 91-97cm, bioder 116-122cm, długość 70cm. Możliwość personalizacji długości spódnicy od 50cm do 70cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

102. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 5. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar XL – 2 szt.

Pkt.7

Prosimy o dopuszczenie kamizelki zapewniającej odciążenie kręgosłupa za pomocą wbudowanych elastycznych pasów, dopasowanie kamizelki za pomocą nakładających się paneli tylnych, zapinanych elastycznymi pasami na rzepy z przodu, kamizelka posiadająca poduszki łagodzące nacisk na barki, równoważnik osłabienia promieniowania : przód 0,5mmPb, tył 0,25mmPb.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

103. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 5. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar XL – 2 szt.

Pkt.8

Czy Zamawiający będzie wymagał aby spódnicę były wyposażone we wszyty szeroki pas odciążający zapinany na rzep?

Powyższe rozwiązania ułatwia zakładanie spódnicy oraz odciąża użytkownika poprzez dokładne rozłożenie ciężaru spódnicy na szerokim pasie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

104. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 5. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar XL – 2 szt.

Pkt.9

Prosimy o dopuszczenie zakładki w kamizelce na obwodzie spódnicy o szerokości min. 10 cm zapewniająca dodatkową ochronę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

105. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 5. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar XL – 2 szt.

Pkt.10

Prosimy o dopuszczenie materiału zewnętrznego z powłoką poliuretanową zapewniającą łatwą do czyszczenia powierzchnię, aby uniknąć plam i zapewnić wysokie standardy higieny – dostępne w 10 kolorach oraz materiał



znak: D25C/252/N/12-19rj/22

zewnątrzny z dodatkową powłoką, który tworzy łatwą do czyszczenia powierzchnię odporną na zabrudzenia – dostępna w 4 kolorach, materiał zewnętrzny do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza

106. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 5. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar XL – 2 szt.

Pkt.11

Czy Zamawiający będzie wymagał aby osłony tarczycy były przypinane do kamizelek za pomocą paska z zatraskiem.

Powyższe rozwiązanie znacząco ułatwia przechowywanie osłon tarczycy przy czym nie krępuje ruchów w trakcie użytkowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie precyzuje wymagań i dopuszcza każde rozwiązanie w powyższym zakresie.

107. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 5. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar XL – 2 szt.

Pkt.11

Prosimy o dopuszczenie osłon tarczycy o długości 63cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

108. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 5. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar XL – 2 szt.

Pkt.13

Czy Zamawiający będzie wymagał aby gwarancja wynosiła 36 miesięcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis punktu 13, który otrzymuje brzmienie:

„Gwarancja minimum 12 miesięcy”.

109. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 6. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar XXL – 1 szt.

Pkt.1

W związku z różnym ciężarem mieszanek bezołowiowych na rynku dochodzącym nawet do 5,9 kg/m² przy ekwiwalencie ołowiu 0,5mmPb prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał aby osłony radiologiczne były wykonane z ultralekkiego materiału bezołowiowego, którego ciężar nie przekracza 5,3kg/m² przy ekwiwalencie ołowiu 0,5mmPb.

Powyższy parametr gwarantuje otrzymanie przez Zamawiającego jednych z najlżejszych osłon na rynku oraz spełnienia wymogu fartuchów z materiału ultralekkiego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących ciężaru mieszanek bezołowiowych i dopuszcza każde rozwiązanie w powyższym zakresie.

110. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 6. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar XXL – 1 szt.

Pkt.3

Prosimy o podanie jaką ochronność kamizelki oraz spódnice mają mieć z tyłu. Stopień ochronności fartucha wpływa na jego cenę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż ochrona radiologiczna opisana w pkt. 3 dotyczy całego produktu (tzn. przód i tył).

111. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 6. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar XXL – 1 szt.

Pkt.4

Prosimy o dopuszczenie rozmiarów mierzonych po obwodzie klatki piersiowej, pasa oraz bioder użytkownika tj. dla rozmiaru XXL: rekomendowany obwód klatki piersiowej: 121-127cm, długość 65cm oraz spódnicy rekomendowany obwód pasa (talii) 98-108cm, bioder 123-133cm, długość 70cm. Możliwość personalizacji długości spódnicy od 50cm do 70cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

112. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 6. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar XXL – 1 szt.

Pkt.7

Prosimy o dopuszczenie kamizelki zapewniającej odciążenie kręgosłupa za pomocą wbudowanych elastycznych pasów, dopasowanie kamizelki za pomocą nakładających się paneli tylnych, zapinanych elastycznymi pasami na rzepy z przodu, kamizelka posiadająca poduszki łagodzące nacisk na barki, równoważnik osłabienia promieniowania : przód 0,5mmPb, tył 0,25mmPb.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

113. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 6. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar XXL – 1 szt.

Pkt.8

Czy Zamawiający będzie wymagał aby spódnice były wyposażone we wszyty szeroki pas odciążający zapinany na rzep?

Powyższe rozwiązanie ułatwia zakładanie spódnicy oraz odciąża użytkownika poprzez dokładne rozłożenie ciężaru spódnicy na szerokim pasie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

114. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 6. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar XXL – 1 szt.

Pkt.9

Prosimy o dopuszczenie zakładki w kamizelce na obwodzie spódnicy o szerokości min. 10 cm zapewniająca dodatkową ochronę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

115. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 6. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar XXL – 1 szt.

Pkt.10

Prosimy o dopuszczenie materiału zewnętrznego z powłoką poliuretanową zapewniającą łatwą do czyszczenia powierzchnię, aby uniknąć plam i zapewnić wysokie standardy higieny – dostępne w 10 kolorach oraz materiał zewnętrzny z dodatkową powłoką, który tworzy łatwą do czyszczenia powierzchnię odporną na zabrudzenia – dostępna w 4 kolorach, materiał zewnętrzny do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

116. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 6. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar XXL – 1 szt.

znak: D25C/252/N/12-19rj/22

Pkt.11

Czy Zamawiający będzie wymagał aby osłony tarczycy były przypinane do kamizelek za pomocą paska z zatrzaskiem.

Powyższe rozwiązanie znacząco ułatwia przechowywanie osłon tarczycy przy czym nie krępuje ruchów w trakcie użytkowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie precyzuje wymagań i dopuszcza każde rozwiązanie w powyższym zakresie.

117. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 6. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar XXL – 1 szt.

Pkt.11

Prosimy o dopuszczenie osłon tarczycy o długości 63cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

118. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 7

Poz. 6. Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy – rozmiar XXL – 1 szt.

Pkt.13

Czy Zamawiający będzie wymagał aby gwarancja wynosiła 36 miesięcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis punktu 13, który otrzymuje brzmienie:
„Gwarancja minimum 12 miesięcy”.

119. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: pkt. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Czy Zamawiający przychylił się do prośby i wydłużył okres realizacji zamówienia do 42 dni? Obecna sytuacja geopolityczna powoduje opóźnienia w terminach dostaw co wpływa na wydłużanie się terminu realizacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

120. Zapytanie Wykonawcy:

dot. projektu umowy- zał. nr 5:

Dotyczy: §6 KARY UMOWNE, ODSETKI

Czy Zamawiający przychylił się do prośby i obniżył kary umowne za nieterminową dostawę do 0,2 %? Wydłużona logistyka w łańcuchach dostaw wynikająca z sytuacji geopolitycznej znacząco wpływa na czas dostaw.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

121. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania 2

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stolik z kołami z tworzywa antystatycznego w kolorze szaro-czarnym? Zastosowanie takich kół zapewnia równie wysoką funkcjonalność, koła w kolorze szaro-czarnym są dostosowane estetycznie do całości wózka oraz są bardziej odporne na zabrudzenia niż koła w kolorze białym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza,

122. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania 2

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wózek z szynami instrumentowymi stanowiącymi element wyposażenia dodatkowego? Nie wpływa to negatywnie na funkcjonalność wózka, szyny są montowane na stałe i nie obniżają wytrzymałości konstrukcji.

Odpowiedź Zamawiającego:



Zamawiający nie dopuszcza.

123. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania 2

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stolik o wymiarach całkowitych (szer. x gł. x wys.) 820x660x990 mm? Większe wymiary nie wpływają negatywnie na funkcjonalność wózka, zapewniają większą powierzchnię użytkową, wymiary wózka są dostosowane do wygodnego korzystania z niego i przetaczania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

124. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania 2

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wózek z uchwytem do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej; uchwyt o przekroju kołowym o średnicy \varnothing 25 mm? Uchwyt nie zmienia funkcjonalności wózka, jest przystosowany do wygodnego przetaczania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

125. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania 2

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stolik o wymiarach użytkowych blatu 610x550 ? Większe wymiary nie wpływają negatywnie na funkcjonalność wózka, większa powierzchnia zapewnia bardziej optymalne wykorzystanie przestrzeni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

126. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania 2

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stolik o powierzchni użytkowej szuflady (szer. x gł.) 491x507 mm? Większe wymiary nie wpływają negatywnie na funkcjonalność wózka, większa powierzchnia zapewnia bardziej optymalne wykorzystanie przestrzeni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

127. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania 2

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści stolik z kołami z tworzywa antystatycznego w kolorze szaro-czarnym? Zastosowanie takich kół zapewnia równie wysoką funkcjonalność, koła w kolorze szaro-czarnym są dostosowane estetycznie do całości wózka oraz są bardziej odporne na zabrudzenia niż koła w kolorze białym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

128. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania 2

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wózek z szynami instrumentowymi stanowiącymi element wyposażenia dodatkowego? Nie wpływa to negatywnie na funkcjonalność wózka, szyny są montowane na stałe i nie obniżają wytrzymałości konstrukcji

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

129. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania 2

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach całkowitych (szer. x gł. x wys.) 820x660x990 mm? Większe wymiary nie wpływają negatywnie na funkcjonalność wózka, zapewniają większą powierzchnię użytkową, wymiary wózka są dostosowane do wygodnego korzystania z niego i przetaczania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

130. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania 2

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach użytkowych blatu 610x550 ? Większe wymiary nie wpływają negatywnie na funkcjonalność wózka, większa powierzchnia zapewnia bardziej optymalne wykorzystanie przestrzeni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

131. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania 2

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wózek z uchwytem do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej; uchwyt o przekroju kołowym o średnicy \varnothing 25 mm? Uchwyt nie zmienia funkcjonalności wózka, jest przystosowany do wygodnego przetaczania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

132. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania 2

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści stół o powierzchni użytkowej szuflady (szer. x gł.) 491x507 mm. ? Większe wymiary nie wpływają negatywnie na funkcjonalność wózka, większa powierzchnia zapewnia bardziej optymalne wykorzystanie przestrzeni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

133. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania 2

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści stół z kołami z tworzywa antystatycznego w kolorze szaro-czarnym? Zastosowanie takich kół zapewnia równie wysoką funkcjonalność, koła w kolorze szaro-czarnym są dostosowane estetycznie do całości wózka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

134. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania 2

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza stół o wymiarach całkowitych bez uchwyty (szer. x gł. x wys.) 900x600x900 mm? Inne wymiary nie wpływają negatywnie na funkcjonalność stolika, są dostosowane do wygodnego użytkowania i przetaczania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

135. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania 2

Poz. 3



znak: D25C/252/N/12-19rj/22

Czy Zamawiający dopuści stół o powierzchni użytkowej blatów 880x580 mm? Inne wymiary nie wpływają negatywnie na funkcjonalność stołu, są przystosowane do optymalnego wykorzystania powierzchni roboczej

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

136. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania 2

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści stół z stelażem worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo na biało z pokrywą z tworzywa w kolorze białym? Zastosowanie takiego stelaża nie zmniejsza funkcjonalności wózka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

137. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania 3

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stół z 3 kołami o średnicy \varnothing 50 mm, wszystkie koła z hamulcem, z tworzywa antystatycznego? Mniejszy rozmiar kół nie wpływa negatywnie na funkcjonalność wózka, koła są dostosowane do podstawy jezdnej i zapewniają wygodne przesuwanie stołu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

138. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania 3

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stół o wysokości 920-1380 mm? Większy zakres regulacji wysokości położenia blatu wpływa pozytywnie na funkcjonalność stołu, umożliwiając jego szersze zastosowanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

139. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania 3

Poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje aby stół był wyrobem medycznym, posiadającym aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. t.j. 2010.107.679 z późn. zm.)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z wymogu Deklaracji zgodności CE oraz Certyfikatu producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) dla produktu z Zadania 3 poz. 1.

140. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania 5

Poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje aby stopień podestu został w wykonany z blachy WL, zapobiegającej poślizgowi? Zastosowanie blachy antypoślizgowej zapewnia wyższą funkcjonalność niż pokrycie podestu materiałem antypoślizgowym, materiał antypoślizgowy może się ścierać i bardzo łatwo ulegać innym uszkodzeniom, blacha antypoślizgowa zapewnia długotrwały efekt antypoślizgowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

141. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania 5

Poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje aby stopień podestu został w wykonany z blachy WL, zapobiegającej poślizgowi? Zastosowanie blachy antypoślizgowej zapewnia wyższą funkcjonalność niż pokrycie podestu materiałem

znak: D25C/252/N/12-19rj/22

antypoślizgowym, materiał antypoślizgowy może się ścierać i bardzo łatwo ulegać innym uszkodzeniom, blacha antypoślizgowa zapewnia długotrwały efekt antypoślizgowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

142. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: Zadania 5

Poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje aby stopień podestu został w wykonany z blachy WL, zapobiegającej poślizgowi? Zastosowanie blachy antypoślizgowej zapewnia wyższą funkcjonalność niż pokrycie podestu materiałem antypoślizgowym, materiał antypoślizgowy może się ścierać i bardzo łatwo ulegać innym uszkodzeniom, blacha antypoślizgowa zapewnia długotrwały efekt antypoślizgowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

143. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie w Zadaniu nr 6 Pozycji nr 6 (Wózek do dystrybucji leków z szufladami) Punkt 1 oraz 2 od wymogu posiadania przez wózek Deklaracji zgodności CE oraz Certyfikatu producenta wyrobów medycznych, ponieważ wózek ten nie jest wyrobem medycznym, a wózkiem ogólnego stosowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z wymogu Deklaracji zgodności CE oraz Certyfikatu producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) dla produktu z Zadania 6 poz. 6.

144. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie w Zadaniu nr 6 Pozycji nr 7 (Wózek do przewożenia leków z tacami) Punkt 1 oraz 2 od wymogu posiadania przez wózek Deklaracji zgodności CE oraz Certyfikatu producenta wyrobów medycznych, ponieważ wózek ten nie jest wyrobem medycznym, a wózkiem ogólnego stosowania.

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający rezygnuje z wymogu Deklaracji zgodności CE oraz Certyfikatu producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) dla produktu z Zadania 6 poz. 7.

II. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SWZ uwzględniający wszystkie ww zmiany - dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych


Marzena Magulska